

Teleflex Medical s.r.o.
 Pražská třída 209, 500 04 Hradec Králové 4, CZECH REPUBLIC
 IČO: 28849809
 DIČ: CZ28849809


Teleflex
 MEDICAL

Faktura - daňový doklad

číslo:	Datum vystavení = DUZP:
32100790	06.12.2018
číslo zákazníka:	10029578
Vaše danové číslo	Naše danové id číslo
CZ00209775	CZ28849809
IČO: 00209775	
DIČ skupiny:	
Měna : CZK	




Fakturacní adresa
 Centrum kardiiovaskulární
 a transplantacní chirurgie
 Pekarska 53
 CZ-65691 BRNO



Teleflex Medical s.r.o. tímto ujišťuje, že na všechny produkty uvedené na tomto dodacím listu bylo vydáno Prohlášení o shodě podle par.12 ods.2 zákona ve znění zákona 71/2000Sb., a podle NV 336/2001Sb., kterým se mění NV 181/2001Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

Pos	CO	Materiál	Popis	DPH	Mnozství	Cena	Per	Hodnota CZK
			Int číslo objednávky: 12078580 ze dne: 06.12.2018					
			Objednávka číslo: O/009382/2018 ze dne:					
			Dodací list: 846238477 ze dne: 06.12.2018					
0001	US	ML-00702 7 FR X 21 CM	VZP:47194 MAC MDD: III	21%	5 EA ✓	256,95 CZK ✓	1 EA	1.284,75
		CVC COMPONENT: 2-LUMEN 7FR x 16 CM						
0002	DE	179360 CH 12 ✓	Kat. Rusch Senzor MDD: IIb	21%	20 EA ✓	454,55 CZK ✓	1 EA	9.091,00
		Katetr pro mer. teploty s Rusch senzorem						
0003	MY	179360 CH 14 ✓	Kat. Rusch Senzor MDD: IIb	21%	50 EA ✓	454,55 CZK ✓	1 EA	22.727,50
		Katetr pro mer. teploty s Rusch-senzorem						
0004	US	SI-11142 9 FR ✓	VZP:34548 multi lumen katetr MDD: IIa	21%	50 EA ✓	1.079,19 CZK ✓	1 EA	53.959,50
		MULTI-LUMEN/PSI SET						
0005	DE	CS-22853-E ✓	VZP:49191 CVC set: 3-lumen MDD: III	21%	25 EA ✓	789,35 CZK ✓	1 EA	19.733,75
		CVC SET, 8,5Fr., 16cm						
0006	US	AH-05050-D 7.5 FR 5-L	VZP:57221 MDD: III	21%	5 EA ✓	2.055,60 CZK ✓	1 EA	10.278,00
		THERMODILUTION CATH KIT:7.5 FR 5-L						

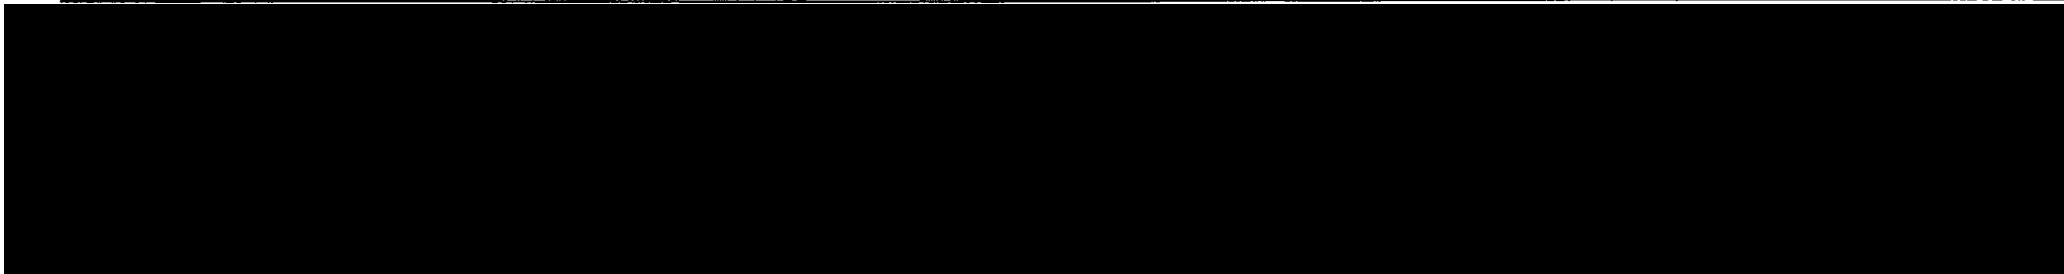

Teleflex Medical s.r.o.
Pražská třída 209, 500 04 Hradec Králové 4, CZECH REPUBLIC
IČO: 28849809
DIČ: CZ28849809

Teleflex
MEDICAL

Datum/C.faktury
06.12.2018 / 32100790


Strana
2 / 2

Fakturací adresa
Centrum kardiiovaskulární
a transplantací chirurgie
Pekarska 53
CZ-65691 BRNO

Základ dane	21,000%	
DPH		21,000%
Celková částka		

	117.074,50
	24.585,65
	141.660,15

Dodací podmínky: DAP DELIVERY AT PLACE
Datum Splatnosti: Až k 06.03.2019 beze srážky



pruvodní list**Teleflex®**

dodací list c.: **846238477**
datum: **06.12.2018**
číslo zákazníka: **10029578**
Sold-To number: **10029578**

Teleflex Medical s.r.o.
Pražská třída 209/182
CZ 50004 Hradec Králové

číslo zákazníka:

Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie
Operační sály(2640)
Tel.:543182499
Pekarska 53
65691 Brno

Sold-To:

Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie
Pekarska 53
65691 Brno

prepravce:

Arrow International CR, a.s. tímto ujistuje, že na všechny produkty uvedené na tomto dodacím listu bylo vydáno Prohlášení o shodě podle par.12 odst.2 zákona ve znění zákona 71/2005Sb., a podle NV 336/2001Sb., kterým se mění NV 181/2001Sb. 14, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

Pos	druh zboží popis	množství	množství	váha (kg)
Vase objednávka: 0012078580;O/009382/2018				
10	ML-00702 CVC COMPONENT: 2-LUMEN 7FR x 16 CM EAN 30801902012020		5 KS	0,34
	sarže 71F18L1144 datum expirace 14 / 11 / 2023	5 KS		
20	179360-000120 Katetr pro mer. teploty s Rusch senzorem EAN 24026704103823		20 KS	1,60
	sarže 18HE34 datum expirace 28 / 07 / 2023	20 KS		
30	179360-000140 Katetr pro mer. teploty s Rusch-senzorem EAN 24026704103830		50 KS	4,20
	sarže 18GE29 datum expirace 30 / 06 / 2023	50 KS		
40	SI-11142 MULTI-LUMEN/PSI SET EAN 30801902013683		50 KS	11,75
	sarže 71F18L2129 datum expirace 31 / 05 / 2023	50 KS		
50	CS-22853-E CVC SET, 8,5Fr., 16cm EAN 30801902029080		25 KS	3,17
	sarže 71F18L1633 datum expirace 19 / 10 / 2020	25 KS		
60	AH-05050-D THERMODILUTION CATH KIT:7.5 FR 5-L EAN 0801902003096		5 KS	1,70
	sarže 16F18G0061 datum expirace 30 / 11 / 2019	5 KS		