



Dodatek č. 2
k RÁMCOVÉDOHODĚ
NA „ DODÁVKY ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU“

Smluvní strany

Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
 jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřena výkonem funkce ředitelky
 IČO: 75154960 (není plátcem DPH)
 bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710
 adresa pro zasilání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
 kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

Truhlářství Grohman s.r.o.

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144596

se sídlem: č.p. 127, 277 03 Horní Počaply
 jehož jménem jedná: Stanislav Grohman
 IČO: 28479301
 DIČ: CZ28479301
 kontaktní osoba včetně údajů: Stanislav Grohman, tel: 775 929 881, e-mail: s.grohman@seznam.cz

(dále jen „dodavatel“)

(dohromady dále jen „smluvní strany“)

se v souladu s článkem IX., bodem 9.4 Rámcové dohody na dodávku zdravotnického nábytku uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) dohodly na tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) tohoto obsahu:

1. V příloze č. 1 – Technická specifikace Rámcové dohody se u těchto položek:

- č. 8a – Kartotéka – 4 zásuvky
- č. 8b – Kartotéka – 6 zásuvek
- č. 12 – Skříň
- č. 14 – Šatní skříň
- č. 15 – Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře
- č. 16a – Mobilní skříňka (kontejner)

- č. 16b – Mobilní skříňka
- č. 17 – Skříňka spodní s dřezem Medlin
- č. 18 – Skříň spodní D1L Medlin
- č. 19 – Skříň spodní Z8 Medlin
- č. 20 – Skříňka horní H2LSZ Medlin
- č. 21 – Skříňka horní H1LSZ Medlin
- č. 22 – Skříňka horní H3LSZ Medlin

mění označení typu model a úchytů z původního označení „ENA 160“ na označení „PORTA 160“.

2. Ostatní ujednání Rámcové dohody zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

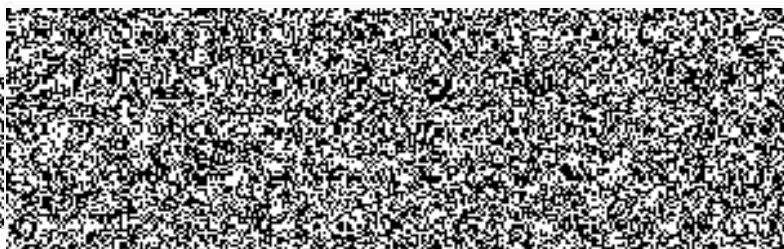
Příloha

Příloha č. 1 – Technická specifikace

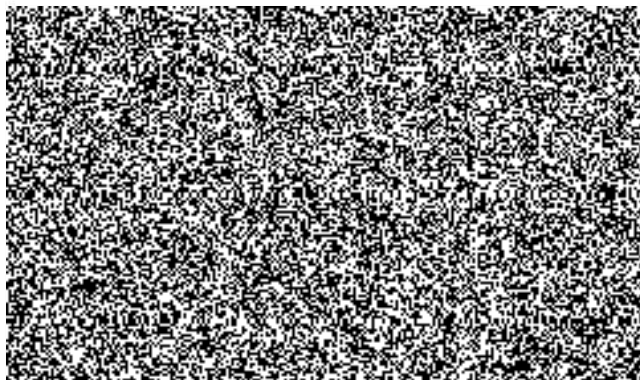






Mgr. Dana Středulová
pověřena výkonem funkce ředitelky
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

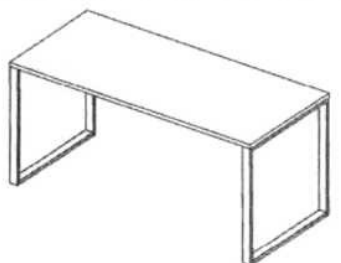
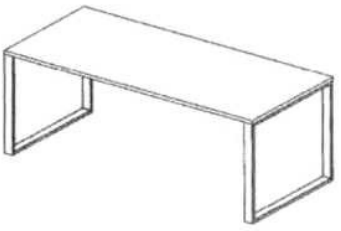


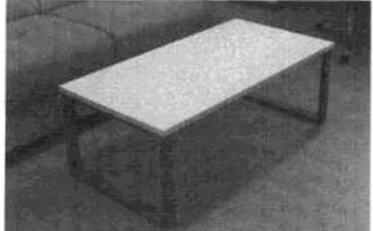
Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
- 9 -



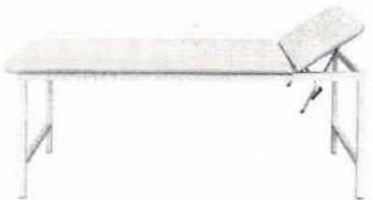


Stanislav Grohman, jednatel
Truhlářství Grohman s.r.o.

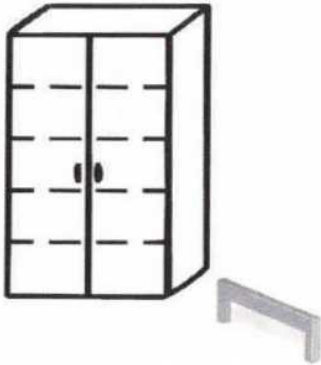
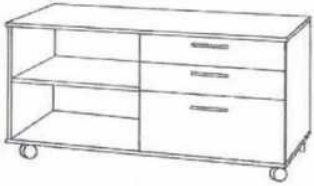
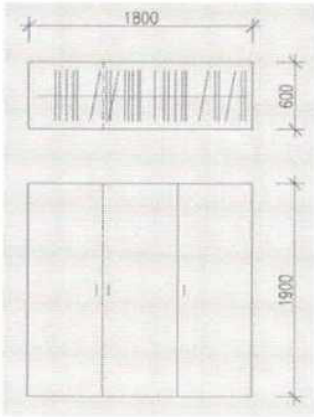




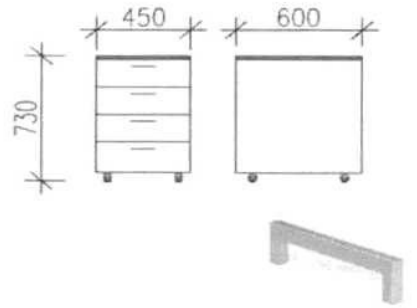
Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky			
Veřejná zakázka: Dodávky zdravotnického nábytku			
ČJ:ZZ-687-7/R-2018			
č.	typ	ks	ilustrační foto
			popis
1a	Lavice pro pacienty - dvoumístná	40	 <p>Dvoumístná plastová lavice pro pacienty. Celková šířka lavice bude 1040 mm. Jedno místo k sezení bude mít minimální nostnost 140 kg. Plastový sedák a záďová opěrka budou mít hladký povrch pro snadnou údržbu (omyvatelný povrch). Lavice bude mít výškově nastavitelné podnoží pro vyrovnávání nesrovnalostí podlahy. Typové označení lavice je Imperia. Sedák a záďová opěrka bude z plastu v barevném provedení tmavě zelená (RAL 5021). Nosný rám a podnoží bude z kovu v barvě RAL 9006.</p>
1b	Lavice pro pacienty - třímístná	40	 <p>Třímístná plastová lavice pro pacienty. Celková šířka lavice bude 1560 mm. Jedno místo k sezení bude mít minimální nostnost 140 kg. Plastový sedák a záďová opěrka budou mít hladký povrch pro snadnou údržbu (omyvatelný povrch). Lavice bude mít výškově nastavitelné podnoží pro vyrovnávání nesrovnalostí podlahy. Typové označení lavice je Imperia. Sedák a záďová opěrka bude z plastu v barevném provedení tmavě zelená (RAL 5021). Nosný rám a podnoží bude z kovu v barvě RAL 9006.</p>
2	Pracovní křeslo	80	 <p>Otočná, síťovaná kancelářská židle s pětiramenným nosným křížem s chromovou povrchovou úpravou. Čalouněné chromové područky se snímatelným povrchem. Židle bude opatřena standardními kancelářskými kolečky pro vinylovou podlahu. Židle bude mít multifunkční houpačí mechaniku s možností aretace v jakékoliv pozici a s nastavením síly protitlaku opěrku podle hmotnosti uživatele. Ovládací mechanismus bude pod sedákem. Nosnost židle 130 kg (židle bude mít zesílený kovový kříž pro vyšší zatížení). Podnoží, kostra bude v barevném provedení - chrom. Potah židle bude v barevném provedení tmavě šedá až černá. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
3	Židle pro pacienty	120	 <p>Stohovatelná židle se stabilní nerezovou kosterou. Plastový sedák a záďová opěrka budou mít hladký povrch pro snadnou údržbu (omyvatelný povrch). Kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah. Typové označení židle je Imperia. Sedák a záďová opěrka bude z plastu v tmavě zelené barvě (RAL 5021) - ve stejném provedení jako lavice pro pacienty. Nosná kovová kostra židle bude s povrchovou úpravou chrom. Nosnost židle minimálně 130 kg. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

4a	Pracovní stůl	80		<p>Deska pracovního stolu 1800 x 800 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu se skládá z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky . Barva desky stolu bude bílá /W980 ST2. Dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů. Retifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy o min. 25 mm, černá. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i></p>
4b	Pracovní stůl	80		<p>Deska pracovního stolu 600 x 800 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu se skládá z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva desky stolu bude bílá /W980 ST2. Dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů. Retifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy o min. 25 mm, černá. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
5	Stolek	40		<p>Deska stolu 500x500 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu - stabilní, centrální, kovová noha kruhového (čtvercového) průřezu na talířovém případně křížovém podstavci. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva desky stolu bude bílá /W980 ST2.</p>
6	Jídelní stůl v lékařském pokoji	40		<p>Deska stolu 800x800 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu - stabilní, centrální, kovová noha kruhového (čtvercového) průřezu na talířovém případně křížovém podstavci. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva desky stolu bude bílá /W980 ST2. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
7	Konferenční stolek v lékařském pokoji	40		<p>Deska konferenčního stolku 1100 x 550 mm. Podnož stolku se skládá z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli. Podnož stolku bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Výška stolu bude 440 mm. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky . Barva desky stolku bude bílá /W980 ST2. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry konferenčního stolku budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>

8a	Kartotéka - 4 zásuvky	160		<p>Kartotéka kovová, pevně svařená, 4 - zásuvková pro uložení dokumentů formátu A4. Rozměry kartotéky: výška 1320 mm, hloubka 600 mm, šířka 400 mm. Vnitřní rozměr zásuvky: výška 280 mm, hloubka 500 mm, šířka 325 mm. Uzamykání pomocí centrálního cylindrického zámku se dvěma klíči. Kartotéka bude opatřena technologií výsuvu pouze jedné zásuvky. Nosnost zásuvky minimálně 40 kg. Kvalitní teleskopické výsuvy s lehkým chodem. Zásuvky s plným výsuvem (100%). Kartotéka bude mít rektifikační nožky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Perforace dna zásuvky pro dělicí příčky. Korpus kartotéky bude v barevném provedení - práškový vyplavovací lak RAL 7011/mat. Čela zásuvek budou z LTD desky o tloušce 18 mm a v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a uchytí budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Zásuvky budou opatřeny plastovým štítkem pro vložení jmenovky. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
8b	Kartotéka - 6 zásuvek	120		<p>Kartotéka kovová, pevně svařená, 6 - zásuvková pro uložení dokumentů formátu A5. Rozměry kartotéky: výška 1320 mm, hloubka 600 mm, šířka 520 mm. Vnitřní rozměr zásuvky: výška 280 mm, hloubka 500 mm, šířka 325 mm. Uzamykání pomocí centrálního cylindrického zámku se dvěma klíči. Kartotéka bude opatřena technologií výsuvu pouze jedné zásuvky. Nosnost zásuvky minimálně 40 kg. Kvalitní teleskopické výsuvy s lehkým chodem. Zásuvky s plným výsuvem (100%). Kartotéka bude mít rektifikační nožky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Perforace dna zásuvky pro dělicí příčky. Korpus kartotéky bude v barevném provedení - práškový vypalovací lak RAL 7011/mat. Čela zásuvek budou z LTD desky o tloušce 18 mm a v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a uchytí budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Zásuvky budou opatřeny plastovým štítkem pro vložení jmenovky. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
9	Lehátko pro pacienty	40		<p>Dvoudílné vyšetřovací lehátko s náklonným zádovním dílem od 0° do + 60° nadlehčovaným plynovou pružinou. Nosnost lehátka minimálně 150 kg. Lehátko bude obsahovat držák na roli zdravotnické papírové podložky. Lehátko bude mít rektifikační šrouby k vyrovnání nerovnosti podlahy. Lehátko bude čalouněno koženkou v bílé barvě. Konstrukce bude s povrchovou úpravou práškovým nástřikem bílé barvy. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

10a	Nástrojový stůlek s nástavcem	40		<p>Rozměr: 850x480x640 mm. Konstrukce vozíku bude z nerezové oceli AISI304 s antivibrační výztuhou. Pracovní deska a madla budou z nerezové oceli AISI304. Centrální zamykání zásuvek. Čelo zásuvky bude vybaveno pryžovým profilem po celém obvodu, zaručující prachotěsnost. Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z trvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami. Čelo zásuvky bude v barevném provedení bílá/vysoký lesk. Vnitřní prostor zásuvky bude možné rozdělit pomocí vyjímatelných plastových příček. Zásuvky budou osazeny na kvalitních teleskopických plnovýsuvcích s dotahem a dotlumením. Nosnost každé zásuvky 20 kg. Nástavba obsahuje: 3 velké a 5 středních plastových zásuvek. Nástavba je pevně spojena s vozíkem. Stůlek bude mít 4 otočná kola, d=12,5 cm, 2x brzda, 4x rohový nárazník z odolného plastu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
10b	Nástrojový stůlek - zubní ordinace	10		<p>Rozměr: výška: 102 mm, šířka: 750 mm, hloubka: 55 mm. Konstrukce vozíku bude z nerezové oceli AISI304 s antivibrační výztuhou. Pracovní deska a madla budou z nerezové oceli AISI304. Centrální zamykání zásuvek. Čelo zásuvky bude vybaveno pryžovým profilem po celém obvodu, zaručující prachotěsnost. Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z trvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami. Čelo zásuvky bude v barevném provedení bílá/vysoký lesk. Vnitřní prostor zásuvky bude možné rozdělit pomocí vyjímatelných plastových příček. Zásuvky budou osazeny na kvalitních teleskopických plnovýsuvcích s dotahem a dotlumením. Nosnost každé zásuvky 20 kg. Stůlek bude mít 4 otočná kola, d=12,5 cm, 2x brzda, 4x rohový nárazník z odolného plastu. Celková nosnost vozíku min. 140 kg. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
11	Lékárna	50		<p>Rozměr: výška: 1950 mm, hloubka: 400 mm, šířka: 920 mm. Léková skříň bude vyroben a z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovacím vypalovacím lakem. Horní dvířka budou prosklená, bezpečnostní kalené sklo. Dveře budou opatřeny rozvorovými cylindrickými zámky, každý se dvěma klíči. Police v horní části lékárny budou z bezpečnostního skla s plošnou nosností min. 20 kg. Police ve spodní části lékárny budou plechové s plošnou nosností min. 60 kg. Police budou výškově přestavitelné. Zavírání s tlumenými dorazy. Korpus bude v barevném provedení práškový vypalovací lak RAL 7011/mat. Dvířka budou v barevném provedení práškový vypalovací lak RAL 9013/ mat (jemná struktura) - bílá barva. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

12	Skříň	80		<p>Dvoudveřová kancelářská skříň (2x sekce s šířkou 600 mm). Rozměr: výška 1900 mm, hloubka 600 mm, šířka 1200 mm. Korpus a dveře skříně budou vyrobeny z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32 mm. Police budou z laminované dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Tvarové provedení viz. ilustrární obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříně budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
13	Skříňka pojízdná malá	40		<p>Mobilní kancelářská skříňka, kombinace uzamykatelných zásuvek a volných polic. Výška 650 mm, hloubka 600 mm, šířka 1200 mm. Korpus skříňky a police budou vyrobeny z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany budou v barvě desky. Čelní desky zásuvek budou z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany v barvě desky. Kování pro vysokou zátěž. Kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky. Barva korpusu skříně a polic budou v barevném provedení šedá/mat U963 ST9. Čela zásuvek, žáda budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Skříňka bude na čtyřech černých pojízdných kolečkách vhodných pro vinilovou podlahu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
14	Šatní skříň	40		<p>Třídveřová kancelářská skříň (3x sekce s šířkou 600 mm). Rozměr: výška 1900 mm, hloubka 600 mm, šířka 1800 mm. Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Ve spodní části vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32 mm z desek LTD o tloušce 18 mm. Vnitřní pevná mezistěna z lamino dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, šatní tyč. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Rektifikace. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: rozměr, uspořádání a vybavení skříně budou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a požadavkům lékařů za předpokladu dodržení materiálového řešení</i></p>

15	Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře	40		<p>Rozměr: Výška min 1900 mm, hloubka 430-450 mm, šířka 1200 mm. Korpus a dveře skříně budou vyrobeny z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z laminové dřevotřískové desky (LTD), na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min. 5 mm, výška 3/5 na kovových závěsech s krytkou. 5 přestavitelných polic s možností volby polohy po 32 mm. Police budou z laminované dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Záda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Skříň bude opatřena rektifikací. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina bude pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně.</p>
16a	Mobilní skříňka (kontejner)	80		<p>Kontejner - čtyřzásuvkový, vrchní zásuvka - tužkovník. Rozměry kontejneru (v x š x h) 615 x 430 x 600 mm. Korpus kontejneru a čela zásuvek budou vyrobeny z lamino desek tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě desky. Korpus kontejneru bude v barevném provedení šedá/ U963 ST9. Čela zásuvek budou v barevném provedení bílá/ vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky. Zámek v čele horní zásuvky, centrální pro všechny zásuvky. Kontejner bude na čtyřech černých pojízdných kolečkách vhodných pro vinilovou podlahu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
16b	Mobilní skříňka	40		<p>Kontejner - čtyřzásuvkový, vrchní zásuvka - tužkovník. Rozměry kontejneru (v x š x h) 730 x 450 x 600 mm. Korpus kontejneru a čela zásuvek budou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě desky. Korpus kontejneru bude v barevném provedení šedá/ U963 ST9. Čela zásuvek bude v barevném provedení bílá/ vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky. Zámek v čele horní zásuvky, centrální pro všechny zásuvky. Kontejner bude na čtyřech černých pojízdných kolečkách vhodných pro vinilovou podlahu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

17 Skříňka spodní s dřezem Medlin

40



Skříň

Rozměr: 80cm, v 82cm, h 50cm. Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Záda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace.

Nerezový dvoudřez s odkapávací plochou

Rozměry 116,0 x 51,0 cm.

Hloubka vany dřezu 18,5 cm.

Dřez je určen pro horní montáž do minimálně 800 mm široké skříňky.

včetně:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

- sítkový ventil 6/4" s přepadem

- sifon pro úsporu místa 6/4"

- otvor na baterii

Stojánková dřezová páková baterie

Povrch baterie bude v provedení lesklý chrom.

Výška baterie: 22,9 cm.

Válcové tělo o průměru 5,1 cm.

Plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením. Keramická kartuše. Otočný výtok 360°.

2x rohový ventil G1/2".




Pracovní deska

Pracovní deska o tl. 38 mm, sokl v 150 mm. Pracovní deska bude v barevném provedení F160-ST9 mramor marmarský, sokl systémový nerez broušený s dotiskem.


Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.

Poznámka: Rozměry skříňky s budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.

18	Skříň spodní D1L Medlin	60		<p>Skříň Rozměr: š 60cm, v 82cm, h 50cm. Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Nerezový dřez s odkapávací plochou rozměry 78 × 43,5 cm výřez: 76 × 41,5 cm dřez: 36 × 35 × 14,5 cm včetně: - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - otvor na baterii Stojánková dřezová páková baterie Povrch baterie bude v provedení lesklý chrom. Výška baterie: 22,9 cm. Válcové tělo o průměru 5,1 cm. Plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením. Keramická kartuše. Otočný výtok 360°. 2x rohový ventil G1/2". Pracovní deska Pracovní deska o tl. 38 mm, sokl v 150 mm. Pracovní deska bude v barevném provedení F160-ST9 mramor marmarský, sokl systémový nerez broušený s dotiskem. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky s budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i></p>
19	Skříň spodní Z8 Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 40cm, v 82cm, h 50cm. 4-zásuvková skříňka. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Pracovní deska Pracovní deska o tl. 38 mm, sokl v 150 mm. Pracovní deska bude v barevném provedení F160-ST9 mramor marmarský, sokl systémový nerez broušený s dotiskem. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky s budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>

20	Skříňka horní H2LSZ Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 80cm, v 72cm, h 30cm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Osvětlení Osvětlení bude zařezované po celé délce horních skříněk. Vestavný hliníkový ALU profil v barevném provedení stříbrná. S příkonem 12 W/m. Dotykový ovladač. Barva denní bílá (4000 – 5000 K). Včetně napájecího zdroje. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skřínky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
21	Skříňka horní H1LSZ Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 60cm, v 72cm, h 30cm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli hranatého PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Osvětlení Osvětlení bude zařezované po celé délce horních skříněk. Vestavný hliníkový ALU profil v barevném provedení stříbrná. S příkonem 12 W/m. Dotykový ovladač. Barva denní bílá (4000 – 5000 K). Včetně napájecího zdroje. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skřínky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
22	Skříňka horní H3LSZ Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 40cm, v 72cm, h 30cm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Osvětlení Osvětlení bude zařezované po celé délce horních skříněk. Vestavný hliníkový ALU profil v barevném provedení stříbrná. S příkonem 12 W/m. Dotykový ovladač. Barva denní bílá (4000 – 5000 K). Včetně napájecího zdroje. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skřínky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>

23a	Lednička - samostatně stojící	20		<p>Volně stojící kombinovaná chladnička. Výška lednice minimálně 85 cm. Objem chladničky minimálně 118 l a objem mrazáku minimálně 15 l. Energetická třída A++. Mechanické ovládání. Automatické odmrazování chladicí části.</p>
23b	Lednička - vestvěná	20		<p>Vestavěná kombinovaná chladnička. Výška maximálně 82 cm. Objem chladničky 97 litrů a objem mrazničky 17 litrů. Energetická třída A++. Mechanické ovládání. Automatické odmrazování chladicí části.</p>
24	Věšák pro pacienty	120		<p>Stojanový věšák z hliníku nebo jiného kovu s práškovou úpravou, se základnou čtvercového průřezu, výška věšáku min. 1800 mm. Barevné provedení RAL 7011/mat. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
25	Věšáková stěna	40		<p>Věšáková stěna - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťka 18 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě věšákové desky. 3 chromové háčky. Věšáková stěna bude v barevném provedení šedá/U963 ST9. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry věšákové stěny budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
26	Sedací souprava v lékařském pokoji	40		<p>Dvoumístná sedací souprava o rozměru 1500 x 830 mm. Sedací souprava bude mít kovové podnoží. Látkový potah s vysokou odolností, který bude snímatelný pro snadnou údržbu, platí i pro látkový potah polštářů. Područky budou mít šířku 160 mm. Podnoží bude v barevném provedení kov RAL 7011 mat. Látkový potah sedací soupravy - korpus Moon C/33 světle béžová barva. Polštáře sedáku budou mít barevné provedení Moon C/17 zelená barva. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry sedací soupravy jsou pouze orientační, konečné rozměry sedací soupravy budou vždy přizpůsobeny možnostem konkrétního zdravotnického zařízení a požadavkům lékaře.</i></p>

13a	Křeslo	80		<p>Křeslo k sedací soupravě o rozměru cca 830 x 830 mm. Křeslo bude mít kovové podnoží. Látkový potah s vysokou odolností, který bude snímatelný pro snadnou údržbu, platí i pro látkový potah polštářů. Područky budou mít šířku 160 mm. Podnoží bude v barevném provedení kov RAL 7011ú mat. Látkový potah sedací soupravy - korpus Moon bude v barevném provedení C/33 světle béžová. Polštáře sedáku budou mít barevné provedení Moon C/17 zelená barva.</p>
<p>Veškeré výrobky budou před samotnou instalací a výrobou odsouhlaseny zadavatelem. Toto odsouhlasení proběhne ze strany zadavatele písemnou formou.</p>				
<p>Příložená fotodokumentace má zobrazovat pouze tvarovou a designovou podobu soutěžených interiérových výrobků, jedná se tedy pouze o ilustrační fotografie, jež nejsou pro plnění závazné.</p>				
<p>Tvarová podoba (rozměry apod.) jsou pro dodavatele závazná, výrobky budou vyrobeny v největší kvalitě(kvalitní řemeslné zpracování).</p>				
<p>Poznámka: při použití materiálu LTD desky budou všechny hrany ošetřeny hranou ABS v barvě schodné s barvou plochy desky.</p>				