



Dodatek č. 3
k RÁMCOVÉ DOHODĚ
NA „DODÁVKY ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU“

Smluvní strany

Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
jejímž jménem jedná: Mgr. Jan Smetana, ředitel Zdravotnického zařízení
Ministerstva vnitra
IČO: 75154960 (není plátce DPH)
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasílání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
kontaktní osoba: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Truhlářství Grohman s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144596

se sídlem: č.p. 127, 277 03 Horní Počaply
jehož jménem jedná: Stanislav Grohman
IČO: 28479301
DIČ: CZ28479301
kontaktní osoba včetně údajů: Stanislav Grohman, tel: 775 929 881, e-mail:
s.grohman@seznam.cz

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dohromady dále jen „**Smluvní strany**“)

1. V souladu s článkem IX., bodem 9.4 Rámcové dohody na dodávky zdravotnického nábytku uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu plnění dle Rámcové dohody s tím, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Dodávka zdravotnického nábytku“ a součet hodnot všech změn je nižší než 10% původní hodnoty veřejné zakázky.

3. Rozsah změn spočívá v přidání nové položky zdravotnického nábytku a snížení sjednaného množství položky.

Příloha č. 1 - Technická specifikace Rámcové dohody bude:

- rozšířena o položku č. 20a – Polička (37 kusů za jednotkou cenu 2 683,- Kč bez DPH);
- snížena o sjednané množství položky č. 9 – Lehátko pro pacienty (z původních 40 kusů na 25 kusů).

Nové znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

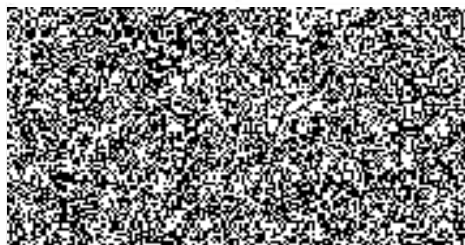
4. V návaznosti na provedené změny v rozsahu plnění se Smluvní strany dohody na změně Přílohy č. 2 - Cenová nabídka. Nové znění Přílohy č. 2 – Cenová nabídka tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
5. V návaznosti na provedené změny rozsahu plnění se Smluvní strany dohody na změně celkové hodnoty ceny a čl. III. odst. 3.1. Rámcové dohody na dodávku zdravotnického nábytku nahrazují Smluvní strany následujícím novým zněním:

Celková cena za předpokládané množství předmětu plnění specifikovaného v Příloze č. 1 – Technická specifikace a Příloze č. 2 – Cenová nabídka činí:

Cena celkem bez DPH	12 168 146,- Kč
Výše DPH v Kč	2 555 311,- Kč
Cena celkem včetně DPH	14 723 457,- Kč

6. V rámci tohoto Dodatku bude v čl. VIII. odst 8.1 Rámcové dohody změněn odpovědný pracovník Objednatele pro záležitosti obsahu a formy plnění. Odpovědným pracovníkem Objednatele pro záležitosti obsahu a formy plnění bude: Ing. Martina Chauturová (martina.chauturova@zzmv.cz, tel: 974 827 663, 731 538 609).
7. Ostatní ujednání Rámcové dohody zůstávají v platnosti beze změn.
8. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
11. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu porozuměly a nemají k němu žádné výhrady. Dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho strany připojují své podpisy.

12. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je nové znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace, Přílohy č. 2 – Cenová nabídka a Změnový list včetně soupisu jednotlivých změn.



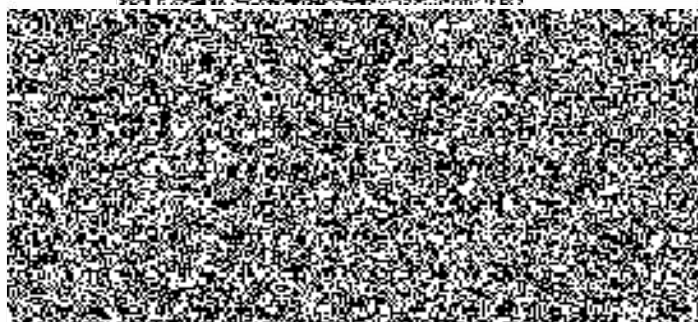
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra



V Horních Počaplech dne: 11.5.2019





Jednatel

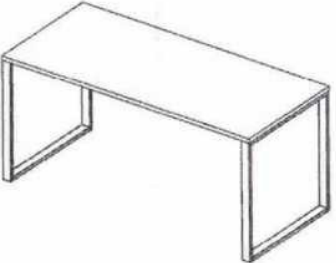
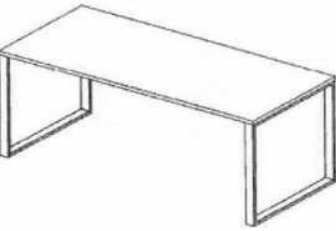


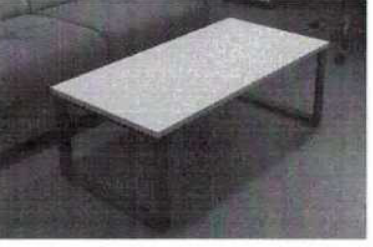
Truhlářství Grohman s.r.o.



Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

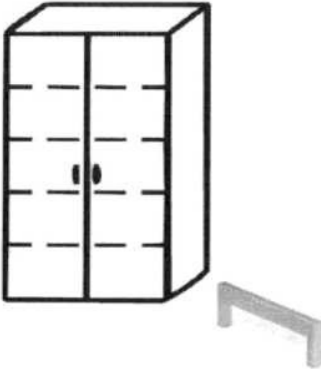
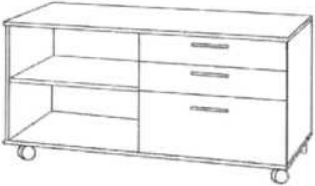

Veřejná zakázka: Dodávky zdravotnického nábytku



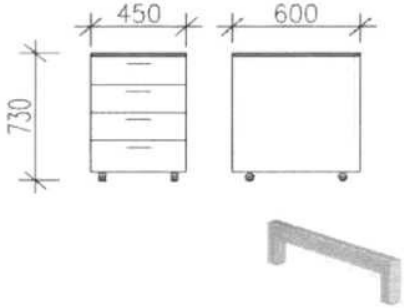
č.	typ	ks	ilustrační foto	popis
1a	Lavice pro pacienty - dvoumístná	40		<p>Dvoumístná plastová lavice pro pacienty. Celková šířka lavice bude 1040 mm. Jedno místo k sezení bude mít minimální nostnost 140 kg. Plastový sedák a záďová opěrka budou mít hladký povrch pro snadnou údržbu (omyvatelný povrch). Lavice bude mít výškově nastavitelné podnoží pro vyrovnávání nesrovnalostí podlahy. Typové označení lavice je Imperia. Sedák a záďová opěrka bude z plastu v barevném provedení tmavě zelená (RAL 5021). Nosný rám a podnoží bude z kovu v barvě RAL 9006.</p>
1b	Lavice pro pacienty - třímístná	40		<p>Třímístná plastová lavice pro pacienty. Celková šířka lavice bude 1560 mm. Jedno místo k sezení bude mít minimální nostnost 140 kg. Plastový sedák a záďová opěrka budou mít hladký povrch pro snadnou údržbu (omyvatelný povrch). Lavice bude mít výškově nastavitelné podnoží pro vyrovnávání nesrovnalostí podlahy. Typové označení lavice je Imperia. Sedák a záďová opěrka bude z plastu v barevném provedení tmavě zelená (RAL 5021). Nosný rám a podnoží bude z kovu v barvě RAL 9006.</p>
2	Pracovní křeslo	80		<p>Otočná, síťovaná kancelářská židle s pětiramenným nosným křížem s chromovou povrchovou úpravou. Čalouněné chromové područky se snímatelným povrchem. Židle bude opatřena standardními kancelářskými kolečky pro vinylovou podlahu. Židle bude mít multifunkční houpačí mechaniku s možností aretace v jakékoliv pozici a s nastavením síly protitlaku opěrku podle hmotnosti uživatele. Ovládací mechanismus bude pod sedákem. Nosnost židle 130 kg (židle bude mít zesílený kovový kříž pro vyšší zatížení). Podnoží, kostra bude v barevném provedení - chrom. Potah židle bude v barevném provedení tmavě šedá až černá. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
3	Židle pro pacienty	120		<p>Stohovatelná židle se stabilní nerezovou kostrou. Plastový sedák a záďová opěrka budou mít hladký povrch pro snadnou údržbu (omyvatelný povrch). Kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah. Typové označení židle je Imperia. Sedák a záďová opěrka bude z plastu v tmavě zelené barvě (RAL 5021) - ve stejné jako lavice pro pacienty. Nosná kovová kostra židle bude s povrchovou úpravou chrom. Nosnost židle minimálně 130 kg. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

4a	Pracovní stůl	80		<p>Deska pracovního stolu 1800 x 800 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu se skládá z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva destky stolu bude bílá /W980 ST2. Dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů. Retifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy o min. 25 mm, černá. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i></p>
4b	Pracovní stůl	80		<p>Deska pracovního stolu 600 x 800 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu se skládá z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva destky stolu bude bílá /W980 ST2. Dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů. Retifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy o min. 25 mm, černá. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
5	Stolek	40		<p>Deska stolu 500x500 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu - stabilní, centrální, kovová noha kruhového (čtvercového) průřezu na talířovém případně křížovém podstavci. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva desky stolu bude bílá /W980 ST2.</p>
6	Jídelní stůl v lékařském pokoji	40		<p>Deska stolu 800x800 mm. Výška stolu bude 730 mm. Podnož stolu - stabilní, centrální, kovová noha kruhového (čtvercového) průřezu na talířovém případně křížovém podstavci. Podnož stolu bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva desky stolu bude bílá /W980 ST2. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
7	Konferenční stolek v lékařském pokoji	40		<p>Deska konferenčního stolku 1100 x 550 mm. Podnož stolku se skládá z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli. Podnož stolku bude povrchově upravena barvou RAL 7011/mat. Výška stolu bude 440 mm. Stolová deska - laminová dřevotřísková (LTD) tloušťky 25 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě desky. Barva destky stolku bude bílá /W980 ST2. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry konferenčního stolku budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>

8a	Kartotéka - 4 zásuvky	160		<p>Kartotéka kovová, pevně svařená, 4 - zásuvková pro uložení dokumentů formátu A4. Rozměry kartotéky: výška 1320 mm, hloubka 600 mm, šířka 400 mm. Vnitřní rozměr zásuvky: výška 280 mm, hloubka 500 mm, šířka 325 mm. Uzamykání pomocí centrálního cylindrického zámku se dvěma klíči. Kartotéka bude opatřena technologií výsuvu pouze jedné zásuvky. Nosnost zásuvky minimálně 40 kg. Kvalitní teleskopické výsuvy s lehkým chodem. Zásuvky s plným výsuvem (100%). Kartotéka bude mít rektifikační nožky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Perforace dna zásuvky pro dělicí příčky. Korpus kartotéky bude v barevném provedení - práškový vypalovací lak RAL 7011/mat. Čela zásuvek budou z LTD desky o tloušťce 18 mm a v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a uchytí budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Zásuvky budou opatřeny plastovým štítkem pro vložení jmenovky. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
8b	Kartotéka - 6 zásuvek	120		<p>Kartotéka kovová, pevně svařená, 6 - zásuvková pro uložení dokumentů formátu A5. Rozměry kartotéky: výška 1320 mm, hloubka 600 mm, šířka 520 mm. Vnitřní rozměr zásuvky: výška 280 mm, hloubka 500 mm, šířka 325 mm. Uzamykání pomocí centrálního cylindrického zámku se dvěma klíči. Kartotéka bude opatřena technologií výsuvu pouze jedné zásuvky. Nosnost zásuvky minimálně 40 kg. Kvalitní teleskopické výsuvy s lehkým chodem. Zásuvky s plným výsuvem (100%). Kartotéka bude mít rektifikační nožky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Perforace dna zásuvky pro dělicí příčky. Korpus kartotéky bude v barevném provedení - práškový vypalovací lak RAL 7011/mat. Čela zásuvek budou z LTD desky o tloušťce 18 mm a v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a uchytí budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Zásuvky budou opatřeny plastovým štítkem pro vložení jmenovky. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
9	Lehátko pro pacienty	25		<p>Dvoudílné vyšetřovací lehátko s náklonným zádovním dílem od 0° do + 60° nadlehčováním plynovou pružinou. Nosnost lehátka minimálně 150 kg. Lehátko bude obsahovat držák na roli zdravotnické papírové podložky. Lehátko bude mít rektifikační šrouby k vyrovnání nerovnosti podlahy. Lehátko bude čalouněno koženkou v bílé barvě. Konstrukce bude s povrchovou úpravou práškovým nástřikem bílé barvy. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

10a	Nástrojový stůl s nástavcem	40		<p>Rozměr: 850x480x640 mm. Konstrukce vozíku bude z nerezové oceli AISI304 s antivibrační výtuhou. Pracovní deska a madla budou z nerezové oceli AISI304. Centrální zamykání zásuvek. Čelo zásuvky bude vybaveno pryžovým profilem po celém obvodu, zaručující prachotěsnost. Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z trvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami. Čelo zásuvky bude v barevném provedení bílá/vysoký lesk. Vnitřní prostor zásuvky bude možné rozdělit pomocí vyjímatelných plastových příček. Zásuvky budou osazeny na kvalitních teleskopických plnovýsuvcích s dotahem a dotlumením. Nosnost každé zásuvky 20 kg. Nástavba obsahuje: 3 velké a 5 středních plastových zásuvek. Nástavba je pevně spojena s vozíkem. Stůl bude mít 4 otočná kola, d=12,5 cm, 2x brzda, 4x rohový nárazník z odolného plastu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
10b	Nástrojový stůl - zubní ordinace	10		<p>Rozměr: výška: 102 mm, šířka: 750 mm, hloubka: 55 mm. Konstrukce vozíku bude z nerezové oceli AISI304 s antivibrační výtuhou. Pracovní deska a madla budou z nerezové oceli AISI304. Centrální zamykání zásuvek. Čelo zásuvky bude vybaveno pryžovým profilem po celém obvodu, zaručující prachotěsnost. Zásuvka bude kryta kompaktním čelem z trvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami. Čelo zásuvky bude v barevném provedení bílá/vysoký lesk. Vnitřní prostor zásuvky bude možné rozdělit pomocí vyjímatelných plastových příček. Zásuvky budou osazeny na kvalitních teleskopických plnovýsuvcích s dotahem a dotlumením. Nosnost každé zásuvky 20 kg. Stůl bude mít 4 otočná kola, d=12,5 cm, 2x brzda, 4x rohový nárazník z odolného plastu. Celková nosnost vozíku min. 140 kg. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
11	Lékárna	50		<p>Rozměr: výška: 1950 mm, hloubka: 400 mm, šířka: 920 mm. Léková skříň bude vyrobená z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovým vypalovacím lakováním. Horní dvířka budou prosklená, bezpečnostní kalené sklo. Dveře budou opatřeny rozvorovými cylindrickými zámky, každý se dvěma klíči. Police v horní části lékárny budou z bezpečnostního skla s plošnou nosností min. 20 kg. Police ve spodní části lékárny budou plechové s plošnou nosností min. 60 kg. Police budou výškově přestavitelné. Zavírání s tlumenými dorazy. Korpus bude v barevném provedení práškový vypalovací lak RAL 7011/mat. Dvířka budou v barevném provedení práškový vypalovací lak RAL 9013/ mat (jemná struktura) - bílá barva. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

12	Skříň	80		<p>Dvoudveřová kancelářská skříň (2x sekce s šířkou 600 mm). Rozměr: výška 1900 mm, hloubka 600 mm, šířka 1200 mm. Korpus a dveře skříně budou vyrobeny z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32 mm. Police budou z laminované dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříně budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
13	Skříňka pojízdná malá	40		<p>Mobilní kancelářská skříňka, kombinace uzamykatelných zásuvek a volných polic. Výška 650 mm, hloubka 600 mm, šířka 1200 mm. Korpus skříňky a police budou vyrobeny z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany budou v barvě desky. Čelní desky zásuvek budou z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany v barvě desky. Kování pro vysokou zátěž. Kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky. Barva korpusu skříně a polic budou v barevném provedení šedá/mat U963 ST9. Čela zásuvek, žada budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Skříňka bude na čtyřech černých pojízdných kolečkách vhodných pro vinilovou podlahu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
14	Šatní skříň	40		<p>Třídveřová kancelářská skříň (3x sekce s šířkou 600 mm). Rozměr: výška 1900 mm, hloubka 600 mm, šířka 1800 mm. Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Ve spodní části vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32 mm z desek LTD o tloušce 18 mm. Vnitřní pevná mezistěna z lamino dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, šatní tyč. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Rektifikace. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: rozměr, uspořádání a vybavení skříně budou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a požadavkům lékařů za předpokladu dodržení materiálového řešení</i></p>

15	Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře	40		<p>Rozměr: Výška min 1900 mm, hloubka 430-450 mm, šířka 1200 mm. Korpus a dveře skříňě budou vyrobeny z laminové dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z laminové dřevotřískové desky (LTD), na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min. 5 mm, výška 3/5 na kovových závěsech s krytkou. 5 přestavitelných polic s možností volby polohy po 32 mm. Police budou z laminované dřevotřískové desky (LTD) o tloušce 18 mm. Korpus skříňě (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení šedá/U963 ST9. Dveře skříňě budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříňě budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Skříň bude opatřena rektifikací. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina bude pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříňě.</p>
16a	Mobilní skříňka (kontejner)	80		<p>Kontejner - čtyřzásuvkový, vrchní zásuvka - tužkovník. Rozměry kontejneru (v x š x h) 615 x 430 x 600 mm. Korpus kontejneru a čela zásuvek budou vyrobeny z lamino desek tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě desky. Korpus kontejneru bude v barevném provedení šedá/ U963 ST9. Čela zásuvek budou v barevném provedení bílá/ vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky. Zámek v čele horní zásuvky, centrální pro všechny zásuvky. Kontejner bude na čtyřech černých pojízdných kolečkách vhodných pro vinilovou podlahu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>
16b	Mobilní skříňka	40		<p>Kontejner - čtyřzásuvkový, vrchní zásuvka - tužkovník. Rozměry kontejneru (v x š x h) 730 x 450 x 600 mm. Korpus kontejneru a čela zásuvek budou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě desky. Korpus kontejneru bude v barevném provedení šedá/ U963 ST9. Čela zásuvek bude v barevném provedení bílá/ vysoký lesk W1000 PG/ST2. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž. Kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky. Zámek v čele horní zásuvky, centrální pro všechny zásuvky. Kontejner bude na čtyřech černých pojízdných kolečkách vhodných pro vinilovou podlahu. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

17 Skříňka spodní s dřezem Medlin

40



Skříň

Rozměr: š 80cm, v 82cm, h 50cm. Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Záda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace.

Nerezový dvoudřez s odkapávací plochou

Rozměry 116,0 x 51,0 cm.

Hloubka vany dřezu 18,5 cm.

Dřez je určen pro horní montáž do minimálně 800 mm široké skříňky.

včetně:

- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sítkový ventil 6/4" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4"
- otvor na baterii

Stojánková dřezová páková baterie

Povrch baterie bude v provedení lesklý chrom.

Výška baterie: 22,9 cm.

Válcové tělo o průměru 5,1 cm.

Plochá ovládací páka s půdorysným zaoblením. Keramická kartuše. Otočný výtok 360°.







2x rohový ventil G1/2".

Pracovní deska

Pracovní deska o tl. 38 mm, sokl v 150 mm. Pracovní deska bude v barevném provedení F160-ST9 mramor marmarský, sokl systémový nerez broušený s dotiskem.


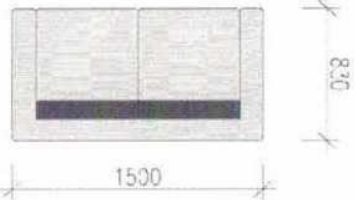

Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.

Poznámka: Rozměry skříňky s budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.

18	Skříň spodní D1L Medlin	60	   	<p>Skříň Rozměr: š 60cm, v 82cm, h 50cm. Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skřine budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Záda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace.</p> <p>Nerezový dřez s odkapávací plochou rozměry 78 x 43,5 cm výřez: 76 x 41,5 cm dřez: 36 x 35 x 14,5 cm včetně: - sítkový ventil 3 1/2" s přepadem - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - otvor na baterii</p> <p>Stojánková dřezová páková baterie Povrch baterie bude v provedení lesklý chrom. Výška baterie: 22,9 cm. Válcové tělo o průměru 5,1 cm. Plochá ovládací páka s púdorysným zaoblením. Keramická kartuše. Otočný výtok 360°. 2x rohový ventil G1/2".</p> <p>Pracovní deska Pracovní deska o tl. 38 mm, sokl v 150 mm. Pracovní deska bude v barevném provedení F160-ST9 mramor marmarský, sokl systémový nerez broušený s dotiskem. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky s budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možností kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i></p>
19	Skříň spodní Z8 Medlin	60	 	<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 40cm, v 82cm, h 50cm. 4-zásuvková skříňka. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skřine budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Záda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace.</p> <p>Pracovní deska Pracovní deska o tl. 38 mm, sokl v 150 mm. Pracovní deska bude v barevném provedení F160-ST9 mramor marmarský, sokl systémový nerez broušený s dotiskem. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky s budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možností kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>

20	Skříňka horní H2LSZ Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 80cm, v 72cm, h 30cm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříně bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Osvětlení Osvětlení bude zafrézované po celé délce horních skříněk. Vestavný hliníkový ALU profil v barevném provedení stříbrná. S příkonem 12 W/m. Dotykový ovladač. Barva denní bílá (4000 – 5000 K). Včetně napájecího zdroje. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
20a	Polička	37		<p>Polička bude vyrobena z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě poličky. Polička bude v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda poličky budou ze stejného materiálu jako polička. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry poličky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
21	Skříňka horní H1LSZ Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 60cm, v 72cm, h 30cm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Žáda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříně bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli hranatého PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Osvětlení Osvětlení bude zafrézované po celé délce horních skříněk. Vestavný hliníkový ALU profil v barevném provedení stříbrná. S příkonem 12 W/m. Dotykový ovladač. Barva denní bílá (4000 – 5000 K). Včetně napájecího zdroje. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skříňky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>

22	Skříňka horní H3LSZ Medlin	60		<p>Korpus a dveře skříně bude vyroben z lamino dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, ABS hrany budou v barvě korpusu a dveří. Rozměr: š 40cm, v 72cm, h 30cm. Korpus skříně (boky, půda, dno a police) bude v barevném provedení - šedá/U963 ST9. Dveře skříně budou v barevném provedení bílá/vysoký lesk W1000 PG/ST2. Záda skříně budou v barevném provedení bílý sololak. Zavírání dveří s tlumeným dorazem. Skříň bude uzamykatelná. Veškerá madla a úchyty budou z imitace broušené nerezové oceli tvaru PORTA 160. Kování bude pro vysokou zátěž, rektifikace. Osvětlení Osvětlení bude zafrézované po celé délce horních skříněk. Vestavný hliníkový ALU profil v barevném provedení stříbrná. S příkonem 12 W/m. Dotykový ovladač. Barva denní bílá (4000 – 5000 K). Včetně napájecího zdroje. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry skřínky budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
23a	Lednička - samostatně stojící	20		<p>Volně stojící kombinovaná chladnička. Výška lednice minimálně 85 cm. Objem chladničky minimálně 118 l a objem mrazáku minimálně 15 l. Energetická třída A++. Mechanické ovládání. Automatické odmrazování chladicí části.</p>
23b	Lednička - vestavná	20		<p>Vestavná kombinovaná chladnička. Výška maximálně 82 cm. Objem chladničky 97 litrů a objem mrazničky 17 litrů. Energetická třída A++. Mechanické ovládání. Automatické odmrazování chladicí části.</p>
24	Věšák pro pacienty	120		<p>Stojanový věšák z hliníku nebo jiného kovu s práškovou úpravou, se základnou čtvercového průřezu, výška věšáku min. 1800 mm. Barevné provedení RAL 7011/mat. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek.</p>

25	Věšáková stěna	40		<p>Věšáková stěna - laminová dřevotříska (LTD) tloušťky 18 mm s hranami ABS tl. 2 mm v barvě věšákové desky. 3 chromové háčky. Věšáková stěna bude v barevném provedení šedá/U963 ST9. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry věšákové stěny budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem kontrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu.</i></p>
26	Sedací souprava v lékařském pokoji	40		<p>Dvoumístná sedací souprava o rozměru 1500 x 830 mm. Sedací souprava bude mít kovové podnoží. Látkový potah s vysokou odolností, který bude snímatelný pro snadnou údržbu, platí i pro látkový potah polštářů. Područky budou mít šířku 160 mm. Podnoží bude v barevném provedení kov RAL 7011 mat. Látkový potah sedací soupravy - korpus Moon C/33 světle béžová barva. Polštáře sedáku budou mít barevné provedení Moon C/17 zelená barva. Tvarové provedení viz. ilustrační obrázek. <i>Poznámka: Rozměry sedací soupravy jsou pouze orientační, konečné rozměry sedací soupravy budou vždy přizpůsobeny možnostem konkrétního zdravotnického zařízení a požadavkům lékaře.</i></p>
13a	Křeslo	80		<p>Křeslo k sedací soupravě o rozměru cca 830 x 830 mm. Křeslo bude mít kovové podnoží. Látkový potah s vysokou odolností, který bude snímatelný pro snadnou údržbu, platí i pro látkový potah polštářů. Područky budou mít šířku 160 mm. Podnoží bude v barevném provedení kov RAL 7011ú mat. Látkový potah sedací soupravy - korpus Moon bude v barevném provedení C/33 světle béžová. Polštáře sedáku budou mít barevné provedení Moon C/17 zelená barva.</p>
<p>Veškeré výrobky budou před samotnou instalací a výrobou odsouhlaseny zadavatelem. Toto odsouhlasení proběhne ze strany zadavatele písemnou formou.</p>				
<p>Příložená fotodokumentace má zobrazovat pouze tvarovou a designovou podobu soutěžených interiérových výrobků, jedná se tedy pouze o ilustrační fotografie, jež nejsou pro plnění závazné.</p>				
<p>Tvarová podoba (rozměry apod.) jsou pro dodavatele závazná, výrobky budou vyrobeny v největší kvalitě (kvalitní řemeslné zpracování).</p>				
<p>Poznámka: při použití materiálu LTD desky budou všechny hrany ošetřeny hranou ABS v barvě schodné s barvou plochy desky.</p>				

Příloha č. 2 - Cenová nabídka

Čj:ZZ-687-7/R-2018

č.	Typ	Specifikace typu	Počet kůsů	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
1a	Lavice pro pacienty - dvoumístná		40	8 740 Kč	10 575 Kč	349 600 Kč	423 016 Kč	
1b	Lavice pro pacienty - třímístná		40	9 790 Kč	11 845 Kč	391 600 Kč	473 836 Kč	
2	Pracovní křeslo		80	5 490 Kč	6 643 Kč	439 200 Kč	531 432 Kč	
3	Židle pro pacienty		120	2 121 Kč	2 566 Kč	254 520 Kč	307 969 Kč	
4a	Pracovní stůl		80	3 180 Kč	3 848 Kč	254 400 Kč	307 824 Kč	
4b	Pracovní stůl		80	2 920 Kč	3 533 Kč	233 600 Kč	282 656 Kč	
5	Stolek		40	2 720 Kč	3 291 Kč	108 800 Kč	131 648 Kč	
6	Jídelní stůl v lékařském pokoji		40	3 120 Kč	3 775 Kč	124 800 Kč	151 008 Kč	
7	Konferenční stolek v lékařském pokoji		40	2 605 Kč	3 152 Kč	104 200 Kč	126 082 Kč	
8a	Kartotéka - 4 zásuvky		160	7 920 Kč	9 583 Kč	1 267 200 Kč	1 533 312 Kč	
8b	Kartotéka - 6 zásuvek		120	15 720 Kč	19 021 Kč	1 886 400 Kč	2 282 544 Kč	
9	Lehátko pro pacienty		25	6 745 Kč	8 161 Kč	168 625 Kč	204 036 Kč	
10a	Nástrojový stolek s nástavcem		40	12 780 Kč	15 464 Kč	511 200 Kč	618 552 Kč	
10b	Nástrojový stolek - zubní ordinace		10	11 315 Kč	13 691 Kč	113 150 Kč	136 912 Kč	
11	Lékárna		50	11 562 Kč	13 990 Kč	578 100 Kč	699 501 Kč	
12	Skříň		80	9 669 Kč	11 699 Kč	773 520 Kč	935 959 Kč	
13	Skříňka pojízdná malá		40	4 748 Kč	5 745 Kč	189 920 Kč	229 803 Kč	
14	Šatní skříň		40	10 990 Kč	13 298 Kč	439 600 Kč	531 916 Kč	
15	Knihovna		40	6 890 Kč	8 337 Kč	275 600 Kč	333 476 Kč	
16a	Mobilní skříňka (kontejner)		80	4 260 Kč	5 155 Kč	340 800 Kč	412 368 Kč	
16b	Mobilní skříňka		40	4 542 Kč	5 496 Kč	181 680 Kč	219 833 Kč	
17	Skříňka spodní s dřezem	17a	Skříňka spodní bez dřezu	20	7 120 Kč	8 615 Kč	142 400 Kč	172 304 Kč
		17b	Skříňka spodní s dřezem, pákovou baterií	20	11 124 Kč	13 460 Kč	222 480 Kč	269 201 Kč
18	Skříň spodní DL	18a	Skříňka spodní bez dřezu	30	5 608 Kč	6 786 Kč	168 240 Kč	203 570 Kč
		18b	Skříňka spodní s dřezem, pákovou baterií	30	9 096 Kč	11 006 Kč	272 880 Kč	330 185 Kč
19	Skříň spodní Z8 Medlin		60	4 920 Kč	5 953 Kč	295 200 Kč	357 192 Kč	
20	Skříňka horní H2LSZ Medlin		60	3 768 Kč	4 559 Kč	226 080 Kč	273 557 Kč	
20a	Polička		37	2 683 Kč	3 246 Kč	99 271 Kč	120 118 Kč	
21	Skříňka horní H1LSZ Medlin		60	3 468 Kč	4 196 Kč	208 080 Kč	251 777 Kč	
22	Skříňka horní H3LSZ Medlin		60	3 168 Kč	3 833 Kč	190 080 Kč	229 997 Kč	
23a	Lednička - samostatně stojící		20	5 720 Kč	6 921 Kč	114 400 Kč	138 424 Kč	
23b	Lednička - vestavěná		20	7 360 Kč	8 906 Kč	147 200 Kč	178 112 Kč	
24	Věšák pro pacienty		120	1 617 Kč	1 957 Kč	194 040 Kč	234 788 Kč	
25	Věšáková stěna		40	932 Kč	1 128 Kč	37 280 Kč	45 109 Kč	
26	Sedací souprava v lékařském pokoji		40	10 160 Kč	12 294 Kč	406 400 Kč	491 744 Kč	
27	Křeslo		80	5 720 Kč	6 921 Kč	457 600 Kč	553 696 Kč	
Cena celkem						12 168 146 Kč	14 723 457 Kč	

Změnový list – Dodávka zdravotnického nábytku

Snížení množství položky č. 9 – Lehátko pro pacienty

Původní

Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Odůvodnění
40	6 745 Kč	8 161 Kč	269 800 Kč	326 458 Kč	Lékaři si ponechávají stávající lehátka pro pacienty

Změna množství

Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Odůvodnění
25	6 745 Kč	8 161 Kč	168 625 Kč	204 036 Kč	

122 422,- Kč

Nová položka č. 20a – Polička

Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Odůvodnění
37	2 683 Kč	3 246 Kč	99 271 Kč	120 118 Kč	Lékaři požadují poličky do ordinací

- 120 102 Kč

Rozdíl 2 304 Kč