

Technická specifikace

Číslo položky	Položka	Počet ks	Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE	Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží
1.	Video laryngoskop minimální technické parametry a požadavky zadavatele jsou stanoveny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace	1	ANO	- přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě - ovládání pomocí tlačítek - 8" TFT širokoúhlý monitor s rozlišením min. 1280 x 800 pixelů - Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk - Ovládání archivace přímo na flexibilním video-laryngoskopu - Operační čas s nabitou baterií min. 2,5 hodiny - Nabíjecí akumulátory - Adaptér do elektrické sítě - Lžice se zakřivením pro obtížné intubace - Integrovaný LED zdroj světla - CMOS technologie (Chip na distálním konci) - Vhodná pro vyšší stupeň desinfekce - Materiál lžice – odolný kovový materiál

Videolaryngoskop INTUBRITE VLS 8800



- samostatná integrovaná zobrazovací jednotka s barevným LCD displejem
- digitální video výstup umožňující zobrazení na dalším monitoru
- účinné protizamlžovací zařízení optiky
- digitální barevná kamera
- uživatelské nastavení zobrazení (jas, kontrast, apod.)
- systém osvětlení LED bez optických vláken součástí laryngoskopické lžice
- možnost použití různých velikostí lžic od neonatologických po oběžní pacienty
- zavádění tracheální rourky vně lžice laryngoskopu
- napájení z el. sítě (230 V)
- záložní napájení – dobíjitelná baterie, provoz z akumulátoru 2,5 hod, indikace kapacity akumulátoru na displeji zobrazovací jednotky (jedna dobíjecí baterie 3.7 Lithium Ion 800 mAh, velikost: AA, životnost: 2,5 hodiny nepřetržitého používání, dobíjení: 6 hodin)
- elektronický autotest po zapnutí přístroje
- archivace snímků a videosekvencí (SD karta, flashdisk)
- povrch přístroje a veškeré příslušenství umožňuje dezinfekci/sterilizaci nezbytnou pro opakované použití na operačním sále

Příslušenství

- 2x kovová lžice pro opakované použití – standardní dospělá a standardní pediatrická
- výškově stavitelný pojízdný stojan k provoznímu uchycení zobrazovací jednotky a uložení lžice
- veškerá propojovací kabeláž nezbytná pro napájení, ochranné pospojování a spojení laryngoskopu s jednotkou

Rukojeť - akumulátor

Jedna dobíjecí baterie 3.7 Lithium Ion 800 mAh

Velikost: AA

Životnost: 2,5 hodiny nepřetržitého používání

Dobíjení: 6 hodin

VLS 8800 Display

Velikost displeje: 8"

Obnovovací frekvence videa: 30 FPS

Video obrazovka: TFT LCD Backlit

Video výstup: NTSC / RCA konektor

DVR: 4GB SD karta

DVR statické snímky JPEG

DVR Video AVI

Lithiová baterie 4500 mAH (dobíjecí)

Životnost baterie 3,5 hodiny nepřetržitého použití, 7 hodin = doba nabíjení

Laryngoskopické lžíce - opakovaně použitelné

VLS 2, 100 mm (L) Proximální 17 mm (H) - dětská

VLS 3, 136 mm (L) Proximální 25 mm (H) - dospělá



Materiál z lékařské nerez oceli

Kamera: CMOS

Okno kamery: opticky čistý safír s protizamlžovacím systémem


Osvětlení Patentovaný systém osvětlení IntuBrite

- Bílá vysoce jasná LED
- UV-Blended LED

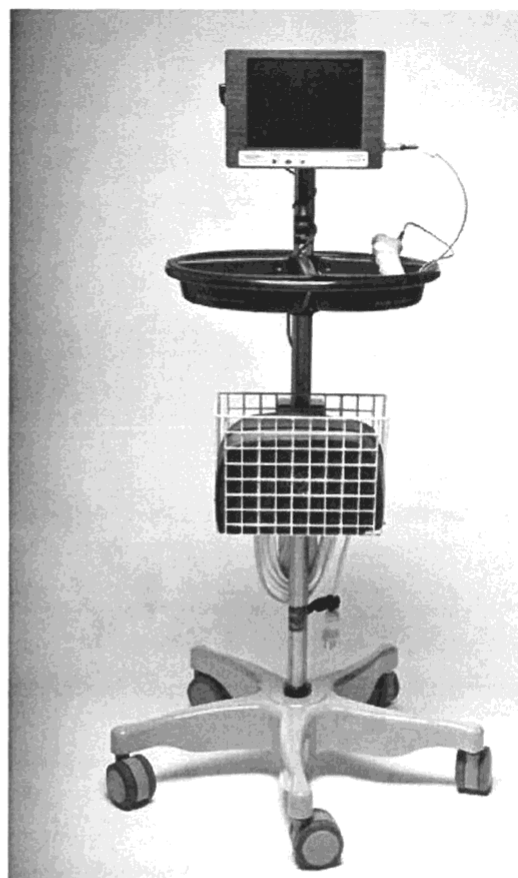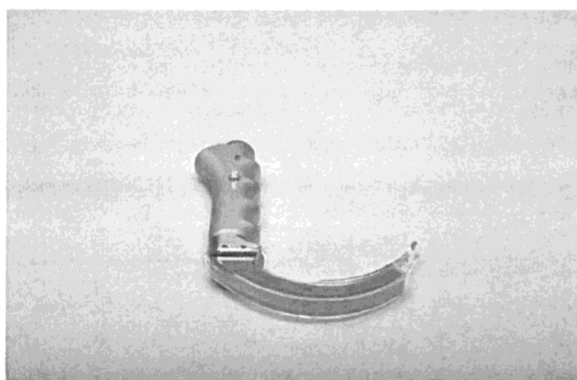

VLS 8800 Video Laryngoscope

INTU**B**RITE

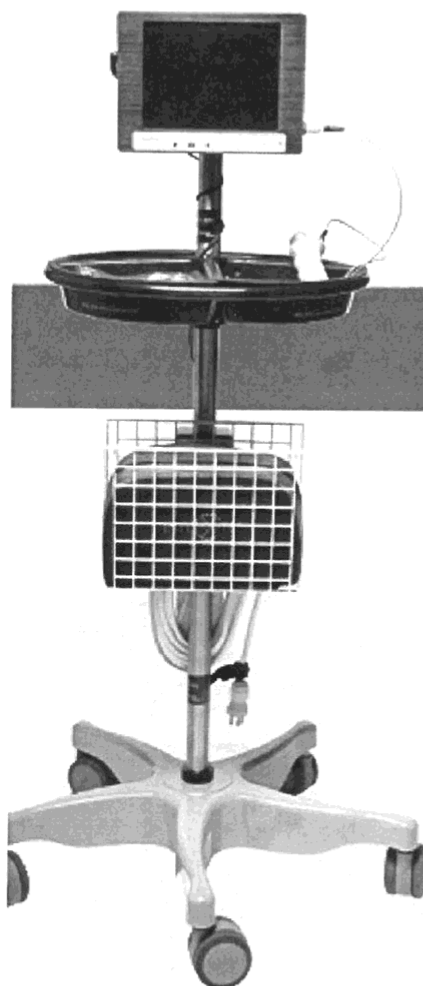

BEST IN CLASS VIDEO CAPABILITY

- Near-high definition images feature over 2x the resolution of competitive devices
- Patented IntuBrite White/UV LED combination for enhanced airway illumination
- Modular design allows custom component setup for any video laryngoscopy need, in any environment

VIEWING AND RECORDING

- Still picture and video recording capability via removable SD card for documentation and retention

AFFORDABILITY

- Higher quality video system with more capability at less cost than comparable competitor devices

RELIABILITY

- High tech, simple to operate components
- Connectors and cabling designed for reliability, durability and convenient cleaning

- No new training: Use familiar direct laryngoscopy techniques
- Video handles operate all IntuBrite laryngoscope blades: Original disposable, reusable and new high resolution video blades
- Move seamlessly from traditional direct laryngoscopy to video view
- "Instant On" video monitors for immediate functionality
- Easy care and sterilization of handle and blade components

FLEXIBLE POWER OPTIONS

- 120v line or long-life rechargeable lithium battery power
- Reusable VLS video blades available in pediatric VLS 2, adult VLS 3 and VLS 4A for difficult adult intubations
- Sapphire lens with proprietary anti-fog heating system

L033-1012 Rev C

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Já, podepsaná:

Mediset-Chironax s.r.o.

se sídlem Stradonická 2311/6, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice

IČ: 482 00 417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2429

zastoupená panem Pavlem Ratajem, jednatelem

tímto uděluji generální plnou moc



k tomu, aby mě zastupoval v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení činil veškerá právní jednání mým jménem, zejména uzavíral veškeré smlouvy, a to vyjma právních jednání vyžadujících ze zákona nebo z jiného obecně závazného právního předpisu zvláštní plnou moc.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou.

Občanský
Právní

Právní
Číslo
Adresa

Právní
Číslo

Právní
Číslo