

KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2019/3/03-KS

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Prodávající:

FD servis Praha, s.r.o.

jejímž jménem jedná Jiřina Mašková, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63275

Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha 4

IČ: 25710427

DIČ: CZ25710427

Bankovní spojení: číslo účtu 19-8790740287, kód banky 0100, Komerční banka a.s.

a

Kupující:

Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo ke čtyřem kusům sanitních vozidel - mobilních jednotek intenzivní péče typ C splňujících podmínky *ČSN-EN 1789 + A2 nebo novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba):

Výrobce: Volkswagen,
Obchodní označení: Transporter 2,0 TDI 4Motion,

příčemž podrobná specifikace tohoto sanitních vozidel tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je totožná s technickou specifikací podle zadávací dokumentace zadávacího řízení (*dále též jen „zboží“*).

2. Součástí zboží je dále:

- dodávka veškerých dokladů k vozidlům s řádně vepsanými údaji (včetně velkého technického průkazu), nezbytných k provozování vozidel,

- dodávka veškerých návodů k obsluze v českém jazyce,
- dodávka odpovídající technické dokumentace,
- dodávka seznamu pravidelných záručních prohlídek prováděných prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem.

Předmětem této smlouvy je dále:

- doprava zboží do místa dodání;
- individuální a komplexní vyzkoušení dodaného zboží a jeho uvedení do plného provozu.

3. Prodávající se zavazuje, že dodaná sanitní vozidla včetně zástavby a příslušenství, jakož i všechny další součásti předmětu smlouvy, budou odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a budou homologovány pro provoz v ČR. Prodávající se dále zavazuje, že dodané zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této smlouvy budou v souladu se všemi zadávacími podmínkami v zadávacím řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „ZZS ZK – mobilní jednotky intenzivní péče – typ C - 2019“ provedeném kupujícím jako zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2019/3/03) a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím v tomto zadávacím řízení. Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky v zadávacím řízení podle předchozí věty a nabídka prodávajícího podle předchozí věty tvoří nedílné součásti této smlouvy jako její přílohy č. 2 a 3, jejichž znění jsou uložena v archívu kupujícího jako součásti dokumentace o zadání veřejné zakázky.

4. Kupující se zavazuje zboží v době stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží (všechny čtyři kusy sanitních vozidel) je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem

- 11.238.360,- Kč bez DPH (slovy jedenáctmilionůdvěstětřicet osmtisíc tři sta šedesát korun českých bez DPH).

V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.

2. Kupní cena uvedená v tomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a konečná pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, jiné přírážky a další náklady prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně dodávky zboží. Kopie předávacího protokolu musí být přiložena k faktuře prodávajícího.

4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení kupujícímu.

5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti ve sjednané délce běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6. Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

IV. Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín.
2. Předtím než prodávající aplikuje na sanitní vozidla určená k dodání kupujícímu venkovní grafické označení retroreflexní mikroprismatickou fólií, je prodávající povinen předložit kupujícímu v elektronické podobě k odsouhlasení návrh venkovního grafického označení vozu retroreflexní mikroprismatickou fólií.
3. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do dne 30.11.2020. Prodávající oznámí termín dodání vozidla kupujícímu nejméně 7 dní předem.
4. Veškeré doklady k vozidlu s řádně vepsanými údaji, nezbytné k provozování vozidla, budou dodány (včetně velkého technického průkazu) k termínu dodání. Při dodržení této podmínky bude za den skutečného dodání zboží považován den fyzického předání vozidla, v opačném případě se jedná o nesplnění termínu dodání. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem fyzického předání a převzetí vozidla.
5. Kupující není povinen zboží převzít, pokud dodávané zboží vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného zboží bude sepsán a smluvními stranami podepsán předávací protokol.
6. Za nesplnění termínu dodání zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, kterou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 14 dnů ode dne, kdy byl k zaplacení smluvní pokuty kupujícím vyzván.

V. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v trvání 24 měsíců, a to na celý rozsah dodávky. Prodávající dále poskytuje kupujícím pětiletou záruku proti prorezavění karoserie a nástavby dodaného vozidla. Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy (nebo jeho části). V této době zodpovídá prodávající za to, že předmět smlouvy (nebo jeho část) bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Po celou dobu záruční doby prodávající

odpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

2. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady do doby, kdy je předmět smlouvy (nebo jeho část) po odstranění vady převzat nebo mělo být převzat kupujícím, se nezapočítává do záruční doby předmětu smlouvy (nebo jeho části).
4. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů na zboží nejméně po dobu 10 let ode dne předání a převzetí zboží.
5. Pro odpovědnost za vady zboží platí, není-li sjednáno jinak, ustanovení §2099 a násl. občanského zákoníku.

VI. Ostatní ujednání

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy okamžikem předání a převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zboží.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení povinností prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího s uskutečněním dodávky zboží přesahující 15 kalendářních dnů.
3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti smlouvy.

Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností kupujícího.

4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha číslo 1 - Specifikace zboží

Příloha číslo 2 - Nabídka prodávajícího, jejíž znění je uloženo v archívu odběratele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky

Příloha číslo 3 - Zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), jejíž znění je uloženo v archívu odběratele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky

Ve Praze dne 20.12.2019

Ve Zlíně dne

.....
prodávající
FD servis Praha, s.r.o.
Jiřina Mašková
jednatel

**JUDr. Josef
Valenta**
Digitálně podepsal
JUDr. Josef Valenta
Datum: 2020.01.03
06:55:23 +01'00'

.....
kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěv. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

**Jiřina
Mašková**
Digitálně podepsal
Jiřina Mašková
Datum: 2019.12.20
17:53:56 +01'00'

Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2019/3/03-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

FD servis Praha, s.r.o.

.....

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace zboží:

Sanitní automobil kategorie C – mobilní jednotka intenzivní péče podle *ČSN-EN 1789 + A2 nebo novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)

Podvozek

s kabinou a skříňovou nástavbou o vnitřních rozměrech ambulantního prostoru:

Délka – min 2800 mm, Šířka – min 1880 mm, Výška – min 1800 mm

- Celková délka vozidla max. 5700 mm.
- Šířka vozidla max. 2300 mm
- Max. výška vozidla 2700 mm vč. veškeré výbavy
- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla max. 3500 kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem
- Motor vznětový o výkonu min. 120 kW, emisní norma min. *EURO 6
- Pohon 4x4 s uzávěrkou diferenciálu

Výbava vozidla

- Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém brzd, uzávěrka mezinápravového diferenciálu, protiskluzová regulace a regulace točivého momentu
- Elektronický stabilizační program včetně brzdového asistentu
- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy
- Zesílené tlumiče vpředu a vzadu
- imobilizér, otáčkoměr
- 2 funkční klíče
- Tempomat

- Nezávislý přehřev oleje motoru při napojení vozidla na 220 V
- Barva žlutá RAL 1016
- Alternátor min 180 A
- Druhý akumulátor 12 V / min. 80Ah / 420 A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 220 V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10 V, v ambulantním prostoru zvuková signalizace při pokles pod 10,5 V
- Ukazatel stavu obou baterií (napětí, kapacita)
- Airbag řidiče + předpínač bezp. pásu
- Airbag pro spolujezdce + předpínač bezpečnostního pásu
- Multifunkční ukazatel – palubní počítač
- Mlhové světlomety integrované do nárazníku s přisvěcováním do zatáčky, nebo hlavní či jiné světlomety s přisvěcováním do zatáčky
- Dálkové LED světlomety (možno i jako přídatná světla v předním nárazníku s homologací pro silniční provoz)
- Konzola přístrojové desky pro dodatečné spínače s 1 -DIN šachtou
- Klimatizace s mechanickou nebo samočinnou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče
- Příprava na rádio, anténa, 4 reproduktory (2x kabina řidiče, 2x sanitní prostor)
- Autorádio s funkcí TMCI a RDS, otočným regulátorem hlasitosti, výkonem min. 4 x 50 W, tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru.
- Min. 6 -stupňová automatická převodovka
- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla
- Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla
- Aerodynamické ofuky – deflektory bočních oken (řidiče a spolujezdce)
- Sedadla v kabině 1+1, výškově stavitelná, vč. loketní a bederní opěry
- Úprava zadní nápravy umožňující regulaci světlé výšky
- Kryty kol
- Osazení vozidla typem pneumatik odpovídajících celkové nosnosti
- Sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks), udávaná hodnota na povinných štítcích: brzdná dráha na mokru nejhůře C a hlučnost max. 73 dB.
- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- zajišťovací klín pod kolo pro bezpečné odstavení vozidla ve svahu
- Ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, náradí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby:

- Nástavba skříňového typu v AL nebo obdobném provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropní a boční kabelové kanály, testováno dynamickou zkouškou dle *ČSN DIN 1789 + A2 nebo novější
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou max. 430 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru max. 680 mm od terénu

- Minimální rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře - 1800 / 1000 mm, zadní křídlové dveře – 1900 / 1270 mm
- boční posuvné dveře ambulantního prostoru s posuvným oknem, dveře v žádné poloze nesmí přesahovat půdorys vozidla
- Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené
- Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů
- Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů
- Úložný prostor na levé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (včetně úchytů pro uložení 1 ks schodolez, 1 ks extenční dlaha a 1 ks vyprošťovací vesty používané u ZZS ZK) osvětlení LED svítidlem

Specifikace sanitní zástavby:

Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu této kupní smlouvy s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Dodavatel doloží při podání nabídky do zadávacího řízení úplný protokol o úspěšném provedení dynamické nárazové zkoušky skříňové nástavby podle normy *ČSN-EN 1789 v požadované konfiguraci (okna, dveře) včetně obrazové části, a nebude dokládat bezpečnost skříňové nástavby výpočtem.

1/ Kabina řidiče

- V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel, nikoliv ze dřeva, pro zabudování radiostanice **Matra a radiostanice **Motorola GM 360 (160MHz), přihrádky na dokumentaci, 2 ks ručních vysílaček a ovládacích prvků;
- Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru
- Dodávka a montáž antény 1+1 pro vysílačky, umístěné na střeše vozidla, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění antén. Všechny kabelové spoje musí být přístupné.
- Dodávka a montáž kabeláže pro vysílačku **Matra se samostatným jištěním
- Dodávka a montáž napájecího kabelu pro radiostanici **Motorola vč. konektoru se samostatným jištěním
- Mapová svítlna copilot v LED technologii u spolujezdce s prosvětleným vypínačem
- 2 kg hasící přístroj včetně držáku a revizní zprávy
- Ruční dobíjecí LED svítlna včetně držáku s dobíjením
- Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky.
- Dodávka a montáž kabeláže pro on-board kameru vč. konektorů se samostatným jištěním
- Dodávka a montáž kabeláže vč. držáku a konektorů pro připojení PC v prostoru pod sedadlem spolujezdce a dodávka a montáž kabeláže a držáku dotykového monitoru, ve střední části palubní desky dle přiložené obrazové dokumentace.
- Dodávka a montáž kabeláže včetně duální antény na střeše vozidla pro systém **GPS NAM NCL07 se samostatným jištěním
- Dodávka a montáž kabeláže vč. držáku pro ruční radiostanici **Matra TPH700 v kabině řidiče, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění kabeláže.
- Ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ovládací prvky v přístrojové desce, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla zadavatel během výroby

vozidla určí přesné umístění ovládacích prvků. Ovládání zvukového výstražného signálu „horním“ tlačítkem na přístrojové desce a tlačítkem na opěře levé nohy. Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče

2/ Vlastní zástavba

- Boční a zadní okna ambulantního prostoru plně polepená tónovací fólií s propustností světla 5 %, spodní nejméně 1/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií.
 - Vyztužení kufrové nástavby pro uchycení přístrojů, transportního zařízení a skříněk na zdravotnický materiál a výhledem na možnost variabilních řešení (použitý materiál AlMg3 nebo jemu obdobný)
 - Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a dezinfikovatelným bezespárovým materiálem
 - Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy
 - Možnost snadno hermeticky oddělit prostor kabiny řidiče a prostor pro pacienty
 - Zařízení umožňující hlasovou komunikaci řidiče s doprovodem v ambulantním prostoru a zvukové znamení k řidiči.
 - Výsuvný systém pro automatické nakládání a vykládání nosítek s podvozkem jednočlennou obsluhou, certifikovaný dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější s aretací nosítek dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější. Stůl nosítek s bočním posuvem v šíři min. 400 mm. Nakládací poloha při najíždění nosítek do vozidla je vodorovná, bez šikmých nájezdových ramp nebo naklápění stolu.
 - Samonakládací nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější, s plynulým polohováním zádové opěry a možností nastavení nohou do protišokové polohy, sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem a podhlavníkem, 4 bodovými bezp. pásy, s reflexním polepením bočních profilů, se sklopným držákem na infuze. Pro usnadnění manipulace s pacientem je požadován podvozek s plynulým elektro – hydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení pohonu, nabíjení baterií je zajištěno při zasunutí podvozku do systému pro nakládání a uchycení nosítek ve vozidle zcela automaticky, systém umožňuje rozšíření nosítek pro přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací sadu však kupující nepožaduje, tzn. že není součástí dodávky).
 - Odkládací prostor nad kabinou řidiče a spolujezdce pro uložení vakuové matrace
 - Výdech klimatizace v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem
 - Otevírací střešní okno kryto fólií s propustností světla 5%
 - Všechny hrany zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení s radiusem min. 3 mm
- Rozmístění zastavovacích prvků je uvedeno ve schématech níže:

Schéma nábytkové zástavby vozidla - dělicí přepážka:

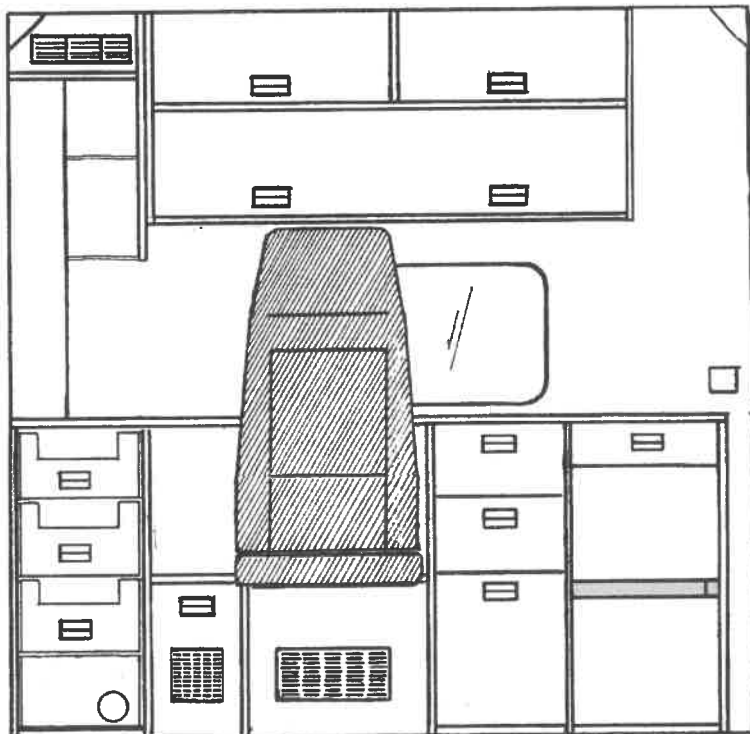


Schéma nábytkové zástavby vozidla - pravý bok:


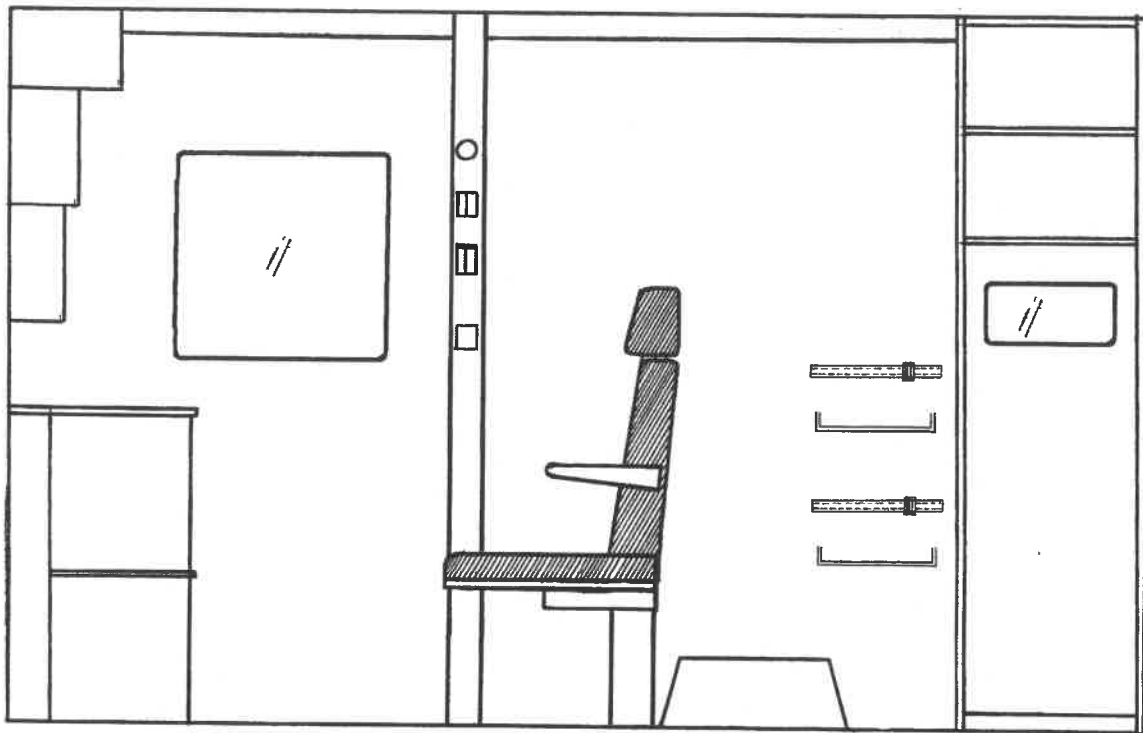


Schéma nábytkové zástavby vozidla - levý bok:

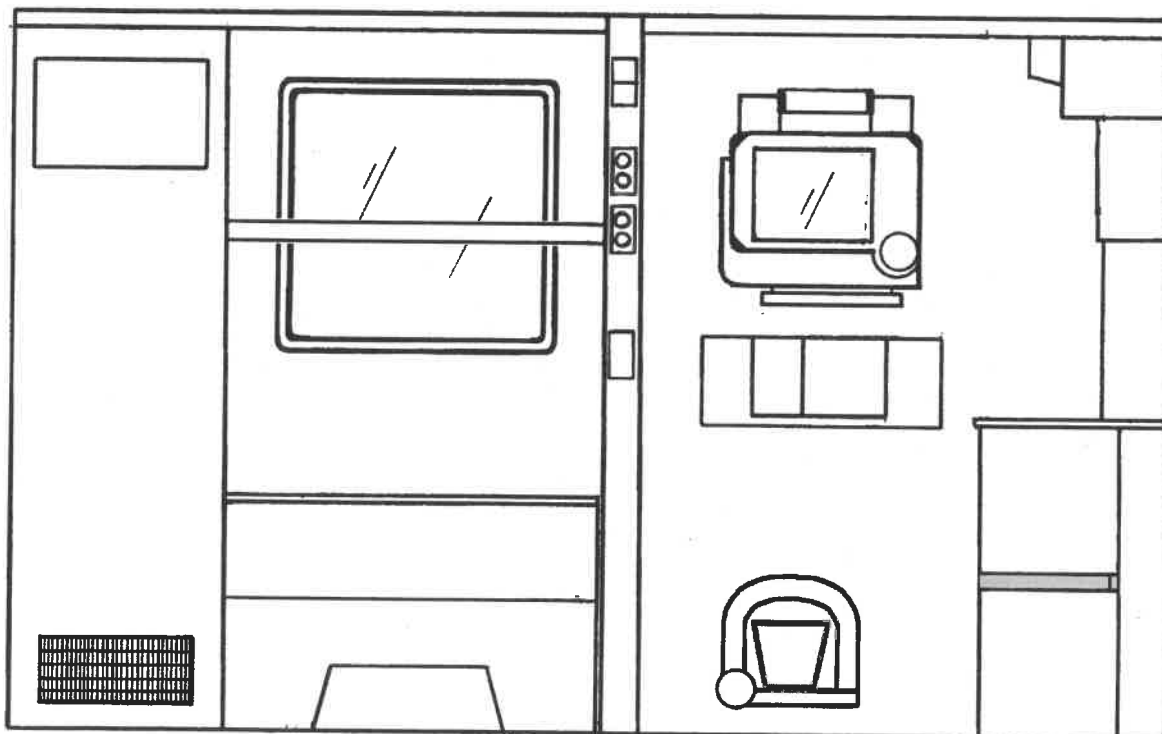

- Specifikace dělicí přepážky:
 - Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem, min. rozměry 900 x 350 mm
 - Nad kabinou řidiče tři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry š 1000 x v 240 x h 600 mm pro uložení vakuové matrace, dva s minimálními rozměry š 500 x v 300 x h 250 mm pro zdravotnický materiál. Dvířka musí být opatřeny plynovými vzpěrami.
 - Vlevo pod klimatizací skříňka s 4 plexi policemi
- Popis nábytkového modulu na přepážce:
 - pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem.
 - zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr, uložení 1 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních posuvných dveří
 - vestavěný termobox s dostatečným objemem pro uložení 6 ks roztoku á 500 ml a chladicí vložky, nastavený pro udržování stále teploty v režimu chlazení 4°C
 - výdech + dodání nezávislého topení s dostatečným výkonem dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější
 - výdech + dodání závislého vodního topení s dostatečným výkonem dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější
 - integrovaný prostor pro odpadkový koš
 - plnohodnotný sedák s integrovaným třibodovým pásem pro zdravotnický personál s minimální šířkou 45 cm. Sedadlo musí mít certifikát dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější kategorie M, s dodatečným polstrováním pro opěru hlavy osob s výškou do 200 cm nebude-li mít samotný sedák dostatečnou výšku opěradla.
 - digitální hodiny napájené z vlastní baterie

Specifikace levého boku zástavby:

- Pevné okno v zadní části boku skříně vozidla
- Ve střední části technický sloup s vývody: 5x12V zásuvka s kontrolkou LED, 2x vývod O2, 1x vývod vzduchu, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj a 2 x barevně odlišená zásuvka napájená měničem min. 600W (zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a musí být funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování), 1x zásuvka SPEAKON 2x2 se samostatnou pojistkou pro inkubátor a dole zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné rozmístění uvedených prvků.
- V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů, dodávka držáku monitoru LifePack 12 (držák AD Backpack 12 Lifepak 12 s kitem na úpravu pro LP15), montáž držáku dýchacího přístroje Medumat a odsávačky Laerdal / AcuVac Basic v sídleZZS ZK před uvedením vozidel do provozu
- Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů dle *ČSN EN 12218
- V zadní části skříňka na zdravotnický materiál pro uložení schodolezu, Scoop, extenční dlahy a vyprošťovací vesty, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla, vrchní prostor o velikosti min. d 60 cm x š 25 cm x v 30 cm se 2 policemi přístupný zevnitř výklopnými dvířky
- Na boku zadní skříňky montáž nástěnného tonometru (pouze montáž držáků, přičemž tonometr není předmětem této kupní smlouvy)

- Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem a sklopným čelem o minimálních rozměrech:
d 70 cm x š 25 cm x v 45 cm.
- V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police s pěti úložnými boxy

Specifikace pravého boku zástavby:

- Skříň pro uložení 2 ks 10L O2 lahví (přístupných z venku, včetně držáků na 2ks 10 l tlakových lahví, umožňující variabilní uspořádání 2x 10L O2 nebo 1x 10L O2 a 1x 10L vzduch) a 1ks 2L tlakové láhve, z amb. prostoru přístup pouze pro ovládání red. ventilů. Dodávka spojovací hadice vč. rychlospojek pro připojení O2 a vzduchu do rozvodu vozidla.
- Nad skříní pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami.
Sklopné sedadlo s integrovaným bezpečnostním pásem s mechanismem navíjení skrytým pod platovým obložením zádové opěry a s možností otáčení o 180 stupňů, s polohovatelnou zádovou a loketními opěrami. Minimální šířka sedáku 45 cm a dostatečná opora hlavy pro osobu vysokou 200 cm. Sedadlo musí být certifikované dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější kategorie M1.
- Dodatečné polstrování pravé stěny pro opěru hlavy osoby sedící na sklopném sedadle.
- Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, dorozumívací zařízení k řidiči, kolíbkový přepínač bodovky, reproduktory, topení, stopní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení.
- Police se záchytným systémem pro uložení batohu, sady vakuových dlah a krčních límců před skříní pro O2
- Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem

Ostatní výbava vozidla:

LED stropní osvětlení -

barva teplá bílá, vypínač s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče.

- Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítka pacienta
- Oddělené dobíjení obou baterií vozidla pomocí automatické nabíječky s výkonem min. 2x 25 A
- Nouzové orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy
- Připojení k vnější síti 230 V pomocí samoodpojovací zásuvky RETTBOX (což je jednotný systém používaný u kupujícího) v nerezovém provedení včetně připojovacího kabelu v délce 15 m
- Všechny zásuvky jištěny 30 A pojistkou
- Madlo po levé straně bočního vstupu.
- Madlo podélné pod stropem, v zadní polovině s držáky na infuze 2 ks
- Rozvod kyslíku se dvěma rychlospojky ve střední části levého boku, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění rozvodu kyslíku,
- Rozvod vzduchu s jednou rychlospojkou ve střední části levého boku, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění rozvodu vzduchu,

- Elektrické přídatné topení 220 V/2000 W s termostatem
- Ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci podsvětlené pomocí LED technologie.
- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.
- Přídatné závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce.
- Obousměrný stropní ventilátor
- Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru
- osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- nouzové osvětlení LED osvětlení max. 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru
- osvětlení prostoru tlakových láhví a venkovního úložného prostoru LED technologií, max. 0,5 W
- dodávka a montáž měniče min. 600 W vhodného pro napájení tiskárny s externím ovládáním a nastavitelným časovým doběhem po vypnutí klíče zapalování, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění a nastavení měniče,
- dodávka a montáž napájecích, ovládacích a datových rozvodů pro tiskárnu HP a tablet Panasonic, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné umístění tiskárny a dokovacího zařízení tabletu

Výstražná světelná a zvuková zařízení:

- Světelná rampa v lineární technologii s minimálně 60 LED diodami +2x halogen, boční světelné zdroje min 35 W pro osvětlení domovních čísel. Světelná rampa nesmí převyšovat světlou výšku vozidla.
- Zvukové výstražné zařízení o výkonu 200 W + 2 ploché reproduktory 100 W umístěné v přední části za maskou vozidla s možností ovládání na volantu
- V zadní části střechy 2 ks LED maják v lineární technologii minimálně 48 LED diod, minimální výška 10 cm a krytem čiré barvy. Majáky nesmí přesahovat půdorys vozidla ani nesmí přesahovat výšku sanitní nástavby
- Přední výstražná modrá světla LED v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla 2 ks, samostatně vypínatelná
- Přední výstražná modrá světla LED v lineární technologii umístěné pod zrcátka 2 ks, vypínatelné společně se světly v masce
- Modrá výstražná světla LED v lineární technologii umístěná na předních blatnících vozidla 2 ks
- Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi
- 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy, ovládání pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče
- Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným displejem v kabině řidiče + couvací senzory

- Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou fólií obdobně dle fotodokumentace uvedené níže:

Závazné barevné provedení vozidel kupujícího:





Další

Všechny zásuvky a dvířka budou vybaveny a aretovány plynovými vzpěrami, madla skříněk nepřesahují profil skřínky o více než 5 mm.

Další požadavky kupujícího na plnění technických norem u jednotlivých částí předmětu této kupní smlouvy:

Výstražná světelná technika: *EHK 65 a *EHK 10.03

Výstražná zvuková technika: *EHK 10

Transportní nosítka: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější a *ČSN EN 1865

Stůl nosítek: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější

Sedadla: kategorie M1

Dodatečná venkovní pracovní osvětlení: *EHK 10.03

Zadržovací a upevňovací systémy: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější

V Praze dne 20.12.2019

Ve Zlíně dne

.....
prodávající
FD servis Praha, s.r.o.
Jiřina Mašková
jednatel

.....
kupující
Zdravotnická záchraná služba Zlínského
kraje, příspě. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Jiřina
Mašková
Digitálně podepsal
Jiřina Mašková
Datum: 2019.12.20
17:54:43 +01'00'

JUDr. Josef
Valenta
Digitálně podepsal
JUDr. Josef Valenta
Datum: 2020.01.03
06:56:24 +01'00'