

Evidenční číslo		
PRI 149	2020	OZM/
poř. číslo	rok	pracoviště
VZI 041/101	2020	ref.
RS Evid.č.:	Datum:	

## Příloha 11

# Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

## Smluvní strany

### A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o.

se sídlem: Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7  
zastoupená: [REDACTED], jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 40068

IČO: 63983524  
DIČ: CZ63983524  
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 2104416851/2700

dále jen **prodávající**

a

### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupená: [REDACTED] elem  
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 43410/2017 ze dne 13.4.2017 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62  
DIČ: CZ 00 63 51 62  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 374027793/0300

dále jen **kupující**

## I. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ustanoveními o kupní smlouvě dle § 2079 a následujícími.
2. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu movité věci, dále jako „zboží“, smlouvou dále přesně označené, a převést na něj vlastnické právo k němu. Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem koupě, přechází na kupujícího potvrzeným převzetím zboží prostřednictvím pověřeného zaměstnance kupujícího v místě plnění, stejně jako nebezpečí škody na zboží.

3. Předmětem kupní smlouvy je také sjednání kupní ceny, platebních podmínek, postupu při předání a převzetí zboží, odpovědnosti za vady a jakost, záruky, spolu se stanovením dalších závazků smluvních stran.
4. Kupující se zavazuje zboží, které je předmětem koupě, řádně dodané a se všemi doklady dle podmínek sjednaných touto kupní smlouvou, od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu smlouvou určenými platebními podmínkami.

## II. Předmět koupě

1. Předmětem smlouvy je dodávka **zboží**:  
název: High Flow vč. příslušenství počet kusů: 17 ks,  
značka: Humid BH  
výrobce: Respicare  
za podmínek dále smlouvou podrobně určených. Přesná a podrobná specifikace zboží včetně dodávaného příslušenství je provedena věcně i cenově Přílohou smlouvy č. 1, která je její neoddělitelnou součástí. Na zboží bude uvedena značka CE včetně čísla notifikované osoby.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží takto určené jako předmět koupě dle podmínek kupní smlouvy.
3. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat veškeré doklady, které jsou potřebné k převzetí a užívání zboží, k účelu, ke kterému je určeno, zejména:
  - a) EU – prohlášení o shodě dle směrnic EU 93/42/EEC v platném znění 2007/47/EC,
  - b) návod k použití v českém jazyce, v tištěném vyhotovení a elektronické podobě na CD,
  - c) záruční list, originální dokumentaci výrobce,
  - d) instalační protokol potvrzující, že dodaný přístroj (sestava) je instalován v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou a pokyny výrobců a je funkční.
4. Součástí prodeje zboží je zajištění dopravy do místa plnění, instalace dodaného zboží podle pokynů výrobce v souladu s platnou legislativou, technickými předpisy a předpisy o bezpečnosti práce, předvedení a předání funkčního předmětu smlouvy. Dále prodávající provede zaškolení obsluhy a vyhotovení zápisu o zaškolení na formuláři kupujícího.
5. Prodávající je zavázán dodat nové nepoužité zboží, které není zatíženo právy třetích osob.

## III. Doba a místo plnění, základní dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Prodávající je povinen oznámit dodání zboží do místa plnění nejméně 2 pracovní dny před jeho dodáním.
3. Po podpisu smlouvy bude dle potřeby písemně dohodnut závazný harmonogram plnění, zajišťující návaznost činností a stanovící průběh příprav pro instalaci. Při provádění instalace bude dodavatel respektovat provoz kupujícího a postup prací koordinovat dle pokynů odpovědných pracovníků.
4. Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava.
5. Kupující je oprávněn při převzetí vadné plnění odmítnout a zjevné vady co do množství ihned vyznačit do protokolu nebo nesrovnalosti odstranit zápisem se zástupcem prodávajícího.

6. O předání a převzetí zboží, které je zdravotnickým prostředkem, bude sepsán předávací protokol, k jehož podpisu je kupujícím pověřen vedoucí oddělení BMI spolu s vedoucím klinického pracoviště, pro které je zboží/přístroj určeno. Součástí předávacího protokolu budou příslušné doklady, např.:
  - EU – prohlášení o shodě
  - Záruční listy
  - Návod pro údržbu a obsluhu zařízení
  - Provozní deník zařízení, pokud je jeho vedení výrobcem předepsáno
  - Doklad o zaškolení obsluhy
  - Kopie dokladu o proškolení prodávajícího dle § 56 zák. č. 268/2014 Sb.
7. Povinností prodávajícího je při plnění závazků dle smlouvy dodržet všechny platné zákony, normy a vyhlášky předepsané pro daný druh zboží a účel jeho použití.
8. Proávající je povinen předat zboží způsobem přiměřeným jeho provedení, do předání odpovídá za jeho zajištění proti poškození nebo znehodnocení, přitom postupuje samostatně nebo podle zvláštních dispozic kupujícího.
9. Kupující vyžaduje předání funkčního instalovaného zboží (věci) jako podmínku pro úhradu kupní ceny, předávací protokol bude v kopii přílohou faktury.
10. Dokladem o předání je Protokol o předání a převzetí zboží, a pokud byla provedena instalace – Instalační protokol k zařízení, který je také dokladem o počátku záruční doby sjednané smlouvou. Zpracování předávacího protokolu a protokolu o instalaci zařízení zajistí prodávající.
11. Kupující vyžaduje, aby prodávající zajistil poučení svých zaměstnanců a tito byli zavázáni zachovat v mlčenlivosti veškeré informace o pacientech kupujícího, se kterými se seznámí při plnění smlouvy i jen nahodile.

#### IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena sjednaná při podpisu smlouvy je závazná a jakákoli úprava ceny je možná jen na základě odůvodnění a dohody smluvních stran o takové změně. Cena zboží, které je předmětem koupě činí:

<b>Kupní cena</b>	1 143 726,00 Kč bez DPH	DPH 21 % 240 182,46 Kč	Celkem 1 383 908,46 Kč včetně DPH
-------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------------

Sjednaná cena je cenou konečnou, vč. všech souvisejících poplatků, za dodání do místa plnění včetně instalace, příp. montáže, uvedení do provozu /vyzkoušení, proškolení uživatelů a služeb po dobu záruky/ se všemi poplatky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodávka musí být vybavena potřebným spotřebním materiálem alespoň pro předvedení všech funkcí.

2. Proávající vyhotoví v den nebo po převzetí zboží, daňový doklad (fakturu). Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů po převzetí předmětu koupě.
3. Faktura /jako účetní a daňový doklad/ musí obsahovat předepsané náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů:
  - a) označení faktury a její číslo,
  - b) označení obchodní firmy, místo podnikání-sídlo, přesný údaj prodávajícího jeho zápisu v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující k podnikání,
  - c) identifikační číslo /IČ/ a DIČ prodávajícího,

- d) bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího, na který má být placeno,
  - e) označení kupujícího/nemocnice: název, sídlo, IČ a DIČ,
  - f) přesné označení zboží, množství, cenu a fakturovanou částku,
  - g) datum vystavení a odeslání faktury,
  - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - i) splatnost v souladu se smluvně stanovenou lhůtou.
4. Kupující vyžaduje, aby prodávající uvedl na daňovém dokladu přesné označení smlouvy, na základě které je dodání realizováno. V případě dodání zboží musí být přílohou daňového dokladu předávací protokol.
  5. Kupující je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti
    - obsahuje-li nesprávné cenové údaje
    - obsahuje-li nesprávné náležitosti
    - chybí-li k faktuře některé z náležitostí nebo dohodnuté přílohy
  6. Úhrada dohodnuté ceny bude prováděna bezhotovostním platebním stykem. Za úhradu fakturované ceny se považuje její odesání z účtu kupujícího.
  7. Prodávající není oprávněn převést svou pohledávku za kupujícím vzniklou z tohoto smluvního vztahu na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
  8. V případě prodlení smluvních stran s plněním závazků dle smlouvy může strana oprávněná požadovat po straně, která je v prodlení s plněním svého závazku, úhradu úroku z prodlení ve výši odpovídající ceně plnění a způsobu výpočtu úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, podle občanského zákoníku.
  9. Pro případ prodlení s plněním závazku prodávajícího dodat zboží ve stanovené lhůtě uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 1000,00 Kč včetně DPH, a to za každý den prodlení.
  10. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč v případě pozdního nástupu prodávajícího na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, a to za každý den prodlení.
  11. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za ztrátu, která kupujícímu vznikla neodstraněním reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách sjednaných ve čl. V., a to za každý i jen započatý den prodlení.
  12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

## **V. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží, škodu**

1. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost zboží a je zavázán dodat nové, nepoužité zboží bez vad ve sjednané kvalitě, vždy s předepsanými dokumenty a doklady kvality.
2. Záruka na vady a jakost dodaného zboží /doba, po kterou prodávající odpovídá za vady zboží/ se sjednává na dobu 24 měsíců. Začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a končí uplynutím záruční doby, dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po tuto dobu plně funkční a bude mít vlastnosti dle technických norem, příp. dalších předpisů, které má zboží splňovat a které se na dané zboží vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím.

3. Kupující je oprávněn vady zboží oznámit prodávajícímu také při jejich zjištění po převzetí zboží po celou dobu záruky. V případě reklamace pro zjištění vad nebo nesplnění sjednaných požadavků na vlastnosti zboží, provede prodávající neprodleně činnosti k odstranění zjištěné vady, namísto vadného plnění bude dodáno zboží bez vad nebo provedena jeho oprava, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující má právo požadovat odstranění vad a nedostatků jakosti zboží.
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy a dobu, po kterou nemohl zboží užívat pro jeho vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Prodávající se zavazuje po dobu záruky přístroje zajišťovat bezplatně pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTk) dle zákona č. 268/2014 Sb. Kupující je oprávněn/povinen vyzvat prodávajícího písemnou výzvou k provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly. Prodávající má povinnost na tyto prohlídky nastoupit do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Kupující bude vady v době záruky oznamovat prodávajícímu na:  
Tel. č.: XXXXXXXXXX  
Faxové číslo: xxx  
E-mail: servis@amimedical.cz  
Adresu: Tř. Generála Píky 1999/5, 613 00 Brno, servisní středisko: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
7. Ze záruční odpovědnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným použitím a provozováním zboží, nerespektováním doporučených pracovních podmínek, jeho poškození živelnou událostí/vyšší mocí.
8. Jestliže se v záruční lhůtě opakovaně vyskytnou vady omezující nebo vylučující užívání zboží k určenému /stanovenému/ účelu nebo zboží nelze řádně užívat dle dokumentace /včetně nenaplnování deklarovaných výkonů a vlastností/, je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu odstoupit o smlouvy.
9. Kupující vady reklamuje u prodávajícího písemně, ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Prodávající je zavázán vždy uplatněnou reklamaci vad zboží projednat písemně, ve lhůtě 30-ti dnů od jejího doručení, popřípadě jej v této lhůtě informovat a požádat o prodloužení této lhůty.
10. Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vad ihned po uplatnění reklamace, nejpozději do 48 hodin, a vady odstranit ve lhůtě 3 pracovních dnů od zahájení opravy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. V případě opravy trvající déle než **4 dny** zapůjčí prodávající náhradní zařízení.
11. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

## VI. Platnost a účinnost smlouvy

1. Platným návrhem je předložení písemného vyhotovení podepsaného prodávajícím v příslušném počtu vyhotovení. Smlouva je platnou po uzavření potvrzeném jejím podpisem kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření kupující.

2. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve třech číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží po dvou vyhotoveních a prodávající obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smlouvu mohou smluvní strany vypovědět i bez udání důvodů, nejpozději do doby, kdy prodávající oznámí dodání zboží. Výpověď smlouvy musí mít vždy písemnou formu.
4. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, sjednaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, které budou vzestupně nepřerušovanou řadou číslovány a výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy.
5. Odstoupit od smlouvy je možno jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem, z důvodu sjednaného smlouvou nebo pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou.

## VII. Další ujednání

1. Smlouva je uzavřena pro uskutečnění nákupu zboží označeného jako předmět koupě. Kupující rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, postupem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že jakékoliv ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení dle této smlouvy a strany se zavazují v mezích svých možností nahradit takovéto ujednání novým, platným a vymahatelným, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního ujednání.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dle své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem prodávajícího a kupujícího prohlašují, že jsou k tomuto úkonu oprávněny. Na potvrzení souhlasu s formulací této smlouvy připojují smluvní strany podpisy oprávněných osob (statutárních orgánů). Potvrzují, že se řádně seznámily se způsobem vymezení jejich závazků, její obsah je jim srozumitelný.

## Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 Specifikace předmětu koupě, ceny a všech součástí vč. příslušenství

**Za prodávajícího**

V Praze dne 22.04.2020

**Za kupujícího**

V Ostravě dne 24.04.2020

A.M.I. – Analytical Medical Instruments,

Městská nemocnice Ostrava,

## Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě

### Specifikace předmětu koupě, ceny a všech součástí vč. příslušenství

#### Cenová nabídka - přístroje

Pořad.č.	Obj. číslo	ks	Popis produktu	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
1.	302010003	1 ks	Přístroj - High flow jednotka	60 700,00 Kč	73 447,00 Kč
2.	402300020	1 ks	Stojan	6 578,00 Kč	7 959,38 Kč

Nabídka - evidenční číslo MT12-03/2020



A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o.

#### Cenová nabídka - spotřební materiál

Pořad.č.	Obj. číslo	Minim. Mn.	Popis produktu	Počet kusů v balení	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně 21% DPH
1.	032-10-160	5	High Flow Nasal kanyla vel. S	10	575,21 Kč	696,00 Kč
2.	031-10-161	5	High Flow Nasal kanyla vel. M	10	575,21 Kč	696,00 Kč
3.	032-10-162	5	High Flow Nasal kanyla vel. L	10	575,21 Kč	696,00 Kč
4.	032-10-165	5	High flow tracheostomická kanyla	10	637,19 Kč	771,00 Kč
5.	303040001	5	Pacientský okruh	10	1 981,82 Kč	2 398,00 Kč

Nabídka spotřebního materiálu- evidenční číslo MT327-03/2020

A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o.

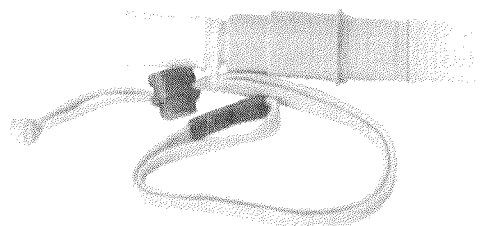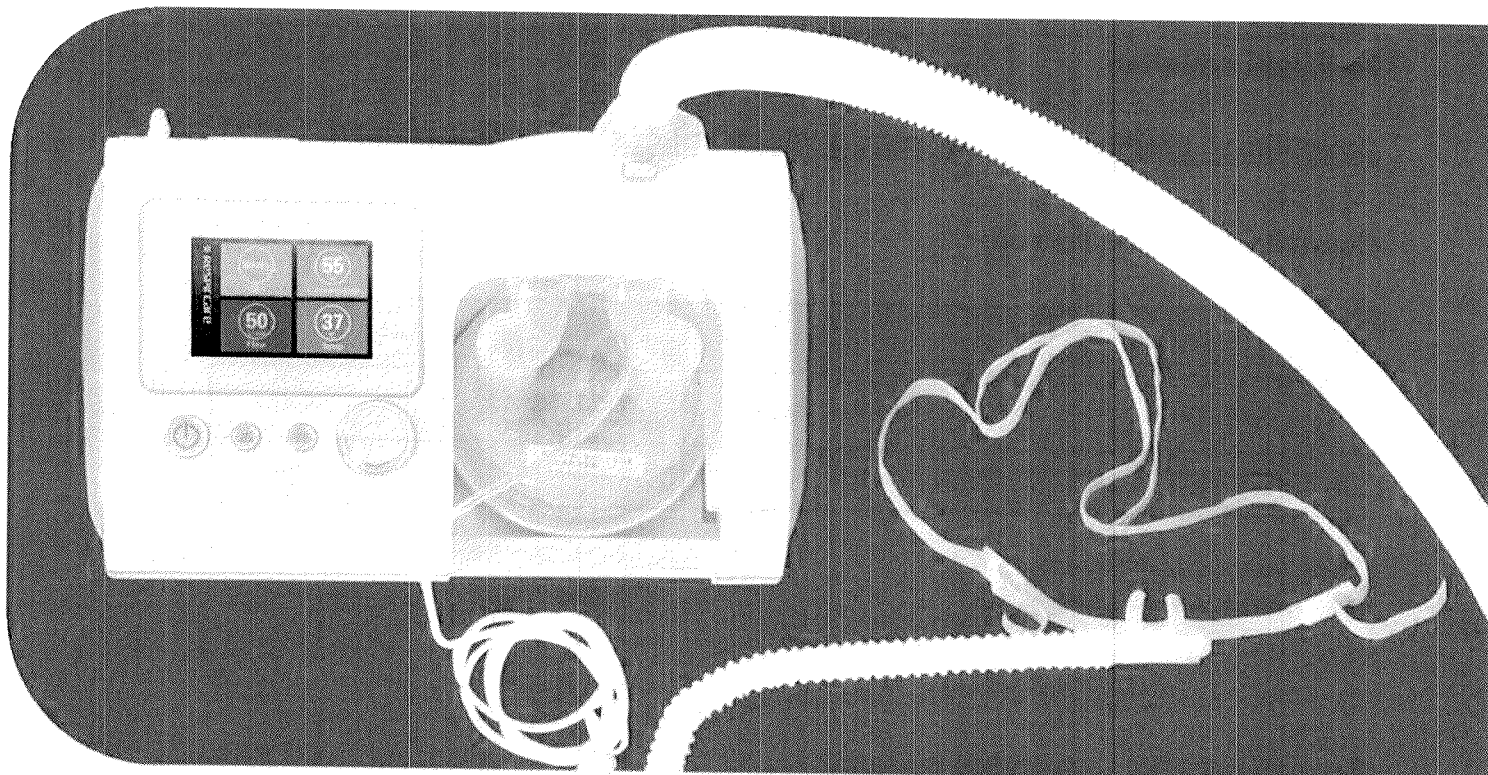


# HiFent™

## VYSOKOPRŮTOKOVÝ VYHŘÍVANÝ RESPIRAČNÍ ZVLHČOVAČ

Zvlhčovač HiFent™ je navržen tak, aby přinášel veškeré výhody zvlhčování a průtoku jak pro pediatrické, tak i pro dospělé pacienty v nemocnicích, v domácí péči nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. Lze jej použít jako součást respirační péče na JIP, jednotkách urgentního příjmu, neurologických odděleních i dětských odděleních (hmotnost > 3 kg), jednotkách rehabilitace apod.

Respicare spolu s integrovaným vysokoprůtokovým generátorem a systémem pro obohacování kyslíku umožňuje zařízení HiFent snadno zajišťovat průtok směsi vzduch/kyslík spontánně dýchajícím pacientům pomocí unikátní volitelné nazální kanyly.

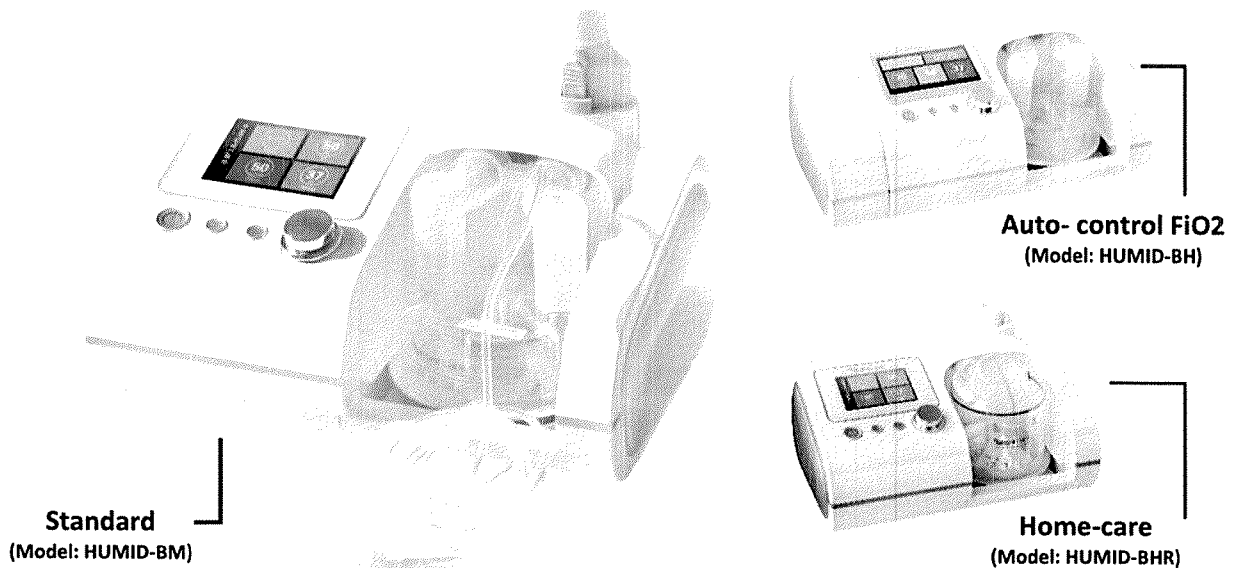

► **HiFent Flow:**

Stabilní průtok lze přesně nastavit podle individuálních požadavků daného pacienta.

**Průtok:**

Nízkoprůtokový režim: 2–25 l/min (pediatrický režim)


Vysokoprůtokový režim: 10–80 l/min (dospělý režim)

► **HiFent Oxygen:**

Obohacení O<sub>2</sub> lze provést pomocí titrace / autonastavením podle stavu O<sub>2</sub> u pacienta. Zásobování z jakéhokoliv externího zdroje O<sub>2</sub> až do 80 l/min

► **HiFent Monitoring:**




Obrazovka ukazuje informace o aktuálním průtoku  
Teplota  
Oxygenoterapie FiO<sub>2</sub>  
Pracovní režimy

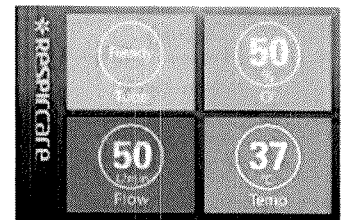

► **HiFent Humidification:**

Úroveň zvlhčení a teplotu podávaného vzduchu si může nastavit sám pacient, aby byly co nejpříjemnější.  
Rosný bod: 31 °C, 34 °C, 37 °C

► **Vysokoprůtokový vyhříváný respirační zvlhčovač**


Model	 HUMID-BM	 HUMID-BH	 HUMID-BHR
Zdroj napájení	220 V AC + 22 V, 50 + 1 Hz		
Rozmezí nastavení průtoku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nízkoprůtokový režim: 2–25 l/min teplota: 34 X</li> <li>Vysokoprůtokový režim: 10–80 l/min</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysokoprůtokový režim: 10–60 l/min</li> </ul>
Nastavení teploty	31 °C, 34 °C, 37 °C		
Podíl kyslíku %	21 % – 100 %		21 % – 50 %
Nastavení FiO <sub>2</sub>	Manuální titrační nastavení	Automaticky ovládaný proporcionální ventil	Manuální titrační nastavení
Parametry alarmů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm Nízká koncentrace kyslíku</li> <li>Alarm Vysoká koncentrace kyslíku</li> <li>Alarm Teplota okolí</li> <li>Alarm Dušení</li> <li>Obnova alarmu</li> </ul>		
Doporučená teplota okolí	18–28 °C		
Standardy	IEC/EN 6060-1, IEC/EN 60601-1-2; ISO 8185		
Balení	D 330 × Š 245 × V 315 mm	D 390 × Š 245 × V 315 mm	D 330 × Š 245 × V 315 mm
Použití	NEMOCNICE	NEMOCNICE	DOMÁCÍ PÉČE

► **U jakých pacientů lze HiFent použít?**

Tento produkt je vhodný pro spontánně dýchající pacienty při provádění léčby podáváním ohřátého a zvlhčeného plynu se stanoveným průtokem. Patří sem zvlhčovací terapie, kyslíková terapie, endotracheální intubace a tracheostomie. Tento produkt nelze používat pro podporu životních funkcí.

# \* Spotřební materiál


## ► Rozhraní (kanyly a adaptéry)

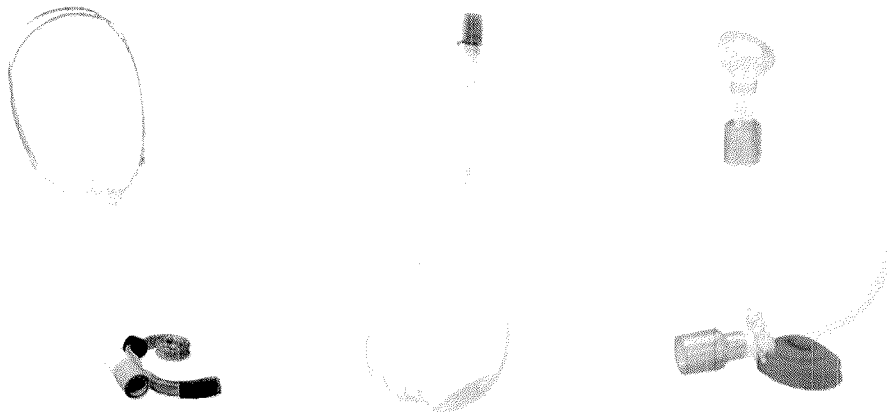


• Nazální kanyla pro dospělé pacienty • Nazální kanyla pro pediatrické pacienty • Tracheostomický adaptér

Model	Nazální kanyla pro dospělé pacienty			Nazální kanyla pro pediatrické pacienty		Tracheostomický adaptér
	#S	#M	#L	Novorozenec	Dítě	
Rozměry						Pro dospělé (průtok: 10–60 l/min)
Velikost kanyly	3 × 1,5 mm (vnější průměr)	6 × 4,8 mm (vnější průměr)	5,4 mm (vnější průměr)	2,9 mm (vnější průměr)	3,2 mm (vnější průměr)	
Rozmezí průtoku	50 l/min	70 l/min	80 l/min	20 l/min max.	25 l/min max.	
Balení	10 ks / krabice: 230 × 130 × 160 mm 70 ks / krabice: 530 × 230 × 290 mm			Materiál náplastí: Hydrokoloid		


### ► Vodní nádoba pro nemocnici

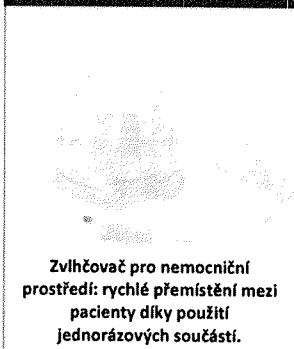



### ► Vodní nádoba pro domácí péči

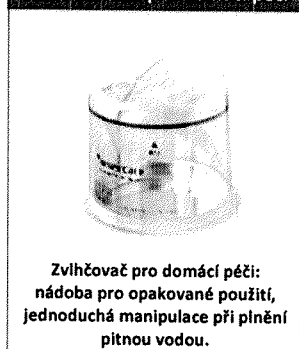

### ► Nazální kanyla

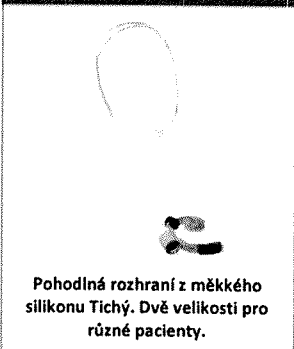

### ► Ohřívací hadička

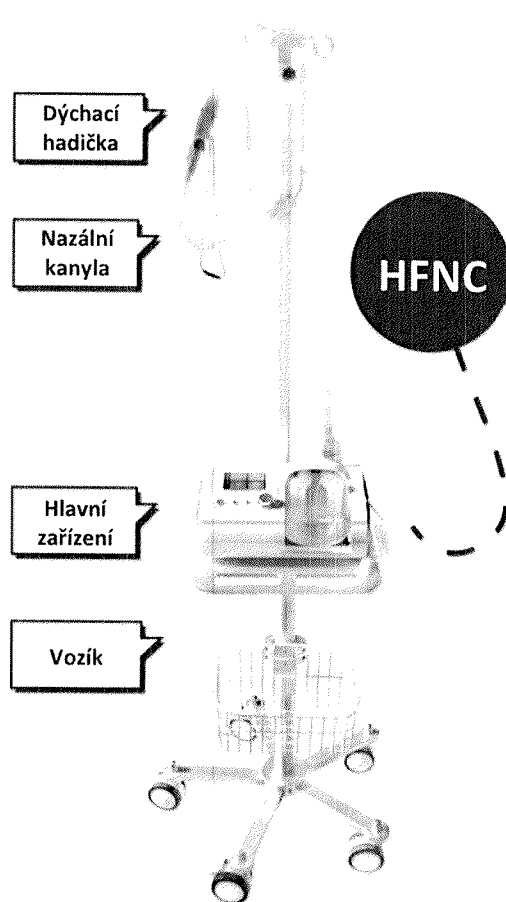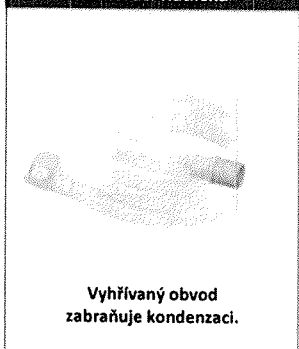

## Hifent™

Tak teplý a příjemný jako tropický oceán, tak voňavý a bohatý na kyslík jako tropický deštný prales – to je unikátní systém Hifent, který dodá kyslík každému vašemu dechu!

### \*Profil společnosti

Společnost RMS MEDICALTECH CO., LTD byla založena v roce 2010 a od té doby se stala přední společností ve výzkumu a vývoji produktů v oblasti neinvazivní ventilaci a vysokoprútokových, respiračních a vyhřívaných zvlhčovačů. Společnost zaměstnává 95 osob na plný úvazek ve výzkumu a ve vývoji, přičemž 20 zaměstnanců představují zkušení inženýři. Klinický výzkum produktů probíhá v lékařské fakultní nemocnici respirační medicíny pekingské univerzity. Jsme držitelé certifikátů CE a EN ISO 13485-2012 schválených TUV společností.

Pracoviště a kanceláře: V současné době máme pracoviště o ploše 2 400 m<sup>2</sup> a kanceláře o ploše 1 200 m<sup>2</sup>.

Shenyang RMS Medical Tech Co.,Ltd.

Adresa: No.21 Gaoke Road, Hunnan New District, Shenyang.

Tel.: 86-24-31682686

► [www.rms-care.com/en](http://www.rms-care.com/en)

CE<sub>0197</sub>  
EN ISO13485

**Ceník servisních zásahu**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena vč. DPH (21 %)</b>
Pravidelná servisní prohlídka BTK (1x ročně)	3 100,00 Kč	3 751,00 Kč
Cestovní náklady	4 075,00 Kč	4 930,75 Kč
Hodinová sazba servisního technika	1 050,00 Kč	1 270,50 Kč

**Za prodávajícího**

**Za kupujícího**

V Praze dne 22.04.2020

V Ostravě dne 24-04-2020

A.M.I. – Analytical Medical Instruments.

Městská nemocnice Ostrava,

