

KUPNÍ SMLOUVA č. 1/20

uzavřená, níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Prodávající: KK - EDEX spol. s r.o.

Artura Krause 2370, 530 02 Pardubice

IČ: 15051234

DIČ: CZ15051234

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: 161418686/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 9060

Zastoupený: Janou Křepelkovou Bartoňovou, jednatelem společnosti

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

IČ: 00196096

DIČ: CZ00196096

Bankovní spojení: KB Žamberk

Číslo účtu: 18938-611/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl Pr, vložka 712.

Zastoupený: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitelem

(dále jen „kupující“)

uzavírají v souladu s platnými legislativními předpisy tuto kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka **6 ks nemocničních zdravotnických lůžek a 19 ks zdravotnických lůžek pro nemocniční zařízení dlouhodobé péče včetně matrací** dle specifikace zadané výzvou pro podání nabídek, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), v souladu s cenovou nabídkou a specifikací dodávky prodávajícího ze dne 10. 06. 2020 (příloha č. 2), tj. odevzdat zboží a umožnit nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Součástí předmětu smlouvy je doprava na místo určení, instalace, zaškolení obsluhy kupujícího a předání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, protokol o zaškolení obsluhy, návod na používání 1 x v tištěné a 1 x v elektronické verzi).

II. Dodací lhůta

1. Prodávající dodá předmět smlouvy **do 04. 09. 2020** po podpisu této smlouvy (dodací lhůta“). Prodávající bude informovat oprávněného zástupce kupujícího o přesném termínu plnění min. 5 pracovních dní předem.
2. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle čl. I. této smlouvy bude splněn podpisem předávajícího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran po provedení instalace zboží, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů ke zboží se vztahujícím.

III. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu smlouvy je ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena byla sjednána, dle cenové nabídky (specifikace) ve výši:
 - cena celkem bez DPH 942 475,00 Kč bez DPH,
 - výše DPH 21% 141 371,00 Kč
 - cena celkem včetně DPH 1 083 846,00 Kč včetně DPH*(jeden milion osmdesát tři tisíce osm set čtyřicet šest korun)* (dále jen „kupní cena,,“).
2. V kupní ceně je zahrnuto clo, dopravní náklady, balné, instalace a zaškolení obsluhy.

V. Platební podmínky

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový a účetní doklad (dále jen „faktura“), budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V případě nové nebo opravené faktury běží nová, lhůta splatnosti dle čl. VI. této smlouvy.

VI. Způsob úhrady

1. Převodem na účet ČSOB Pardubice (číslo účtu 161418686/0300), se splatností 30 dní ode dne podpisu předávacího protokolu a vystavení faktury prodávajícím.

VII. Sankce

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží dle čl. I. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,025% z kupní ceny za každý den prodlení.

VIII. Záruka, pozáruční servis

1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží.
2. Záruka je 36 měsíců, ode dne podpisu předávacího protokolu za předpokladu, že zboží bude používáno dle návodu k obsluze.
3. Záruka se nevztahuje na poškození zboží živelnou pohromou, násilím nebo neodborným zacházením.
4. Záruční a pozáruční servis zajišťuje fa PROMA REHA, s r.o., do 5 - ti pracovních dnů od nahlášení závady. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
Součástí záručního servisu je preventivní kontrola v rozsahu BTK v souladu s § 65, zákona č. 268/2014 Sb, o zdravotnických prostředcích.
5. Prodávající se zavazuje v případě zájmu kupujícího po dobu 10 let od předání zboží zajistit servis a dodávat kupujícímu náhradní díly ke zboží.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny. Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění anebo opožděné splnění závazků, vyplývajících ze smlouvy z důvodu vyšší moci. Vyšší moc je událost mimo kontrolu smluvní strany, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu anebo zanedbání smluvní strany. Nastane-li situace vyšší moci tak uvědomí smluvní strana, na jejíž straně se vyšší moc

vyskytla, neprodleně písemně druhou smluvní stranu a to o její existenci a příčině. Smluvní strana nadále pokračuje v plnění smluvních závazků, pokud je to rozumně možné a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro splnění smluvních závazků, kterým nebrání událost vyšší moci.

2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž obdrží jeden výtisk prodávající a dva výtisky kupující. Tato smlouva vstupuje v platnost po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly, že Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, jako povinný subjekt, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemné dohodě podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích, dne 13. července 2020

V Žamberku, dne 17. července 2020

.....
Jana Křepelková Bartoňová
jednatel
za prodávajícího

.....
Ing. Rudolf Bulíček
ředitel
za kupujícího

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

a) **Nemocniční (zdravotnické) lůžko – 6 ks**

- lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010
- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
- minimálně 3 dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru
- velikost ložné plochy 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm
- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 40-80cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 220 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po cca $\frac{3}{4}$ délky ložné plochy s ochranou proti nechtěnému spuštění ovladatelné jednou rukou obsluhy s možností oboustranného doplnění postranní zábranou zbylé $\frac{1}{4}$ délky. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačít do jeho steh.
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části
- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
- díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku
- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka
- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka pryžová
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace 6 ks s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové
 - a) III. - 3 ks
 - b) IV. - 3 ks
 - hustota jádra min. 40 kg/m³,
 - výška min. 14 cm
 - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
 - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
 - svařované švy,
 - možnost praní při 60-90°C,
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků

b) **Zdravotnické lůžko pro nemocniční zařízení dlouhodobé péče – 19 ks**

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
- minimálně 3 dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části
- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru
- velikost ložné plochy 90x200 cm

- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 40-80cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 220 kg
- postranice zajišťující pacienta proti pádu po celé délce ložné plochy s ochranou proti nechtěnému spuštění ovladatelné jednou rukou obsluhy. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačít do jeho stehna
- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části
- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou
- díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou dezinfikovatelností,
- plastový kryt podvozku
- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka
- ruční ovladač polohování s blokadí polohovacích funkcí, s případným zamezením nebo bez přechodu stavu ovladače do pohotovostního režimu (tj. kdykoliv přímý přístup k funkcím lůžka bez nutnosti zapnutí či spuštění ovladače samostatným tlačítkem)
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka pryžová
- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu. Čelo lůžka musí v horní části lůžka uprostřed umožnit doplnění přitahovacího popruhu pro pacienta

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace 19 ks s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové
 - a) III. - 11 ks
 - b) IV. - 8 ks
 - hustota jádra min. 40 kg/m³,
 - výška min. 14 cm
 - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,
 - svařované švy,
 - možnost praní při 60-90°C,
 - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,
- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,
- držák močové láhve
- držák infuzních roztoků

Cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA: **Lůžko PLE-N90-0, Lůžko PLE-E90-0:**

Počet ks	Název	Cena / ks po slevě	Celkem bez DPH	DPH %	DPH Kč	CENA vč. DPH
6	a) Lůžko PLE-N90-0	31 659,00 Kč	189 954,00 Kč	15	28 493,00 Kč	218 447,00 Kč
6	Hrazda	600,00 Kč	3 600,00 Kč	15	540,00 Kč	4 140,00 Kč
6	Hrazdička	86,00 Kč	516,00 Kč	15	77,00 Kč	593,00 Kč
6	Držák močové láhve	213,00 Kč	1 278,00 Kč	15	192,00 Kč	1 470,00 Kč
6	Infuzní stojan hliníkový	474,00 Kč	2 844,00 Kč	15	427,00 Kč	3 271,00 Kč
3	Matrace COMFORT 5Z 2S 200x90x14cm	3 396,00 Kč	10 188,00 Kč	15	1 528,00 Kč	11 716,00 Kč
3	Matrace SoftComplex 200x90x14cm	3 901,00 Kč	11 703,00 Kč	15	1 755,00 Kč	13 458,00 Kč
19	b) Lůžko PLE-E90-0	33 039,00 Kč	627 741,00 Kč	15	94 161,00 Kč	721 902,00 Kč
19	Hrazda	600,00 Kč	11 400,00 Kč	15	1 710,00 Kč	13 110,00 Kč
19	Hrazdička	86,00 Kč	1 634,00 Kč	15	245,00 Kč	1 879,00 Kč
19	Držák močové láhve	213,00 Kč	4 047,00 Kč	15	607,00 Kč	4 654,00 Kč
19	Infuzní stojan hliníkový	474,00 Kč	9 006,00 Kč	15	1 351,00 Kč	10 357,00 Kč
11	Matrace COMFORT 5Z 2S 200x90x14cm	3 396,00 Kč	37 356,00 Kč	15	5 603,00 Kč	42 959,00 Kč
8	Matrace SoftComplex 200x90x14cm	3 901,00 Kč	31 208,00 Kč	15	4 681,00 Kč	35 889,00 Kč
CELKEM			942 475,00 Kč	15	141 371,00 Kč	1 083 846,00 Kč

Záruka 3 roky.

Specifikace zdravotnického lůžka PLE-N90-0:

Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

Kolečka 150 mm – plastová, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Plastový kryt podvozku

Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Ruční (patientský) ovladač s možností uzamčení poloh

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Snadno čistitelná celoplastová čela H1 s madly pro manipulaci

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice ¾ sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem zajištění zábran

– s ochranou proti nechtěnému spuštění s možností doplnění o dobočnice

Možnost odejmutí zábran bez použití nářadí

Barevné provedení kovové konstrukce lůžka - RAL 9016

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha: 200 x 90 cm

Vnější rozměry: 215 x 102cm

Zdvih ložné plochy: 38,5 – 80 cm

Nosnost: 220 kg


Příslušenství:

Hrazda

Hrazdička

Infuzní stojan

Držák močové láhve

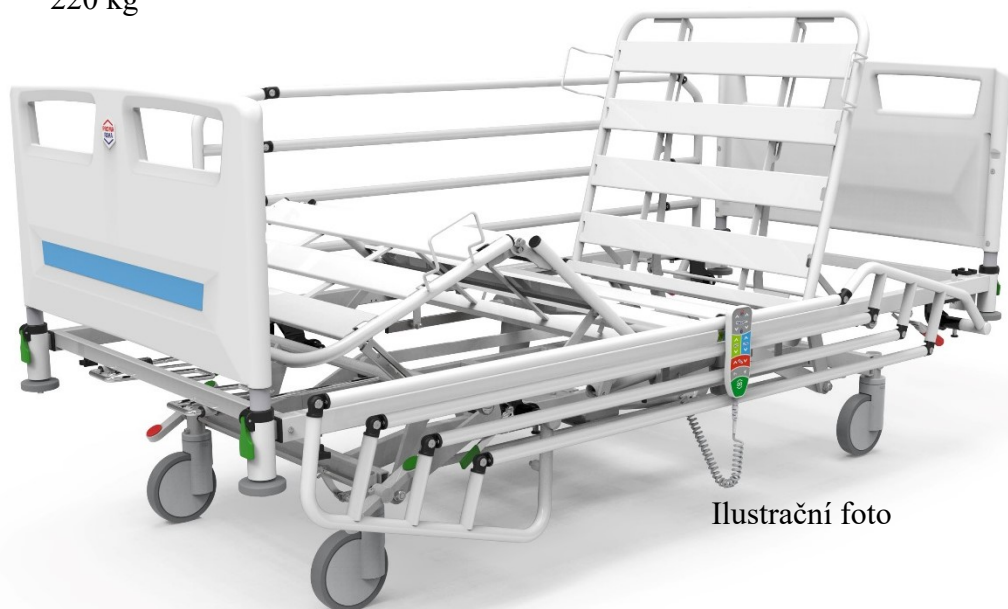

Ilustrační foto

Specifikace zdravotnického lůžka PLE-E90-0:

Lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

Kolečka 150 mm – plastová, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Plastový kryt podvozku

Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, 25°

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Ruční (patientský) ovladač s možností uzamčení poloh

4x univerzální držák příslušenství – hlavová a nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných kovových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Snadno čistitelná kovová čela s výplní HPL

Nožní i hlavové čelo odnímatelné

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Průběžné integrované hliníkové postranice po celé délce ložné plochy s výplní z HPL s možností uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem

Pohyb zábran ve vertikálních lištách v krajních sloupcích lůžka

Barevné provedení kovové konstrukce lůžka - RAL 9016


Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha: 200 x 90 cm

Vnější rozměry: 215 x 105cm

Zdvih ložné plochy: 38,5 – 80 cm

Nosnost: 220 kg

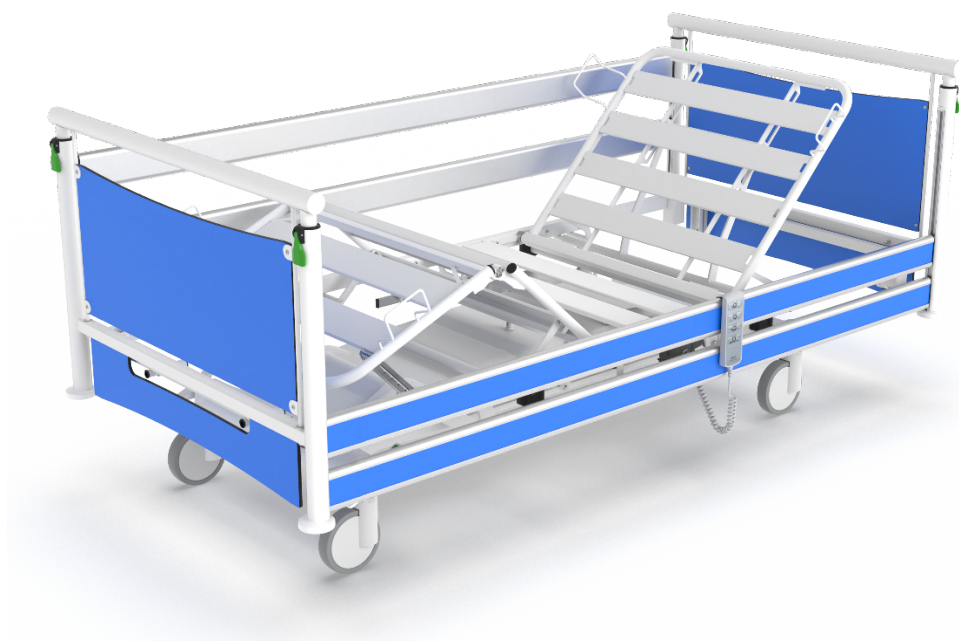

Příslušenství:

Hrazda

Hrazdička

Infuzní stojan

Držák močové láhve

Specifikace matrace COMFORT 5Z-2S 200 x 90 x 14 cm

Určené: pro II.- III.stupeň rizika vzniku proleženin hodnotícího systému dle Nortonové
Studená pur pěna hustota: 43 kg/m³, nosnost: 150 kg, výška matrace: 14 cm

Comfort 5Z-2S je jednostranná pětizonová matrace vyrobená z pěny o objemu hmotnosti 43 kg/m³. Jedna strana je tvořena vrstvou s tlakovými body, které příznivě napomáhají lepšímu rozložení tlaku, flex-efekt, druhá strana je hladká. Vnitřek matrace je tvořen příčnými kanálky pro provzdušnění. Konstrukce pěny se silnou buněčnou stěnou a výraznou pórovitostí umožňuje velmi vysokou prodyšnost a zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu.




Matrace je ve snímatelném inkontinenčním, hygienickém, protialergickém, antibakteriálním potahu **Humiditex H101**, nepropouštějícím vodu, ale zaručujícím molekulární prostupnost vodních par, který i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Tento speciální elastický potah má roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie. Povrch potahu H101 není savý ani pórovitý, proto se veškeré nečistoty a bakterie drží na jeho povrchu a snadno se odstraňují při používání minimálního množství běžných čisticích a dezinfekčních prostředků.

Díky těmto vlastnostem potah nevyžaduje horkovzdušné čištění. Potah Humiditex se pere při 40-90°C, doporučená teplota 60°C (až 1000 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat horkým suchým vzduchem, avšak snižuje se počet pracích cyklů. Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své tloušťce a přizpůsobivosti nesnižuje účinek antidekubitních matrací. Potah je se zipem ze 3 stran, s okapničkou, svařované švy.

Návod na čištění:

Na čištění matrací a na čištění potahů se používá 3-5% roztok všech přírodních ekologických mýdel a ekologicky šetrných saponátů, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Na čištění se **NEDOPORUČUJE** používat přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch potahu by neměl přijít do stálého kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení matrace o 180°.

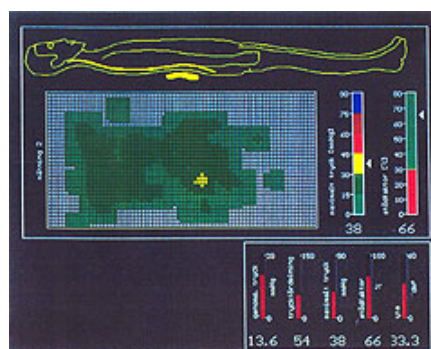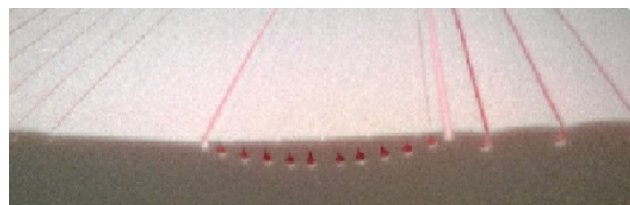

Specifikace matrace Matrace – SoftComflex 200x90x14cm

Určené: pro IV. stupeň rizika dle Nortonové

Hustota pěny: 2 cm superměkká studená pěna 23 kg/m³, 4 cm viskoelastická flexibilní pěna uvolňující tlakovou zátěž 55 kg/m³, 8 cm pěna 53 kg/m³

Nosnost matrace: do 180 kg

Matrace SoftComflex funguje především eliminováním potenciálních tlakových bodů a vytvořením vnějšího tlaku, který je nižší než protitlak kapilárního systému, což umožňuje lepší funkci krevního oběhu. Toto zajišťuje speciální viskózní plastická pěna Flex, která se přizpůsobí tělesné teplotě a měknutím zajišťuje maximální rozložení tlaku na větší plochu. Hmoty Flex udrží až 95% tělesné teploty, což zabraňuje podchlazování tlakových bodů.

Matrace SoftComflex je třívrstvá matrace s 2 cm silnou Soft vrstvou za studena formované pěny, 4 cm vrstvou viskózní pružné pěny rozkládající tlak a 8 cm silnou základní vrstvou za studena formované pěny. Tato kombinace poskytuje měkký povrch s účinným rozložením tlaku a dobrým základním vypořádáváním.

SoftComflex je vhodná pro prevenci a léčbu proleženin IV. stupně.

Matrace je ve snímatelném inkontinenčním, hygienickém, protialergickém, antibakteriálním potahu

Humiditex H101, nepropustějším vodu, ale zaručujícím molekulární prostupnost vodních par, který i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Tento speciální elastický potah má roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie. Povrch potahu H101 není savý ani pórovitý, proto se veškeré nečistoty a bakterie drží na jeho povrchu a snadno se odstraňují při používání minimálního množství běžných čistících a dezinfekčních prostředků.

Díky těmto vlastnostem potah nevyžaduje horkovzdušné čištění. Potah Humiditex se pere při 40-90°C, doporučená teplota 60°C (až 1000 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat horkým suchým vzduchem, avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Je velmi odolný proti ořezu, snese vysoké zatížení, díky své tloušťce a přizpůsobivosti nesnižuje účinek antidekubitních matrací. Potah je se zipem ze 3 stran, s okapničkou, svařované švy.

Návod na čištění:

Na čištění matrací a na čištění potahů se používá 3-5% roztok všech přírodních ekologických mýdel a ekologicky šetrných saponátů, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Na čištění se v žádném případě **NEDOPORUČUJE POUŽÍVAT** přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch potahu **NESMÍ** dlouhodobě přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace se životnost antidekubitní matrace prodlužuje, k dodržení doby životnosti napomáhá pravidelné otáčení matrace o 180°.



ilustrační foto

