

Technická specifikace poptávaného zařízení


Fyzioterapeutický závěsný systém (2 ks)	
<p>Účel použití: Závěsný systém pro cvičení v odlehčení v různých stádiích onemocnění pohybového aparátu. Systém použitelný u pacientů po úrazech, operacích a onemocněních neurologických, onemocněních pohybového aparátu, včetně široké skupiny vertebropatií</p> <p>Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína</p>	
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota
zajištění bezpečnosti obsluhy i pacienta – min. konstrukční řešení a vybavení garantující stabilitu a bezpečnost pacientů s pohybovým hendikepem nebo pacientů imobilizovaných, mnohočetně nemocných a rizikových	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
cvičení v různých pozicích, s možností zatížení plnou vahou těla	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
individuální dávkování zátěže pro pacienta	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
cvičení proti odporu, ale též jako dopomoc, tedy nadlehčení pacienta	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
přesné zacílení terapie na potřebné svaly	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
využití vibrace	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
rotační pohyby s přesně dávkovanou obtížností, zátěží i místem aplikace	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
rotační cvičení lze provádět ve stoje, v kleku, vleže na zádech, boku i na bříše a v sedě	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
systém se musí skládat z výškově nastavitelných popruhů a lan o různých délkách, pružnosti a nosnosti tak, aby umožňoval terapii a plnil požadovaný účel použití	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
lana musí být viditelně označena tak, aby byla rozpoznatelná jejich pružnost a nosnost, aby byla snadno nastavitelná pro požadovanou terapii	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
Konstrukční požadavky	

komplexní zařízení pro fyzioterapii – soustava závěsného zařízení, s plynulým posuvem závěsných bodů ovladatelných jednou rukou v průběhu terapie a speciálních kladek, lan a závěsných popruhů, s možností kombinací, umožňující zavěšení / odlehčení celého těla.	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
stropní konstrukce – ideálně složená z nosného rámu a posuvného nosníku	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
Příslušenství a doplňky	
veškeré komponenty pro uvedení do funkčního provozu (včetně kabeláže, všech propojení, čidel, senzorů, ovládacích prvků pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
v rozsahu požadovaných klinických aplikací, pro požadované použití dle medicínského účelu – dle požadované verze systému (pro daný účel a použití)	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
<p>příslušenství k zavěšení (minimálně):</p> <ul style="list-style-type: none"> - akrální popruhy (pár) s úchyty - pánevní popruh s protiskluzovou úpravou z jedné strany - terapeutický popruh - krční (dělený) popruh pro umístění hlavy v případě terapie krku - balanční podložka 2 ks - uvolňovač lan pro odblokování záseků lan v aparátu zavěšení klienta - lano pevné min. 60 cm 2ks - lano elastické min. 60 cm (2 druhy) – každý druh po 2 ks - lano pevné min. 30 cm 2 ks - lano elastické (2 druhy elasticity) – každý druh po 2 ks 	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
úchyty pro upevnění do stropu (stropní konstrukce)	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
Další požadavky uživatele	

vzdělávací kurz pro fyzioterapeuty v rozsahu min. 21 hod. – fyzioterapie s posuvným závěsným zařízením, cvičení v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích včetně rotačních cviků	splňuje, viz. Plán kurzů 2021 (Neurac 1 – 21 hodin výuky)
samostatné zavěšení do stropu pomocí vrtaných otvorů a kotevních hmoždinek pro umístění aparátu s jedním závěsným bodem, umožňujícím plynulé řízení délky lana a který je součástí systému posuvné konstrukce	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
snadná a účinná hygiena (použité materiály snadno udržovatelné a omyvatelné); dobrá přístupnost k jednotlivým částem	splňuje, viz. Technická specifikace Redcord Workstation Professional
zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE	splňuje, viz. EC-Declaration-WS-Prof-Ceiling-100023-5-1

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů **uvedením hodnoty** parametru, u ostatních slovem **splňuje, zároveň uvede odkaz** na příložený nebo výrobcem schválený veřejně **přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola**)

- * *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

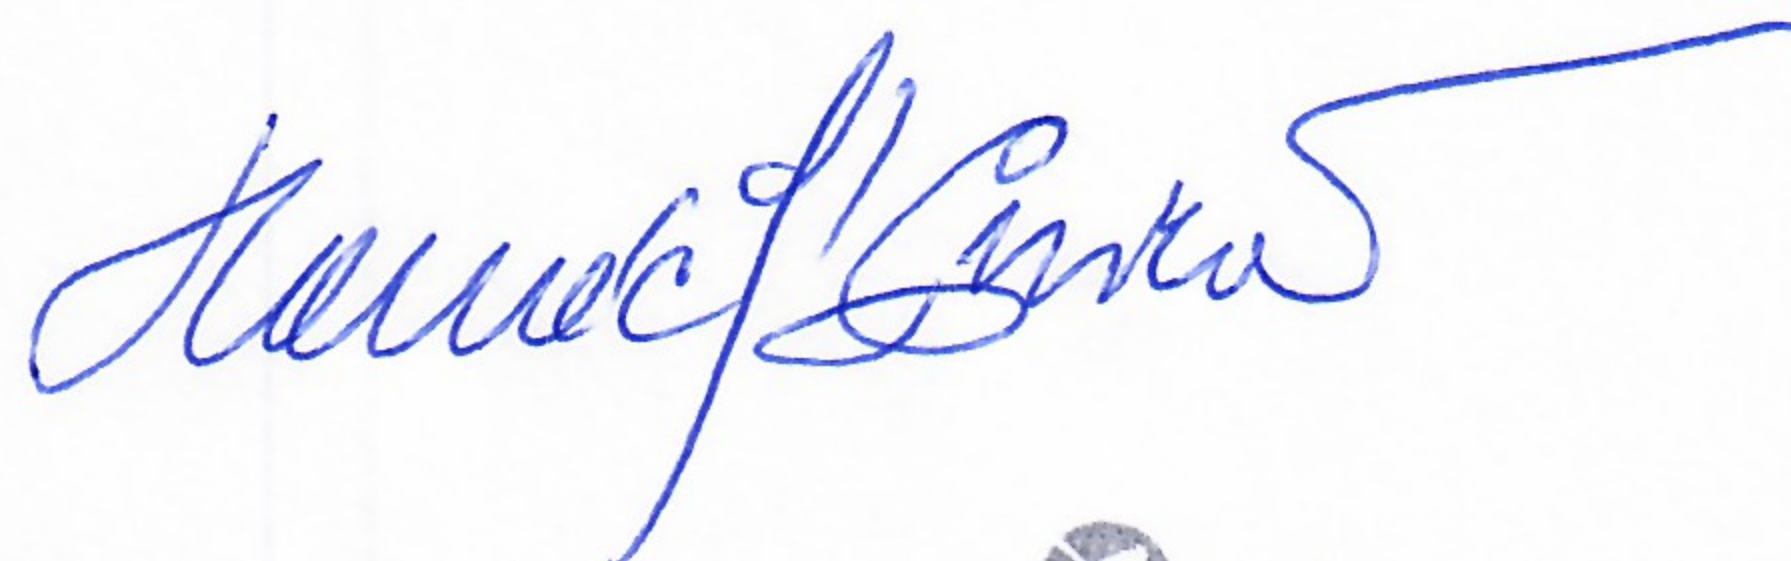

 redcord®
 Ahama s.r.o., Nám. 5. května 888/9
 500 02 Hradec Králové
 IČ: 274 91 579 DIČ: CZ27491579
 Tel: 603 586 513