

Smlouva o výpůjčce zdravotnického přístroje

uzavřena dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. LABOSERV s.r.o.

zapsaná: v OR u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 28716
sídlo: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
zastoupená: MVDr. Miroslav Šišák, jednatel společnosti
IČ: 25507150
DIČ: CZ25507150
bankovní spojení: ██████████
datová schránka: 4mshi4x
(dále jen „**půjčitel**“)

a

2. Nemocnice Litoměřice, a.s.

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2641
sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice - Předměstí
IČO: 06199518
DIČ: CZ006199518
zastoupená: Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou představenstva
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
datová schránka: tgxkp5y
(dále jen „**vypůjčitel**“)

(půjčitel a vypůjčitel dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

I. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele přenechat vypůjčiteli k bezplatnému užívání zdravotnický přístroj (dále rovněž jako „předmět výpůjčky“), blíže specifikovaný v článku II. této smlouvy, jehož výlučným vlastníkem je půjčitel.
- 1.2. Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že vypůjčitel bude ve svém zdravotnickém zařízení, konkrétně na pracovišti: Pracoviště klinické mikrobiologie (dále jen „pracoviště vypůjčitele“), užívat předmět výpůjčky výhradně za účelem izolací NK pomocí souprav dodávaných půjčitelem, dle přílohy č. 3.

II. Specifikace předmětu výpůjčky

- 2.1. Předmětem výpůjčky jsou zdravotnické přístroje: dva izolátory BioMagPure 12 Plus a jeden PCR real time cycler Bioquant-96 (dále též jen „přístroj“):
 - a) výrobce/značka: Biosan
 - b) typ: BioMagPure 12 Plus a Bioquant-96, jejichž technické specifikace jsou uvedeny v **příloze č. 1** této smlouvy

c) cena za kus: izolátor NK 414 575 Kč bez DPH za kus 501 635,75 Kč vč. DPH a real time PCR cycler BioQuant-96 882 000 Kč bez DPH, 1 067 220,00 vč. DPH.

- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že určení předmětu výpůjčky způsobem podle bodu 2.1. této smlouvy považují za dostatečně určité a přesné.
- 2.3. Půjčitel prohlašuje, že přístroje splňují technické, hygienické, veterinární, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropského společenství a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k předmětu plnění, zejména, že splňují podmínky dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky / č. 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky a dále, že bylo certifikační autoritou uděleno zdravotnickému přístroji označení shody (CE).
- 2.4. Půjčitel dále prohlašuje, že přístroje jsou nové a nepoužívané, a že tento představuje zdravotnický prostředkem ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Předmět výpůjčky bude užívat výhradně vypůjčitel, a to pouze k účelu stanovenému v bodě 1.2. smlouvy.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Půjčitel prohlašuje, že přístroje jsou způsobilé k řádnému užívání, nemají žádné faktické technické ani právní vady, které by bránily užívat přístroje v souladu se smluveným účelem. Vypůjčitel přijímá přístroje a zavazuje se, že přístroje bude užívat řádně, v souladu s jejich technickými podmínkami, se kterými byl při uzavření této smlouvy seznámen, a to výlučně za účelem dohodnutým v této smlouvě.
- 3.2. Předáním přístrojů vypůjčitel se rozumí doprava přístrojů, jejich umístění na pracovišti vypůjčitele dle pokynů vypůjčitele, uvedení do provozu, provedení instruktáž personálu vypůjčitele osobami autorizovanými výrobcem přístrojů pro obsluhu a běžnou údržbu přístrojů a předání návodu k použití v ČJ na užívání, provoz a běžnou údržbu přístrojů, příp. dalších dokumentů uvedených v této smlouvě.
- 3.3. Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčitelu přístroje podle této smlouvy k užívání a řádně jej vypůjčitelu předat nejpozději do 2 týdnů od podpisu této smlouvy, o předání bude vyhotoven písemný předávací protokol.
- 3.4. Odpovědnými osobami pro předání a převzetí přístroje na pracovišti vypůjčitele jsou:
za půjčitele: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]@laboserv.cz , telefon: [REDACTED]
za vypůjčitele: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]@nemocnice-lt.cz, telefon: [REDACTED]
- 3.5. Vypůjčitel se zavazuje přístroje od půjčitele řádně převzít a užívat je výlučně za účelem uvedeném v této smlouvě, příp. k účelu k němuž jsou přístroje obvykle určeny. Náklady na udržování přístrojů ve stavu způsobilém řádného užívání výše uvedeným nese po dobu zápůjčky půjčitel.
- 3.6. Vypůjčitel se zavazuje, že se bude o přístroje řádně starat a užívat je způsobem odpovídajícím zacházení dobrého hospodáře, že bude přístroje chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením, a nejpozději v den ukončení výpůjčky dle této smlouvy jej vrátit zpět půjčitelu v místě a čase dle této smlouvy, a to ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
- 3.7. Vypůjčitel je povinen seznámit se podrobně a pečlivě s odborným zacházením s přístrojem a je povinen dbát náležitého odborného zacházení a údržby přístrojů. Vypůjčitel odpovídá za škodu, která byla jeho zaviněním způsobena na přístrojích.
- 3.8. Vypůjčitel se zavazuje, že neumožní užívat přístroje třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.

- 3.9. Nebezpečí škody na přístrojích nese půjčitel, nejde-li o poškození přístrojů, jehož příčinou bylo užívání přístrojů v rozporu s touto smlouvou, což půjčitel musí vypůjčiteli prokázat.

IV. Servis

- 4.1. Půjčitel se zavazuje u vypůjčitele provádět odbornou údržbu přístrojů vč. odstraňování vad (dále jen „servis“) osobami autorizovanými výrobcem přístroje pro provádění servisu, po dobu 24 měsíců od okamžiku předání přístrojů vypůjčiteli. Bezplatný servis přístrojů je poskytován na náklady půjčitele v rozsahu dle **přílohy č. 2** této smlouvy.
- 4.2. Půjčitel se zavazuje k provedení všech záručních oprav zdarma, a to nejpozději do 72 hodin od písemného nahlášení vady přístroje na kontaktech: tel. [REDAKCE], nebo e-mail servis@laboserv.cz.
- 4.4. Půjčitel se zavazuje dle požadavku vypůjčitele odstranit případné nezáruční opravy přístrojů po dobu záruky, za cenu vypočtenou dle přílohy č. 2 smlouvy, a to v rámci hodnoty plnění současně uzavírané Rámcové dohody o dodávkách spotřebního materiálu k přístroji (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 4.5. Jsou-li přístroje neopravitelné, zavazuje se půjčitel zapůjčit vypůjčiteli na základě písemného dodatku k této smlouvě přístroj nový, a to se shodnými nebo lepšími parametry, jako přístroj zapůjčený.

V. Doba trvání a ukončení smlouvy

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejméně však na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti. Tato smlouva je smlouvou závislou na současně uzavírané Rámcové dohodě; v případě skončení účinnosti Rámcové dohody skončí bez dalšího prodloužení, ke stejnému datu, také účinnost této smlouvy.
- 5.2. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s 2 měsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení smlouvy výpovědí smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit přístroj půjčiteli ve lhůtě do pracovních 3 dnů ode dne ukončení smlouvy ve stavu obvyklého opotřebení, na pracovišti vypůjčitele a náklady půjčitele.
- 5.3. Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou ke dni, kdy bude písemné odstoupení smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je vypůjčitel následně povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, vrátit půjčiteli přístroj ve stavu obvyklého opotřebení, na pracovišti vypůjčitele a náklady půjčitele.
- 5.4. V případě ukončení této smlouvy uplynutím stanovené doby trvání nebo skončením účinnosti Rámcové dohody uvedené v bodě 5.1. smlouvy, se na vrácení přístroje přiměřeně uplatní ustanovení bodu 5.2. smlouvy.

VI. Uveřejnění smlouvy

- 6.1. V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že uveřejnění elektronického obrazu této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí vypůjčitel. Vypůjčitel uveřejní celé znění této smlouvy v registru smluv, vyjma údajů fyzických osob smluvních stran.
- 6.2. Hodnota předmětu smlouvy pro účely uveřejnění prostřednictvím registru smluv, kterou lze předběžně určit, činí 2 070 491,5 Kč vč. DPH. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že hodnota dle předchozí věty se uvádí výlučně pro účely uveřejnění v

registru smluv a nemá tedy žádný normativní význam ani nikterak nepředjímá rozsah ani cenu přístroje.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky.
- 7.2. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní, vyjma obchodních informací z této smlouvy, k jejichž zveřejnění na profilu dává půjčitel podpisem této smlouvy vypůjčiteli neodvolatelný souhlas. Půjčitel zajistí, aby osoby, které pověří prováděním prací dle této smlouvy, zachovali mlčenlivost o všech informacích, které se v průběhu provádění prací v prostorách vypůjčitele dozví, které nejsou veřejně přístupné anebo které se pokládají za důvěrné či citlivé údaje. Takovými údaji a informacemi jsou vždy údaje o činnosti na zdravotnických pracovištích a zdravotnická dokumentace pacientů v jakékoliv podobě. Půjčitel bere na vědomí, že závazek mlčenlivosti není časově omezen a že porušení uvedeného závazku může být postihováno podle pravidel českého právního řádu.
- 7.3. Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami; to neplatí v případě změny osob a jejich kontaktních údajů uvedených v bodě 3.4.smlouvy, kdy postačí písemné oznámení adresované druhé smluvní straně.
- 7.4. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou případný spor řešen věcně a místně příslušným soudem vypůjčitele.
- 7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou a účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
- 7.7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 7.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Technická specifikace přístroje
 - Příloha č. 2 - Podmínky servisu po dobu výpůjčky
 - Příloha č. 3 – Minimální plnění, spotřební materiál.

V Litoměřicích dne: 20. 1. 2021

V Brně dne 21.12.2020

.....
Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva

vypůjčitel


.....
MVDr. Miroslav Šišák
jednatel/majitel

půjčitel

Příloha č. 1 - Technická specifikace přístroje

Izolátor nukleových kyselin BioMagPure 12 Plus

Zpracování vzorků:	1 až 12 v jednom běhu
Objem vzorku:	10 – 2000 µl
Eluční objem:	50–400 µl
Čas zpracování:	viz. manuál příslušné soupravy
Teplota vyhřívacího bloku:	60 °C až 70 °C (při pokojové teplotě ~25 °C)
Vstup protokolu:	čtečka čárových kódů
Vestavěné UV světlo:	30 minut při 250 nm
Displej:	LCD displej
Rozměry:	56 cm Š x 59 cm H x 51 cm V
Váha:	55 kg
Vstupní napětí:	AC 100-240 V, 240 VA, 50/60 Hz
Pojistka:	F3.15A 250V

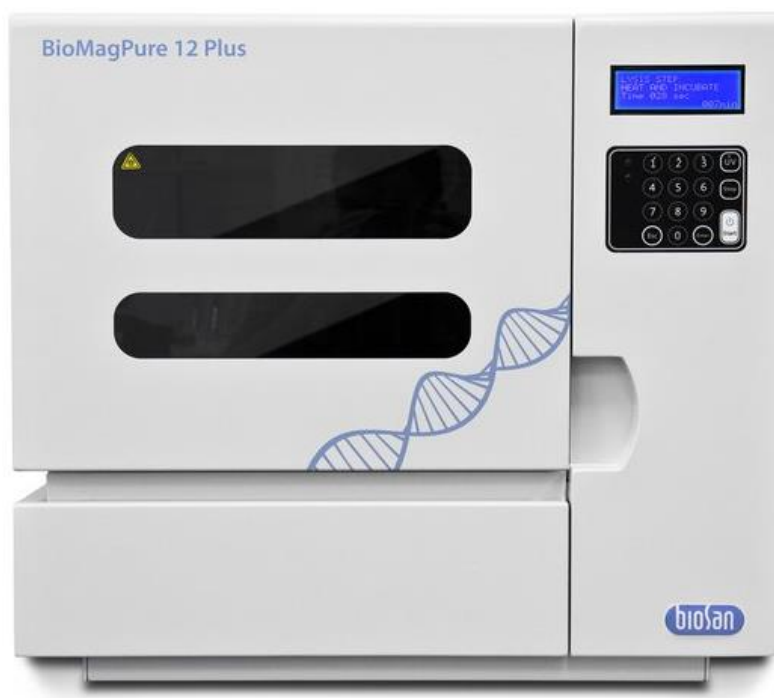

Real time PCR cycler BioQuant-96

Popis produktu

BioQuant-96 je nejnovější produkt z rodiny molekulárních diagnostických produktů firmy Biosan.

Přijal vyspělou termoelektrickou chladicí technologii, zcela nový světelný zdroj a design světelné dráhy. Unikátní metoda konstantního proudu a 6ti zónová nezávislá metoda regulace teploty zajišťují rychlejší, správnější a stabilnější fluorescenční kvantitativní analýzu produktu při zachování jeho vynikajícího výkonu při nízké spotřebě energie.

Produkt je modularizován různými konfiguracemi, ze kterých si můžete vybrat. Mezitím bylo přidáno i pár nových funkcí včetně nezávislé regulace teploty, nízkoteplotního skladování vzorku při 4 °C a automatického odvlhčování.

BioQuant-96 komplexně realizuje automatické nastavení zisku a zlepšuje uživatelský komfort. Plně tak uspokojí poptávku jak ve vědeckém výzkumu, tak i v klinické diagnostice.

Hlavní výhody:

- 6 zónová nezávislá regulace teploty
- Plně automatický zásobník na vzorky
- 6 kanálová konfigurace
- Bez nutnosti kalibrace
- Pokročilá technologie chlazení
- LED excitační zdroj – dlouhá životnost

SPECIFIKACE

Kapacita vzorku

- 0,2 ml v jedné zkumavce (průhledný uzávěr), 96 × 0,2 (0,1) ml destička (průhledný uzávěr), 8 stripové proužky (průhledný uzávěr)

Dynamický rozsah

- 1~1010 kopií

Excitační vlnová délka

- 300-800 nm

Emisní vlnová délka

- 500-800 nm

Počet kanálů

- 6

Rozsah nastavení teploty

- 4-105 °C (po 0,1 °C)

Rychlost ohřevu/chlazení

- 6,0 °C/s / 5,5 °C/s

Přesnost teploty

- $\leq \pm 0,1$ °C



Kolísání teploty

- $\leq \pm 0,3$ °C

Rovnoměrnost teploty

- $\leq \pm 0,3$ °C

Režim regulace teploty

- Režim simulace BLOCK / Tube (automatické ovládání na základě objemu vzorku)

Objemy vzorku

- 5 ~ 100 μ l

Gradientní teplotní rozsah

- 1 ~ 36 °C

Teplotní rozsah vyhřívání víka

- 30 ~ 110 °C (nastavitelné výchozí: 105 °C, automaticky vyhřívání víko)

Opakovatelnost

- 5%

Režim skenování

- Celá destička nebo určený strip

Program

- Max. 20 segmentů pro každý program, max. 99 cyklů

Navazující operace

- ano

Software

- BioQuant-96 Software

Operační systém v PC

- Windows 7/8/10

Potřebný software

- Microsoft Excel

Minimální požadavky na PC

- RAM: 512 MB, pevný disk: 10 GB, procesor: Pentium® 4

Provozní napětí

- 220-240V; ~50/60Hz

Spotřeba energie

- 600 W

Rozměry (DxŠxV)

- 490×290×391 mm

V Brně dne 21.12.2020

.....
Půjčitel

Příloha č. 2 - Podmínky servisu po dobu výpůjčky

Vyplní půjčitel před podpisem smlouvy

Záruční doba	Počet měsíců (min. 24)	24
Záruční servis	Nástup na opravu v hod. od nahlášení - v pracovních dnech od 8 hod. do 16 hod	do 72 hod.
Pravidelné bezpečnostně technické kontroly, validace apod.	Po celou dobu zápůjčky bezplatně	ano
Servisní organizace	Název a sídlo	LABOSERV s.r.o. Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
	Kontakt	servis@laboserv.cz [redacted]
Nezáruční servis	Nástup na opravu od nahlášení - v pracovních dnech od 8 hod. do 16 hod	do 72 hod.
	práce technika za 1 servisní hod. + DPH doprava k zákazníkovi spotřební materiál	[redacted] Kč + DPH [redacted] Kč za 1 km + DPH dle aktuálního ceníku

Náklady na servis přístroje, včetně všech předepsaných kontrol (BTK, validace, výměna dílů) jdou po celou dobu výpůjčky k tíži půjčitele.

Obsahem bezplatné záruční servisní činnosti je:

- Preventivní péče;
- Aplikační podpora;
- Záruční opravy poruch přístroje;
- Pravidelná odborná údržba ve smyslu § 65 zákona č. 268/2014Sb. O zdravotnických prostředcích;

Pokud bude zapotřebí k provedení kontroly dodat spotřební materiál a k provedení opravy dodat náhradní díly, pak jejich dodání je součástí kontroly a opravy.

V Brně dne 21. 12. 2020

Půjčitel: _____

Příloha č. 3 – Rámcová smlouva - minimální plnění, odběr spotřebního materiálu.

Vypůjčitel se zavazuje u půjčitele k odběru souprav k přístrojům:

Pro BioMagPure 12 Plus

Soupravy BS-060201-LK BioMagPure kit pro extrakci virové/patogenní nukleové kyseliny A, 48 t. v ceně [REDACTED] Kč bez DPH za jednu soupravu nebo BS-060201-MK BioMagPure kit pro extrakci virové/patogenní nukleové kyseliny B, 48 t. v ceně [REDACTED] Kč bez DPH nebo BS-060201-FK BioMagPure Bacterial DNA Extraction Kit, 48t. v ceně [REDACTED] Kč bez DPH a to celkem v počtu [REDACTED] ks měsíčně.

Pro real time cycler BioQuant-96

Soupravu abTES COVID-19 qPCR Kit v ceně [REDACTED] Kč bez DPH v počtu [REDACTED] ks měsíčně.

V Litoměřicích dne 20. 1. 2021

V Brně dne 21.12.2020

Ing. Radek Lončák, MBA
předseda představenstva
vypůjčitel

MVDr. Miroslav Šišák
jednatel společnosti
půjčitel