

Objednávka vydaná číslo **OZT/21/02965 / VI**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

24639511/0710

Plátce DPH:

Ano

Dodavatel :

Z TECHNIK s.r.o.

Lochotínská 275

101 00 Praha

IČO: **04115490**

Telefon: **773 840 010, 725 265 416**

Fax:

E-mail: **ztechnik@ztechnik.cz,**
serviszt@olympus.cz

Požadovaný termín splnění objednávky:

spěchá - 5.5.2021

Datum vystavení : 29.4.2021

Datum odeslání :

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	Záruční oprava - Videobronchoskop, typ: BX-XP190, v.č. 2911706, i.č. 4076605	1	397 376,00	397 376,00

Celková částka : **Kč 397 376,00**

Závada - perforace pracovního kanálu.

Spěchá! Jedná se o dětský videobronchoskop, za který nemáme adekvátní náhradu.

Dle CN.

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

**Cenový návrh číslo:
51547101 /12965**

ze dne: 05.05.2021
platný do: 04.07.2021

Číslo Vaší objednávky:
OZT/21/02965/VI

Z-technik s.r.o.

Sokolská 275

109 00 Praha 10



PRACOVNÍSTĚ: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
PŘÍSTROJ: **videobronchoskop**

DATUM INSTALACE: **10.9.2019**
TYP: **BF-XP190**
VÝROBNÍ Č. : **2911706**

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

- netěsnost bioptického kanálu
- deformovaný a odřený zaváděcí tubus

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu kompletní zaváděcí části (polokompletu) včetně kamerového CCD čipu, ohebné části, mechanismu ovládání, vnitřního kanálu, světlovodů včetně světlovodných čoček, krytky a krycí gumy distálního konce


CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 328 410 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% 397 376 Kč

PLATBA BUDE PROVEDENA DLE "SERVISNÍ SMLOUVY".

POZNÁMKA SERVISU: Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o vadu materiálu nebo přístroje a některé závady byly způsobeny mechanicky, nelze tuto opravu uznat celkově jako záruční. Zpoplatněné závady jsou mimo vliv výrobce.

POZNÁMKA SERVISU: Vzhledem k ceně za opravu doporučujeme zvážit rentabilitu opravy oproti nákupu nového, modernějšího přístroje. V případě vašeho zájmu o zakoupení nové zdravotnické techniky společností OLYMPUS, se, prosím, spojte s naší obchodní divizí.

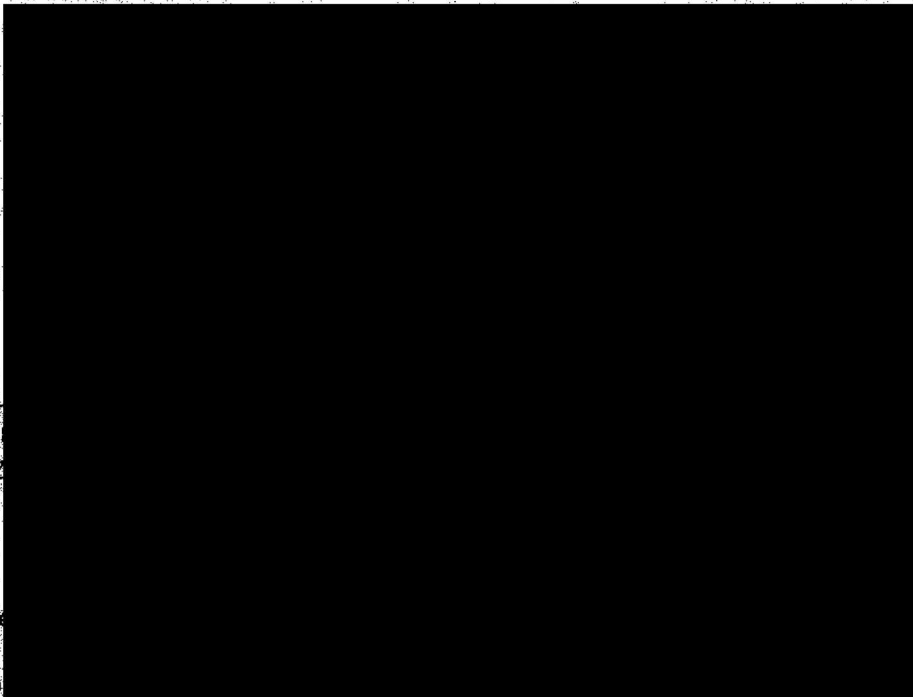

*lob k'zak
předloha*

Požádat o zapůjčení náhradní
Pronájem přístroje se řídí zá

CENOVÝ NÁVRH Z

NÍM OPRAVY

Lukáš Mitlener

DNE: 05.05.2021

Přibližná doba opravy cca. 10 dní. Po provedení opravy je 6 měsíců ode dne provedení opravy. Provoz přístroje a zařízení se provádí na pozadí instalace a vykonání práce. Vše vyžadování zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.