

**Cenový návrh číslo:
51528785/12817**

Číslo Vaší objednávky:
990200178



Klatovská nemocnice, a.s.
Interní oddělení

07-10-2021

Doporučeno

Plzeňská 569
.....
339 38 Klatovy

PRACOVISTĚ: **Interní oddělení**
PŘÍSTROJ: **videokolonoskop**

DATUM INSTALACE: **19.7.2012**
TYP: **CF-HQ190L**
VÝROBNÍ Č. : **2200676**

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

- netěsnost konektorové části multikonektoru
- odřená krytka distálního konce
- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- narušená gumová část ovládacího tlačítka číslo 1
- informativní charakter závady: místy mírně narušený ochranný plášť zaváděcího tubusu - v případě zhoršení stavu doporučujeme výměnu

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části
- výměnu gumové části ovládacího tlačítka číslo 1
- výměnu konektorové části multikonektoru

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 86 938 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% 105 195 Kč

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY
PODPIS / RAZÍTKO

DNE:

[Redacted signature]
er

DNE:

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

OBJEDNÁVKA - Oprava

Odběratel : Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ : 26360527

DIČ : CZ699005333

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B., vložka 1070.
Den zápisu 14. 8. 2003.

Řada dokladu : 990

Číslo dokladu : 200178

Sklad : 070.00080

Telefon :

Fax :

E-mail :

Dodavatel : Olympus Czech Group , s.r.o.

Evropská 176,
160 41 PRAHA 6 -Vokovice

Datum pořízení :

Datum dodání :

IČ : 27068641

DIČ : CZ27068641

řádek č.	Označení	Popis	Výrobní číslo	Oddělení
1	02369	Videokolonoscope CF-HQ190L	2200676	int gastro


-přístroj netěsní

Žádáme Vás po dobu opravy o zapůjčení náhradního přístroje, děkujeme.

Akce: INT. odd. - [REDACTED]

Na základě Zákona č. 340/2015 Vás žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky s uvedením předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Vyřizuje:

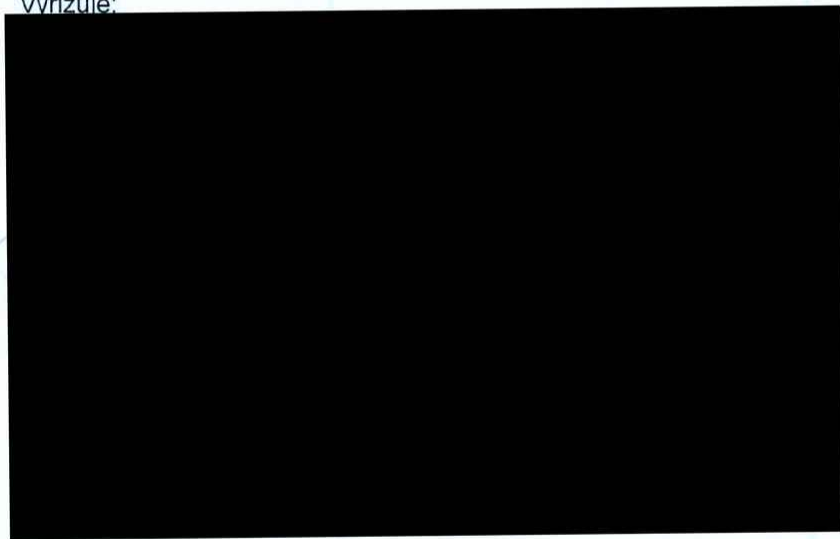

[REDACTED]

Od: service servicedesk
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Předmět: SD-1902-TO oprava

Dobrý den,

byl podán nový požadavek.

Termín první reakce je 2. [REDACTED]

Termín vyřešení požadavku [REDACTED]

interna, Klatovská nemocnice, a. s.

SD-1902-TO oprava

Číslo požadavku: SD-1902-TO

Název požadavku: oprava

Termín vyřešení: [REDACTED]

Žadatel: interna

Organizace: Klatovská nemocnice, a. s.

Služba: Technické oddělení/Zdravotnická technika/Něco mi nefunguje

SLA: Technické oddělení - KN

Priorita: střední

Podáno: [REDACTED]

[Podrobnosti](#)

Od: interna

Odesláno: 1. [REDACTED] 4 (UTC+01:00)

Předmět: oprava

Kontaktní osoba a
telefonní číslo: [REDACTED]

Naléhavost
incidentu: Vysoká

Popis požadavku:

Dobrý den,

na gastroenterologické ambulanci je potřeba vyměnit filtr do ETD

Prosím o opravu kolonoskopu, přístroj netěsní v.č. - 2200676

Prosím o zapůjčení náhradního přístroje.

Děkuji

[REDACTED]