

**Cenový návrh číslo:
51652000/113656**

ze dne: 29.11.2021
platný do: 28.01.2022

Číslo Vaší objednávky:

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600
.....
333 01 Stod



PRACOVÍŠTĚ: Chirurgické odd.
PŘÍSTROJ: Kamerová hlava

DATUM INSTALACE: 9.12.2014
TYP: HD CH 12E
VÝROBNÍ Č. : 7444445

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

Závady související s odlesky, přesevřením nebo tmavým obrazem v kombinaci s přístroji OTV-S190 (7487668) a CLV-S40 (7507880) nebyly potvrzeny. Zjištěno poškození části konektoru kamerové hlavy - nutná výměna kabelové jednotky. Kvůli poškozenému optickému adaptéru (pravděpodobně po nárazu) je nesouosý obraz.

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :


- částečná demontáž (již provedeno)
- dekontaminace (již provedeno)
- výměnu kabelové jednotky
- výměnu adaptéru

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.....
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%




Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

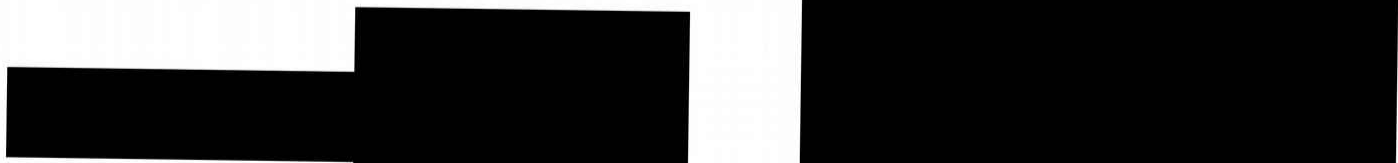

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

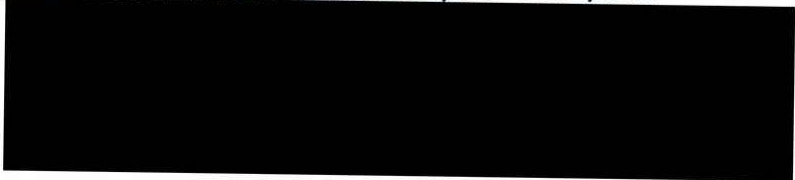

**Cenový návrh číslo:
51652005/113657**ze dne: 29.11.2021
platný do: 28.01.2022

Číslo Vaší objednávky:

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600
.....
333 01 StodPRACOVISŤE: Chirurgické odd.
PŘÍSTROJ: Zdroj světla

DATUM INSTALACE: 17.6.2005

TYP: CLV-S40

VÝROBNÍ Č. : 7507880

**NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY
PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:**

Přístroj byl řádně testován s kamerovou hlavou OTV-S7ProH-HD-12E (7444445) a video procesorem OTV-S190 (7487668). Uvedený problém s obrazem nebyl zjištěn. Použitý zdroj světla je starší typ, který může mít pomalejší odezvu intenzity světla - nejedná se však o závadu. Doporučujeme používat zdroj světla CLV-S190 nebo manuální režim osvětlení, v tomto případě regulaci světla provádí video procesor. Bez známek mechanického poškození. Funkce porovnány s referenčním přístrojem stejného typu.

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- dekontaminaci (již provedeno)
- částečnou demontáž (již provedeno)

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.....
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápůjčními podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :



Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

**Cenový návrh číslo:
51651961/113655**

ze dne: 29.11.2021
platný do: 28.01.2022

Číslo Vaší objednávky:

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600
.....
333 01 Stod



PRACOVISŤĚ: Chirurgické odd.

PŘÍSTROJ: Videoprocesor

DATUM INSTALACE: 9.12.2014

TYP: OTV-S190

VÝROBNÍ Č. : 7487668

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

Přístroj byl řádně testován s kamerovou hlavou OTV-S7ProH-HD-12E (7444445) a zdrojem světla CLV-S40 (7507880). Uvedený problém s obrazem nebyl zjištěn. Použitý zdroj světla je starší typ, který může mít pomalejší odezvu intenzity světla - nejedná se však o závadu. Doporučujeme používat zdroj světla CLV-S190 nebo případně manuální režim osvětlení, v tomto případě regulaci světla provádí video procesor. Přístroj je bez známek mechanického poškození.

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- dekontaminaci (již provedeno)
- částečnou demontáž (již provedeno)



CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.....

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%



Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

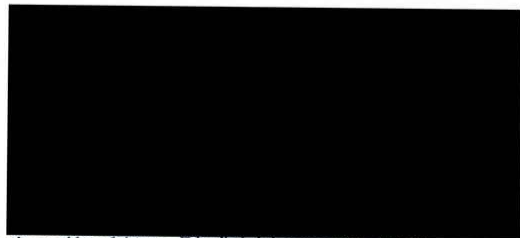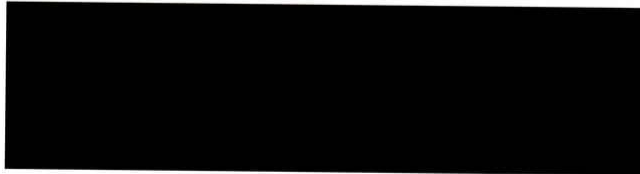

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zaslejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

