

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č.2 k č.j.: 869/2017-ÚVN

Dodávky jednorázové injekční techniky – dvoudílné stříkačky LUER a jehly LUER-LOCK II**Název firmy :** CHIRANA T.Injecta, s.r.o.**Adresa :** Komořanská 2148, Praha 4 –


Modřany, 143 00


IČ : 26216469**DIČ :** CZ 26216469.**Kontaktní osoba :****Telefon :****e-mail :**

Nabízené zboží	MJ	Předpokládaná roční spotřeba v ks			Předpokládaná roční spotřeba celkem v ks	Počet požadovaných vzorků	Cena zboží za 1 ks		Cena zboží celkem	
		VN Olomouc	VN Brno	ÚVN Praha			bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
Injekční stříkačky dvoudílné jednorázové LUER – sterilní CPV 33141310-6						ÚVN Praha				
						balení				
2 ml	ks									
5 ml	ks									
10 ml	ks									
20 ml	ks									
Injekční jehly jednorázové LUER-LOCK – sterilní CPV 33141320-9										
G 18 Růžová (rozměr 1,2x40mm)	ks									
G 20 Žlutá (rozměr 0,9x40 mm)	ks									
G 21 Zelená (rozměr 0,8x40mm)	ks									
G 22 Černá (rozměr 0,7x40mm)	ks									

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

G 23 Modrá (rozměr 0,6x30mm)	ks
G 24 Fialová (rozměr 0,55x25mm)	ks
G 25 Oranžová (rozměr 0,5x16mm)	ks
G 27 Šedá (rozměr 0,4x20mm)	ks

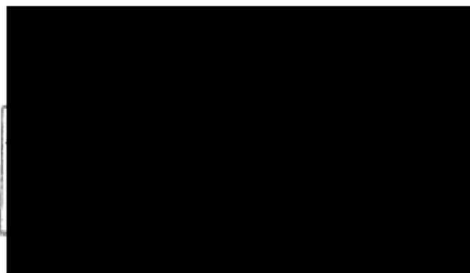Cena zboží celkem / 12 měsíců**Cena zboží celkem / 24měsíců****Termín dodání: 48 hodin**



			953 704,00	1 153 981,84
			1 907 408,00	2 307 963,68

Certifikát o pojištění

Certificate of insurance



Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that

jméno / name CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
adresa / address Komořanská 2148, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO/No. 262 16 469
(dále jen "pojistník/pojištěný")
(hereafter „policy holder/insured“)

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
(dále jen "pojistitel")
(hereafter „insurer“)

Pojištění odpovědnosti č. / Liability insurance No.: 

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu (VPPO 2003), Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní rizika (ZPPO 2003) a dle ve smlouvě uvedených ujednání.

General and product liability insurance governed by General insurance conditions for liability insurance (VPP O 2003), Special Insurance Terms for Liability Insurance (ZPPO 2003) according to all in the contract named clauses.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:

Limit of indemnity for the basic scope of cover:

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:

Deductible for the basic scope of cover:


Územní rozsah pojistného krytí:

Territorial scope of cover:


Pojistné období:

Insurance period:


V / at place Praze, dne/date 13. 12. 2016


Ing. Damiel Krupicka
vedoucí upisovatel
Chief Underwriter

Generali Pojišťovna a.s. A046
obecná lechtutaví
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


Marcela Frydová
upisovatel
Underwriter

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

	Technické podmienky	TPF 330-0508-01	Revízia: 4
	STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE		Platí od: 13. 4. 2012 List: 1/9

OBSAH

I.	ÚČEL A POUŽITIE	2
II.	PREVEDENIA VÝROBKU.....	2
III.	TECHNICKÉ ÚDAJE	2
IV.	BALENIE	6
V.	IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU	7
VI.	SKÚŠANIE.....	7
VII.	DODÁVANIE, ZÁRUKA.....	8
VIII.	DOPRAVA, SKLADOVANIE	8
IX.	PRÍLOHY	9
	PRÍLOHA 1. SÚVISIACE NORMY	
	PRÍLOHA 2 ÚDAJE NA OBALOCH, ŠTÍTKOCH A DOTLÁČANÉ ÚDAJE	
	PRÍLOHA 3 ROZMERY A POČTY KUSOV V JEDNOTLIVÝCH OBALOCH	
	PRÍLOHA 4 PLÁN KVALITY (SKÚŠANIE A KONTROLA IHIEL)	

Schválil: Volár Peter [Technical manager].

Schválil: Strelník Boris [Production manager L]

Vypracoval: Miroslav Koštna technolog



CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 330-0508-01

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 2/9



CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 3/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE



CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 4/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE



Technické podmienky


TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 5/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE





Technické podmienky

TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 6/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE



CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 7/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE



Technické podmienky

TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 8/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE



Technické podmienky


TPF 330-0508-01

Revízia: 4

Platí od: 13. 4. 2012

List: 9/9

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE





Technické podmienky

TPF 330-0508-01


Revízia: 1


Platí od: 27. 5. 2008

List: 1/1

STERILNÁ INJEKČNÁ IHLA NA JEDNO POUŽITIE

Príloha 3



	Technické podmienky	TPF 320-0508-01	Revízia: 4
	STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO POUŽITIE		Platí od: 10. 6. 2011 List: 1/9

OBSAH

I.	ÚČEL A POUŽITIE	2
II.	PREVEDENIA VÝROBKU.....	2
III.	TECHNICKÉ ÚDAJE	2
IV.	BALENIE	6
V.	IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU	7
VI.	SKÚŠANIE.....	7
VII.	DODÁVANIE, ZÁRUKA.....	8
VIII.	DOPRAVA, SKLADOVANIE	8
IX.	PRÍLOHY	9
	PRÍLOHA 1.	SÚVISIACE NORMY
	PRÍLOHA 2	ÚDAJE NA OBALOCH, ŠTÍTKOCH A DOTLÁČANÉ ÚDAJE
	PRÍLOHA 3	ROZMERY A POČTY KUSOV V JEDNOTLIVÝCH OBALOCH
	PRÍLOHA 4	PLÁN KVALITY (SKÚŠANIE A KONTROLA STRIEKAČIEK)

Schválil: Ing. Peter Volár Technický manager

Schválil: Ing. Martin Hyrošš Manager pre kvalitu

Vypracoval: Ing. Pavol Myjavec Konštruktér



Technické podmienky

TPF 320-0508-01


Revízia: 4

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO

Platí od: 10. 6. 2011

POUŽITIE

List: 2/9





Technické podmienky

TPF 320-0508-01


Revízia: 4

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO

Platí od: 10. 6. 2011

POUŽITIE

List: 3/9





CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 320-0508-01

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO

POUŽITIE

Revízia: 4

Platí od: 10. 6. 2011

List: 4/9



CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 320-0508-01

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO
POUŽITIE

Revízia: 4

Platí od: 10. 6. 2011

List: 5/9



CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 320-0508-01

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO
POUŽITIE

Revízia: 4

Platí od: 10. 6. 2011

List: 6/9



Technické podmienky

TPF 320-0508-01


Revízia: 4

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO

Platí od: 10. 6. 2011

POUŽITIE

List: 7/9





CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 320-0508-01

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO


POUŽITIE

Revízia: 4

Platí od: 10. 6. 2011

List: 8/9

 CHIRANA T. Injecta	Technické podmienky	TPF 320-0508-01	Revízia: 4
	STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO POUŽITIE		Platí od: 10. 6. 2011 List: 9/9





CHIRANA
T. Injecta

Technické podmienky

TPF 320-0508-01

Revízia: 1

Platí od: 8.5.2008

List: 1/1

STERILNÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA NA JEDNO POUŽITIE

Príloha 3-BE

