


# KUPNÍ SMLOUVA

číslo: .....

uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## mezi těmito smluvními stranami



### **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín  
právně jednající: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.  
IČO: 71009221  
DIČ:  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
č. účtu: 31522661/0710  
kontaktní osoba: Ing. Ján Horký  
telefon:   
fax:  
e-mail: jan.horky@khszlin.cz  
datová schránka: xwsai7r

(dále jen „kupující“)

a

### **Obchodní firma**

MASANTA s.r.o.  
se sídlem: Dolnocholupická 915/65, Modřany, 143 00 Praha 4  
spisová značka: C 65055 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupena: Mgr. Martinem Ladyrem, jednatelem  
IČO: 25730533  
DIČ: CZ25730533  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2800070591/2010  
kontaktní osoba: Mgr. Martin Ladyr  
telefon:   
e-mail:   
datová schránka: ii4keig

(dále jen „prodávající“)

(dále také společně „smluvní strany“)

## **Článek I** **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je koupě věci specifikované blíže v čl. II této smlouvy na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené mezi Správou státních hmotných rezerv jako Centrálním zadavatelem a kupujícím jako Pověřujícím zadavatelem a na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2022 č. 5 k pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru.

## **Článek II** **Předmět smlouvy**

1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu **2000 ks testovacích sad antigenních testů Singclean® COVID-19 testovací sada (metoda koloidního zlata)** (dále také „věc“ nebo „testy“, „testovací sady“) v množství, jakosti a provedení dle ujednání této smlouvy. Dále se prodávající zavazuje kupujícímu předat veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání věci a umožnit mu nabytí k věci vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc protokolárně převzít, a to pouze ve stanovené jakosti, množství a provedení a zaplatit kupní cenu.
2. Proávající nesmí dodat větší nebo menší množství věci, než je ujednáno v této smlouvě. Použití ustanovení § 2093 a § 2099 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany výslovně vylučují.
3. Specifikace věci:

Věc: sady antigenních testů

Kód NTPFZ: 33141625-7

Celkové množství: 2000 ks

### **Balení:**

- Proávající (při zohlednění množství dodávané věci) je povinen dodat testovací sady balené na paletách, nebo v odpovídajícím balení, a je povinen dodržet všechny přepravní, skladovací a manipulační podmínky, včetně teplotních limitů a režimu stanoveného výrobcem.
- Jednotlivá balení testovacích sad budou dodána v nepoškozených papírových kartonech, s vyznačením data expirace a čísla šarže. Každé jednotlivé balení testu bude označeno mimo další povinné náležitosti též číslem šarže a datem expirace.
- Jednotlivá balení testovacích sad budou v rozsahu od jednoho po maximálně 30 kusech v balení.
- Palety, na kterých budou kartony s testovacími sadami umístěny a budou-li použity, jsou součástí dodávky. Maximální výška palet s kartony je 1,8 m. Kartony na paletách budou stabilizované tak, aby při manipulaci nemohlo dojít k jejich pádu.

**Doba použitelnosti:** minimálně 9 měsíců od data dodání.

Technická specifikace věci je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.

4. Současně s věcí odevzdá prodávající kupujícímu zejména následující doklady v českém, případně i anglickém jazyce:

- a) Testy a jejich výrobce musí splňovat požadavky podle zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a požadavky dle nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky *in vitro* (dále jen „nařízení vlády č. 56/2015 Sb.“), což prodávající doloží Prohlášením o shodě spolu s certifikátem vydaným oznámeným subjektem pro diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro* určený pro sebetestování.
  - b) Návod k použití, který musí odpovídat požadavkům na návod diagnostických zdravotnických prostředků *in vitro* určených pro sebetestování. Návod k použití musí být součástí každého balení.
  - c) Dodací list
  - d) Předávací protokol
- Označení výrobku a návod k použití musí splňovat požadavky Přílohy 1 k nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

### Článek III Kupní cena

1. Celková kupní cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady kupujícího spojené s koupí věci. K této částce bude připočtena platná sazba DPH v době vzniku zdanitelného plnění.
2. Kupní cena tedy činí:
  - a) kupní cena za jednotku **bez DPH** ve výši **16,48 Kč**  
(slovy šestnáct korun českých čtyřicet osm haléřů)
  - b) kupní cena celkem **bez DPH** ve výši **32 960,- Kč**  
(slovy třicetdvatisícdevětsetšedesát korun českých)
  - c) **DPH** ve výši celkem **0 Kč**  
(slovy nula korun českých)
  - d) kupní cena **včetně DPH** ve výši celkem **32 960,- Kč**  
(slovy třicetdvatisícdevětsetšedesát korun českých).

Kupní cena **včetně DPH** činí celkem **32 960,- Kč** (slovy třicetdvatisícdevětsetšedesát korun českých).

### Článek IV Platební a fakturační podmínky

1. Kupní cenu věci včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po jejím protokolárním převzetí bez vad zjevně bránících předání a převzetí věci za přítomnosti oprávněných zástupců kupujícího a prodávajícího, včetně doložení písemného prohlášení a dokladů podle této

smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Po dobu platnosti Rozhodnutí ministryně financí č. 48 o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 35/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dále jen „Rozhodnutí“) je zboží osvobozeno od daňové povinnosti. Po dobu platnosti tohoto Rozhodnutí nebude prodávající na daňovém dokladu uvádět daň na výstupu.

Toto ujednání platí i v případě prodloužení platnosti výše uvedeného Rozhodnutí nebo vydání nového rozhodnutí ministryně financí obsahujícího úpravu osvobození od daňové povinnosti.

V případě dodávky jednotlivých částí dle čl. V odst. 1 vzniká právo na zaplacení části kupní ceny odpovídající dodávce věci.

2. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového dokladu (faktury). Faktura bude zaslána do datové schránky kupujícího nebo e-mailem na adresu ..... Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc či xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
3. Kupující neposkytuje zálohu na kupní cenu.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je prodávající povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje kupující a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu s tím, že prodávající je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury kupujícímu nová lhůta splatnosti.
5. Dohodou smluvních stran se sjednává splatnost faktury na **30 kalendářních dnů** od dne doručení faktury kupujícímu. Faktura je zaplacena dnem připsání platby na účet prodávajícího.
6. Proávající prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek V

### Doba, místo a podmínky plnění

1. Proávající se zavazuje kupujícímu odevzdat věc v celkovém množství, provedení a jakosti dle této smlouvy a předat doklady potřebné k převzetí a užívání věci nejpozději **do 21. 1. 2022**, s tím, že pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy do 18. 1. 2022 z důvodu prodloužení vzniklého na straně kupujícího, prodlužuje se termín dodání o dobu výše uvedeného prodloužení s uzavřením smlouvy. Maximální doba prodloužení termínu dodání však může odpovídat pouze prodloužení s uzavřením smlouvy na straně kupujícího v případě uzavření smlouvy nejpozději dne 21. 1. 2022. **Proávající musí zajistit splnění podmínek stanovených pro dodání na území ČR v souladu s platnou legislativou ČR.**
2. Proávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li kupujícímu nakládat s věcí v místě a v době plnění dle této smlouvy na základě oboustranně podepsaného protokolu bez vad zjevně bránících předání a převzetí věci. Má-li věc vady zjevně bránící předání a převzetí

věci, a je tedy k předání nezpůsobilá, není kupující povinen věc převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání věci. Protokol se vyhotoví ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Prodávající odevzdá věc a doklady určené ve smlouvě kupujícímu v místě plnění, nacházejícím se na níže uvedené adrese:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600

760 01 Zlín

Přesné adresy míst plnění s kontaktními údaji budou poskytnuty prodávajícímu při podpisu smlouvy.

4. Nedodání smluvené věci v místě a času plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání věci se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

#### **Článek VI**

##### **Dopravní dispozice a úhrada dopravného**

1. Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání, nejpozději však při převzetí věci kupujícím.
2. Dopravu věci do místa plnění si zajišťuje prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

#### **Článek VII**

##### **Práva z vadného plnění**

1. Věc je vadná, jestliže nemá vlastností stanovené touto smlouvou nebo pokud je prodávajícím dodána jiná věc než ta, která má být předmětem této smlouvy. Za vadu věci se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. V případě vadného plnění je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. Vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným sdělením v souladu s čl. XII odst. 5. Prodávající se zavazuje odstranit uplatněné vady při reklamaci věci ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění vad.
3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy toto právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Nepotvrzení uplatnění práva z vadného plnění prodávajícím do 3 pracovních dnů ode dne sdělení uplatnění vad je důvodem pro odstoupení kupujícího od této smlouvy.

#### **Článek VIII**

##### **Záruka za jakost**

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu záruku za jakost věci bez vad zjevně bránících předání a převzetí věci (záruční doba) po dobu expirace věci. Dodaná věc musí být po celou dobu záruční doby způsobilá pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek věci podle čl. II této smlouvy (Přílohy č. 1).

## **Článek IX Smluvní pokuta**

1. Nedodá-li prodávající věc do uplynutí doby plnění dle čl. V této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny nedodané věci za každý den prodlení.
2. V případě, že prodávající neodstraní vady bránící předání a převzetí věci v náhradním termínu dohodnutém dle čl. V odst. 2, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 a 2 tohoto článku na úhradu kupní ceny věci dle čl. IV.
4. Pro výpočet výše uvedených smluvních pokut se použije kupní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. III této smlouvy.
5. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu, na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Proávající prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

## **Článek X Odstoupení od smlouvy**

1. Kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy kupujícím uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy nebo občanském zákoníku je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, obdrží-li od prodávajícího věc jiných vlastností, nebo neobdrží-li všechny doklady uvedené v čl. II odst. 4 této smlouvy.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit.
3. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě porušení povinností prodávajícího dle čl. IV odst. 6.
5. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny za věc v délce více než 30 dní, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XII odst. 5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, ani práva na náhradu škody.
8. V případě odstoupení od smlouvy se odstoupení nevztahuje na smluvními stranami již poskytnuté vzájemné plnění.

**Článek XI**  
**Nabytí vlastnického práva k věci**  
**Nebezpečí škody na věci**

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k věci nabývá kupující převzetím věci bez vad bránících předání a převzetí věci na základě oboustranně podepsaného protokolu.
2. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva k věci.

**Článek XII**  
**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Prodávající souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zajišťuje kupující.
3. Prodávající souhlasí, aby kupující poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změn v záhlaví smlouvy: bankovního spojení, sídla, zastoupení atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě do datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující.
7. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná jejím zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace věci

Příloha č. 2 – Prohlášení o shodě

Příloha č. 3 – Návod k použití

Příloha č. 4 – Certifikát vydaný oznámeným subjektem

Příloha č. 5 – Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dovozce/distributora diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v registru zdravotnických prostředků

Příloha č. 6 – Rozhodnutí o registraci testu v registru zdravotnických prostředků

Ve Zlíně dne 18. ledna 2022

V ..... dne .....

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

**MUDr. Eva** Digitálně podepsal  
**Sedláčková,** MUDr. Eva  
**Ph.D.** Sedláčková, Ph.D.  
Datum: 2022.01.18  
08:20:56 +01'00'

.....  
**MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.**  
ředitelka

**MASANTA s.r.o.**  
**Mgr.** Digitálně podepsal  
**Martin** Mgr. Martin Ladyr  
**Ladyr** Datum: 2022.01.18  
14:21:22 +01'00'

.....  
**Mgr. Martin Ladyr**  
jednatel



# Singclean®


CE  
1434

Testovací sada COVID-19  
(Metoda koloidního zlata)

Pro samotestování  
( vzorek z nosu )

Top 10 mezi čínskými držiteli CE  
pro rychlé samotestovací sady

- Přesně Rychle Citlivě
- Domácí samotestování
- Včasná detekce
- Možnost prodeje mezi státy EU

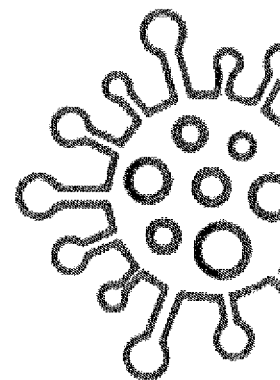

Hangzhou Singclean Medical Products Co.,Ltd.

# Singleclean®


## Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

### ► Použití

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní detekci antigenu nového koronaviru 2019 v šedé nosní dutině. Tento test poskytuje pouze předběžný výsledek pro sebetestování. Proto každý pozitivní výsledek detekovaný testovací sadou COVID-19 (metoda koloidního zlata) musí být potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy.

### ► Hlavní příznaky Covidu-19

- Horečka
- Únava
- Kašel
- Dýchavičnost



### ► Vlastnosti

- Pro sebetestování
- Výsledek za 15 minut
- Přesná diagnostika při aktivní infekci
- Snadné provedení a interpretace výsledků
- Cenově dostupný, bez potřeby nástrojů, snadno přenosný
- Umožňuje plošné testování

# Singclean®

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

## ► Porovnání různých testovacích metod pro detekci COVID-19

Singclean®	PCR (na nukleových kyselinách)	Test protilátek	Test antigenů
Klinická hodnota	Diagnóza, zlatý standard	Pomočná diagnóza	Diagnostika a screening
Období testování	Ranná fáze infekce	Pozdní fáze nebo po nízké	Ranná fáze infekce
Délka provedení	6 hodin	10 minut	15 minut
Vybavení pro provedení testu	Kompletní laboratoř pro PCR	Není třeba zvláštní zařízení	Není třeba zvláštní zařízení
Cena	Vysoká	Nízká	Nízká
Požadovaný vzorek	Ze sňů, vyfýk z nosu nebo orelu	Urine, sputum a pleťná	Ze sňů, nosu a močobyloru
Skladování	Chladicí zařízení	Pokojová teplota	Pokojová teplota
Čitlivost	Vysoká, koloidní pozitivita neprochází obdobím klasická negativita opodlnění	Nízká, koloidní pozitivita i negativita se může objevit	Nízká, koloidní pozitivita neprochází obdobím, pokud negativita se může objevit a negativita výsledku může být potvrzen PCR testem. Antigenní testy jsou společně přesnější než testy PCR, ale jsou rychlejší a levnější.

## ► Skladování

Soupravu lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladu (4-30°C). Testovací sada je stabilní do data expirace vytištěného na uzavřeném obalu. Testovací sada musí až do svého použití zůstat uzavřená. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

# Singclean®

## Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

### Informace o produktu

Název	Singclean COVID-19 testovací sada (pro sebeřesování)
Typ testu	antigenní test
Princip testu	metoda koloidního zlata
Typ vzorku	výtěr z nosu
Objem vzorku	3 kapky isotonického roztoku (0,9%)
Kvalitativní / kvantitativní	kvalitativní
Doba trvání testu	15 minut
Teplota během procesu	15-25°C
Teplota uchování	2-30°C

### CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI

Klinická citlivost, specifická a přesnost

Výsledky testovací sady COVID-19 Test IGI (metoda koloidního zlata) byly srovnány s výsledky analýzy RT-PCR pro SARS-CoV-2 ze vzorků z výtěru nosu. V této studii bylo testováno celkem 499 vzorků z výtěru z nosu. Klinické vzorky COVID-19 obsahují vzorky od jedinců s příznaky do 7 dnů. Výsledkem testování a kontrolního činidla bylo 350 negativních vzorků a 149 pozitivních vzorků. Vypočítaná citlivost a specifická byly v této studii platné.

Testovací sada COVID-19 versus PCR

Metoda	Výsledky PCR			
	Pozitivní	Negativní	Celkem	
testovací sada COVID-19	Pozitivní	146	1	147
	Negativní	3	349	352
Celkem	149	350	499	
Citlivost	97,99%	spolehlivost 95%	94,25% - 99,31%	
Specifická	99,71 %	spolehlivost 95%	98,40% - 99,95%	
Přesnost	99,20 %	spolehlivost 95%	97,96% - 99,69%	

# Singleclean®

## Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

- ▶ **BALENÍ**  
1 test/krabička  
20 tests/krabice


- ▶ **OBSAH**  
Uzavřené sáčky, z nichž každý obsahuje testovací kazetu a vysoušedlo  
Bavlněné tamponové tyčinky pro odběr vzorků (pouze z nosní dutiny)  
Extrakční pufr  
Zkumavka pro extrakci antigenu  
Papírová pracovní podložka (krabičku lze použít jako pracovní podložku)  
Návod k použití

- ▶ **MATERIÁLY POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ**
  1. Odpadová nádoba na vzorky
  2. Časomíra

### ▶ Postup testu




1. Očistěte si ruce a omyjte si nosní dutinu  
sterní solí. Neusušete si nos.



2. Jasně a pomalu zavedete tyčinku do nosní dutiny (asi 2-4 cm). Otočte ji asi 5krát.



3. Smazání vlhčené tamponové tyčinky.




4. Větší světelný svazek na barevné tyčince, až dojde k zesílení a přechází  
přesnějším směrem pro lepší viditelnost  
světelné tyčinky od 90s. Přitom přičašně  
kvalitní poměr světla zkontrolujte.




1 min

5. Větší od 1 minuty až 2 minuty  
výsledky a přičašně test funguje,  
aby se v testu dříve na výsledky.



1 min

6. Zkontrolujte povrch testovací  
tyčinky a v případě  
1. výsledky od



3 křivky  
extrakčního  
materiálu

7. přičašně křivky vidět na straně  
na testu pro různé testovací křivky.




15 min

8. Výsledky odečítáte za 15 minut.

# Singclean®

## Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

### ► Interpretace výsledků

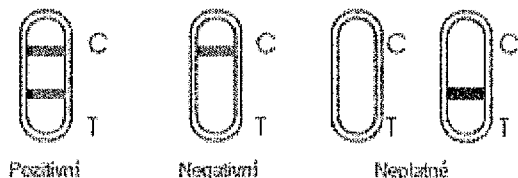

### ► Negativní:

Pokud je přítomen pouze proužek C, nepřítomnost jakékoli vlnové barvy v pruhu T znamená, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní.

Pokud je výsledek testu negativní:

I nadále dodržujte všechna platná nařízení týkající se kontaktu s ostatními a ochranná opatření.

I když je test negativní, může být přítomna infekce.

V případě podezření opakujte test po 1 - 2 dnech, protože koronavirus lze přesně detekovat ve všech fázích infekce.

### ► Positivní na Covid-19:

Pokud je přítomen proužek C a T, test indikuje přítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní na COVID-19.

Na základě výsledku existuje podezření na infekci COVID-19.

Okamžitě kontaktujte lékaře nebo místní zdravotní zařízení.

Dodržujte pokyny hygieny pro samoizolaci.

Nechte si provést potvrzující test PCR.

### ► Neplatný:

Kontrolní čára se nezobrazuje. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní linky. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací sadu používat a kontaktujte místního distributora.

V případě neplatného výsledku testu:

Předběžné varování z důvodu nesprávnému provedení testu.

Zopakujte test.

Pokud jsou výsledky testů stále neplatné, kontaktujte lékaře nebo testovací centrum COVID-19.

# Singclean®


## Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata)

### ► Omezení

1. Kdykoli je to možné, používejte čerstvé vzorky.
2. Optimální provedení testu vyžaduje přísné dodržování testovacího postupu popsaného v tomto letáku. Odchyšky mohou vést k odchylným výsledkům.
3. Negativní výsledek u jednotlivého subjektu indikuje nepřítomnost detekovatelného antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negativní výsledek testu však nevylučuje možnost infekce COVID-19.
4. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) přítomného ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud selhal odběr COVID-19 (SARS-CoV-2) antigenu v nosní dutině pacienta.
5. Testovací sada poskytuje předběžné sebehodnocení. Diagnózu by měl stanovit lékař až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.
6. Používejte pouze pro diagnostiku in vitro, testovací sadu nelze použít opakovaně.
7. Extrakční pufr se používá k extrakci vzorků a lidé ani zvířata jej nesmí používat interně ani externě. Polknutí způsobí vážnou újmu. Pokud k němu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pufr dráždí oči a pokožku, pokud dojde k náhodnému poškození očí, okamžitě je vypláchněte vodou. V případě potřeby se poraďte s lékařem a během procedury větrejte.


### ► Varování a opatření

1. Pro neprofesionální samostatovací použití. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
2. Před provedením testu si přečtěte celý příbalový leták. Nerespektování příbalového letáku vede k nepřesným výsledkům testu.
3. Nepoužívejte test, pokud jsou zkumavka nebo sáček poškozeny nebo zlomeny.
4. Test je pouze na jedno použití. Za žádných okolností nepoužívejte opakovaně.
5. Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

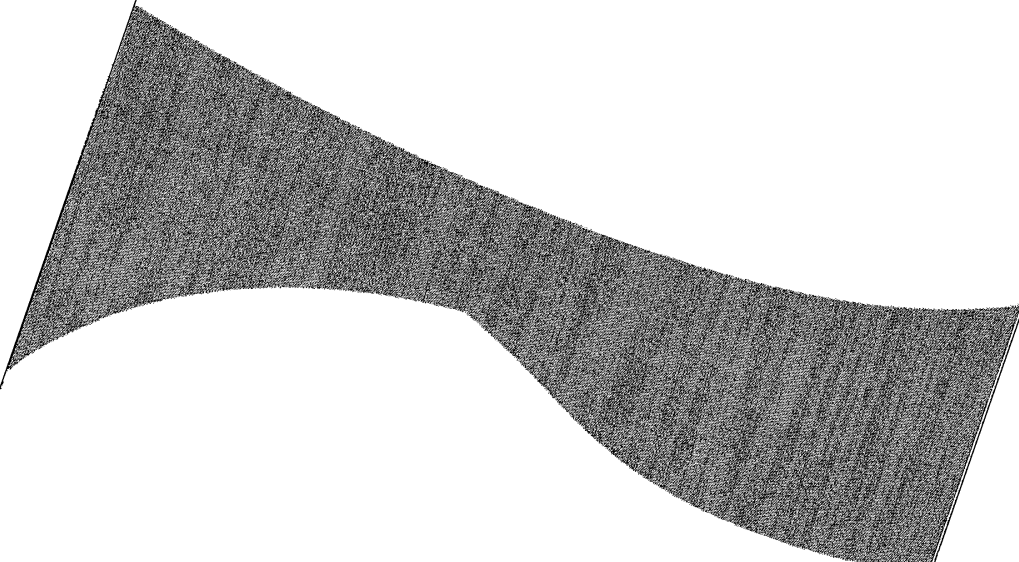

Dovozce:  
MASANTA s.r.o.  
Dolnocholupická 915/65  
143 00 Praha 4  
IČO: 25730533  
DIČ: CZ25730533



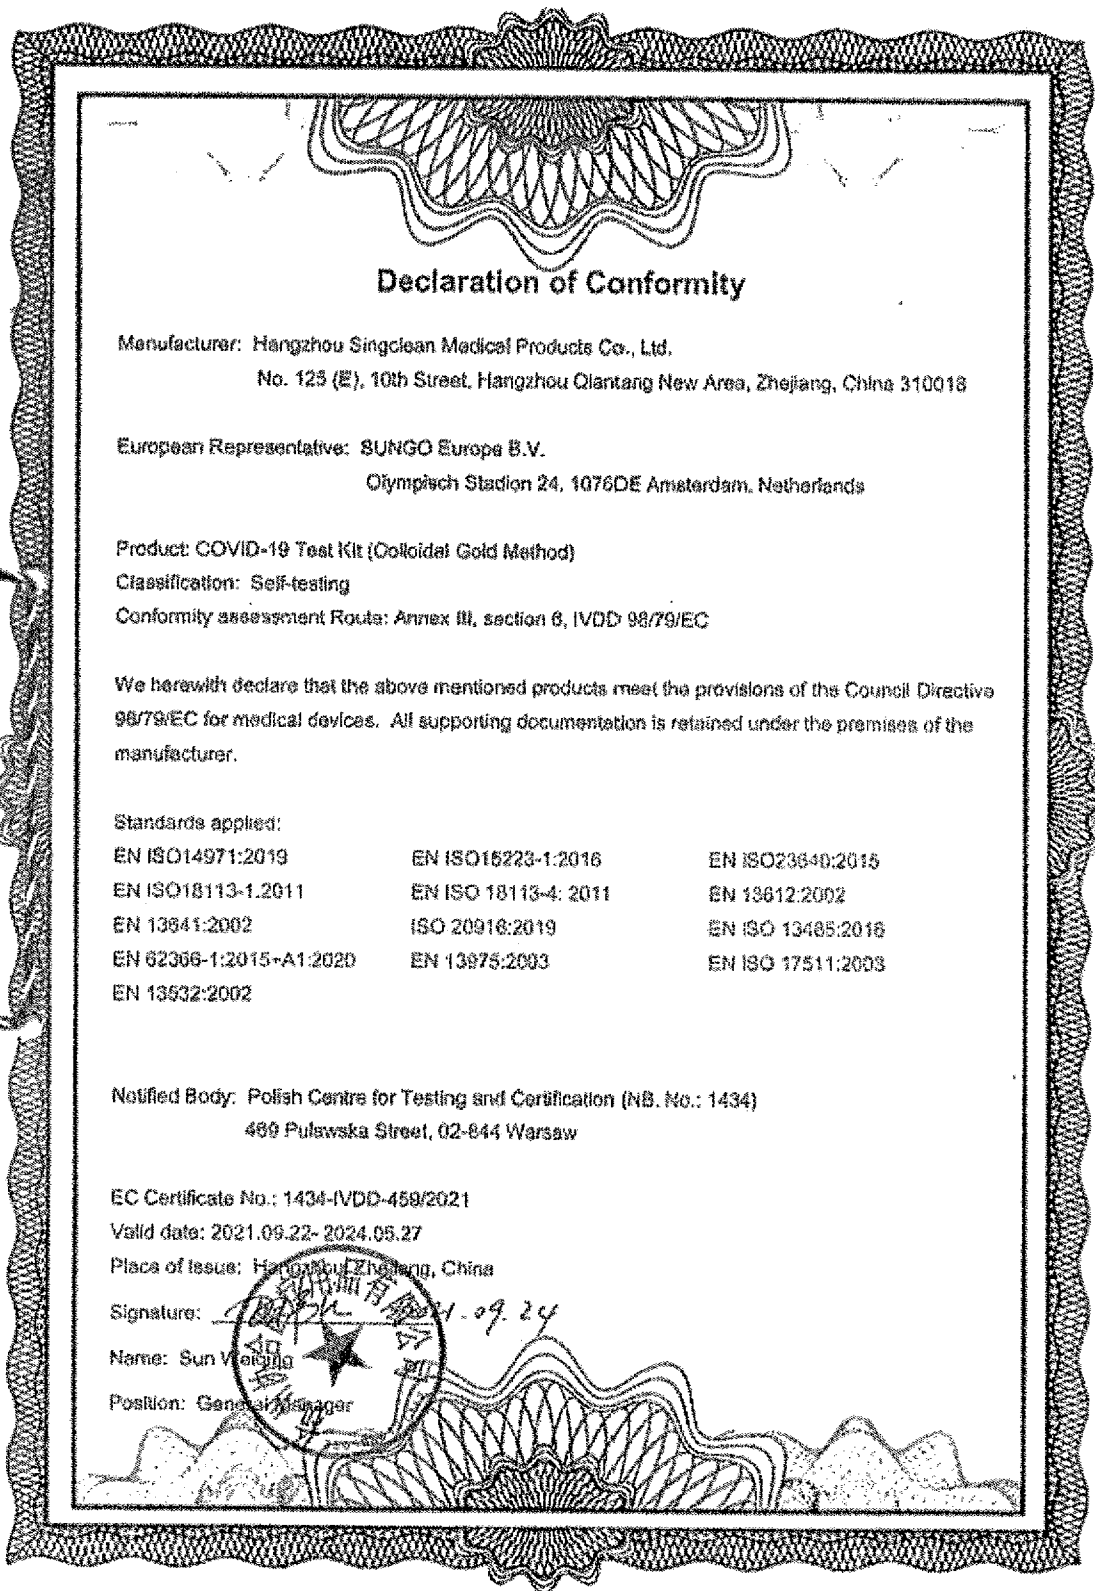

**Declaration of Conformity**

Manufacturer: Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.  
No. 125 (E), 10th Street, Hangzhou Qiantang New Area, Zhejiang, China 310018

European Representative: SUNGO Europa B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Product: COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)  
Classification: Self-testing  
Conformity assessment Route: Annex III, section 6, IVDD 98/79/EC


We herewith declare that the above mentioned products meet the provisions of the Council Directive 98/79/EC for medical devices. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer.

Standards applied:

EN ISO14971:2019	EN ISO15223-1:2016	EN ISO23640:2015
EN ISO18113-1:2011	EN ISO 18113-4: 2011	EN 13612:2002
EN 13941:2002	ISO 20916:2019	EN ISO 13485:2016
EN 62366-1:2015-A1:2020	EN 13975:2003	EN ISO 17511:2003
EN 13532:2002		


Notified Body: Polish Centre for Testing and Certification (NB. No.: 1434)  
489 Pulawska Street, 02-844 Warsaw

EC Certificate No.: 1434-IVDD-459/2021  
Valid date: 2021.09.22- 2024.05.27  
Place of issue: Hangzhou Zhejiang, China

Signature:  2021.09.24

Name: Sun Weiqiang

Position: General Manager



Překlad z jazyka anglického

## Prohlášení o shodě

Výrobce: Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.  
No. 125 (E), 10th Street, Hangzhou Qiantang New Area, Zhejiang, Čína 310018

Evropský zástupce: SUNGO Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1078DE Amsterdam, Nizozemsko

Výrobek: Testovací souprava COVID-19 (metoda koloidního zlata)

Klasifikace: Samotestování

Způsob posouzení shody: Příloha III, oddíl 6, SDZP 98/79/ES

Tímto prohlašujeme, že výše uvedené výrobky splňují ustanovení směrnice Rady 98/79/ES pro zdravotnické prostředky. Veškerá podpůrná dokumentace je uchovávána v prostorách výrobce.

### Použité normy:

EN ISO14971:2019	EN ISO 15223-1:2016	EN ISO 23640:2015
EN ISO18113-1:2011	EN ISO 18113-4: 2011	EN 13612:2002
EN 13641:2002	ISO 20916:2019	EN ISO 13485:2016
EN 62366-1:2015+A1:2020	EN 13975:2003	EN ISO 17511:2003
EN 13532:2002		

Notifikovaná osoba: Polské středisko pro zkoušky a certifikaci (NO. č.: 1434)  
469 ul. Putawska, 02-644 Varšava

Certifikát ES č.: 1434-JVDD-459/2021

Platnost: 2021.09.22 - 2024.05.27

Místo vystavení: Hangzhou, Zhejiang, Čína

Podpis:

Jméno: Sun Weikang

Funkce: Generální ředitel

### PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Lenka Petrášová, IČ: 73009911, soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. Spr 1341/2002, zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem: 13.449/2021

### TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Lenka Petrášová, ID No.: 73009911, a sworn translator of the Czech and English languages, appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava of 28 February 2002, File No. Spr 1341/2002, registered in the List of Interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby confirm that I have personally translated the attached document and that this translation is a literal translation of the text of the relevant document. No consultant has been hired for the translation.

This act is registered in the Register of Acts under the Reg. No.: 13.449/2021


v PRAZE, dne / In PRAQUE, on 2.12.2021



(Ošisk razítka)  
(Stamp imprint)



Lenka Petrášová

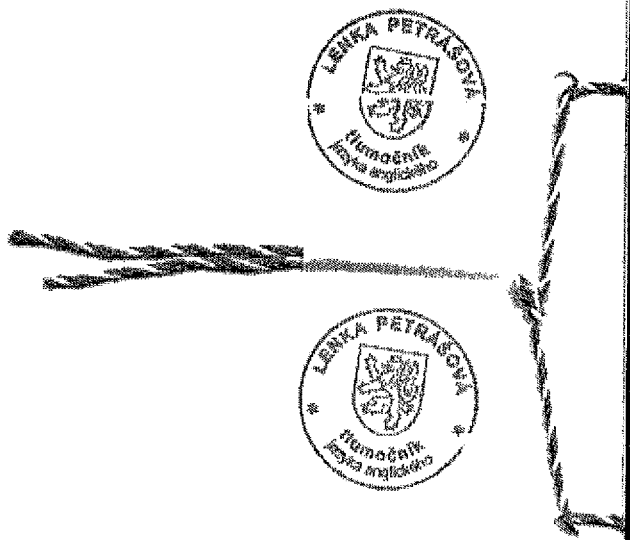

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod  
pořadovým číslem 104112\_007218, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA HLINKOVÁ**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Praha 411

Česká pošta, s.p. dne 02.12.2021



143853834-19594-211202162913

# Příloha č. 3 - Návod k použití



**POUŽITÍ**  
Testovací sada COVID-19 slouží k rychlému zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti SARS-CoV-2 v nosní sliznici. Testovací sada COVID-19 slouží k rychlému zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti SARS-CoV-2 v nosní sliznici. Testovací sada COVID-19 slouží k rychlému zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti SARS-CoV-2 v nosní sliznici.


**PRŮBĚH TESTU**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.

**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.

**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, que jste negativní na COVID-19.

**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.

**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.



**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.



**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.

**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.

**POUŽITÍ**  
1. Před použitím testovací sady COVID-19 se ujistěte, že jste si důkladně umyli ruce mýdlem a vodou. 2. Vyberte si nosní sliznici, kterou chcete testovat. 3. Vložte testovací sáček do nosní sliznice. 4. Vyčkejte 15 minut. 5. Vyjměte testovací sáček z nosní sliznice. 6. Zkontrolujte výsledek testu. 7. Pokud je výsledek pozitivní, znamená to, že jste pozitivní na COVID-19. 8. Pokud je výsledek negativní, znamená to, že jste negativní na COVID-19.

**CHARAKTERISTIKY**

**Charakteristika účinnosti**  
 Účinnost při léčbě byla stanovena metodou krátkých cyklových testů (RPT) na SARS-CoV-2 ve vzájemně nezávislých laboratorních podmínkách. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 vzhledem k výsledkům PCR testů po 7 dnech léčby, počítáno ze srovnání 350 negativních vzorků a 149 pozitivních vzorků. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 ve skupině léčby.

Množství	Výsledky PCR		Celkem
	Pozitivní	Negativní	
Isotvorina (n=149)	Pozitivní	146	147
	Negativní	3	349
Celkem	149	350	499
Účinnost	97,99%	92% spolehlivost	94,25% - 99,51%
Účinnost	97,71%	95% spolehlivost	98,40% - 99,92%
Pravost	97,20%	95% spolehlivost	97,96% - 99,67%

**Účinnost účinnosti (IC50)**  
 Studie IC50 určuje množství léčiva potřebné k inhibici 50% všech kladných vzorků. Účinnost byla stanovena metodou krátkých cyklových testů (RPT) na SARS-CoV-2 ve vzájemně nezávislých laboratorních podmínkách. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 vzhledem k výsledkům PCR testů po 7 dnech léčby, počítáno ze srovnání 350 negativních vzorků a 149 pozitivních vzorků. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 ve skupině léčby.

Konzentrace	Konzentrace	Konzentrace
9,75 x 10 <sup>-5</sup> /ml	2000	100%

**2. Hlavní účinky při vysoké koncentraci (maximální účinnost)**  
 Účinnost byla stanovena metodou krátkých cyklových testů (RPT) na SARS-CoV-2 ve vzájemně nezávislých laboratorních podmínkách. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 vzhledem k výsledkům PCR testů po 7 dnech léčby, počítáno ze srovnání 350 negativních vzorků a 149 pozitivních vzorků. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 ve skupině léčby.

Patogen	Konzentrace	Infuzora A H1N1 virus	1,85 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus 229E	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Infuzora B Parainfluenza	1,3 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus OC-43	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Infuzora Vektory	2,6 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus HKU1	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Haemophilus influenzae	3,8 x 10 <sup>7</sup> CFU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus NL63	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Rhinovirus (typ 3)	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Adenovirus (typ 5)	1,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Rhinovirus (typ 14)	3,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Adenovirus (typ 7)	3,2 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Rhinovirus (typ 216)	5,5 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Adenovirus (typ 18)	3,6 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Respiratorní syncytial virus (typ A-2)	2,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Human metapneumovirus (hMPV)	1,5 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Streptococcus pneumoniae	2,3 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Parainfluenza virus (typ 4)	1,8 x 10 <sup>7</sup> CFU <sub>50</sub> /ml	Streptococcus thermophilus	3,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Infuzora A H1N1 virus	2,1 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Mycoplasma pneumoniae	4,5 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Infuzora A H2N2 virus	1,8 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Chlamydia pneumoniae	6,3 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml

**4. Další účinky**  
 Účinnost byla stanovena metodou krátkých cyklových testů (RPT) na SARS-CoV-2 ve vzájemně nezávislých laboratorních podmínkách. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 vzhledem k výsledkům PCR testů po 7 dnech léčby, počítáno ze srovnání 350 negativních vzorků a 149 pozitivních vzorků. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 ve skupině léčby.

Substance	Konzentrace	Isopropin	250 µg/ml
Amogeston	2 mg/ml	Moxifloxacin Hydrochloride	200 µg/ml
Mucin	2 mg/ml	Cephalexin	3 µg/ml
WAGF	5 mg/ml	Kanamycin	3 µg/ml
Biotin	10 mg/ml	Tetracycline	3 µg/ml
Metaxon	500 µg/ml	Cloxacillin	3 µg/ml
Glucosamin	3 µg/ml	Erythromycin	3 µg/ml
Solifenacemol	120 µg/ml	Vancomycin	3 µg/ml
Dicyclanil Hydrochloride	0,9 µg/ml	Hydrocortisone	3 µg/ml
Pseudoephedrine Hydrochloride	200 µg/ml	Hydrocortisone	3 µg/ml
B-Acetyl Paracetamol	200 µg/ml	Human Insulin	3 µg/ml
Aspirin	30 µg/ml	Beta-propiolactone	30 µg/ml

**3. Množství účinnosti**  
 Účinnost byla stanovena metodou krátkých cyklových testů (RPT) na SARS-CoV-2 ve vzájemně nezávislých laboratorních podmínkách. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 vzhledem k výsledkům PCR testů po 7 dnech léčby, počítáno ze srovnání 350 negativních vzorků a 149 pozitivních vzorků. Účinnost byla stanovena jako podíl pacientů, kteří byli vyléčeni z onemocnění COVID-19 ve skupině léčby.

Patogen	Konzentrace	Infuzora A H1N1 virus	1,85 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus 229E	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Infuzora B Parainfluenza	1,3 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus OC-43	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Infuzora Vektory	2,6 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus HKU1	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Haemophilus influenzae	3,8 x 10 <sup>7</sup> CFU <sub>50</sub> /ml
Human Coronavirus NL63	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Rhinovirus (typ 3)	1 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Adenovirus (typ 5)	1,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Rhinovirus (typ 14)	3,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Adenovirus (typ 7)	3,2 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Rhinovirus (typ 216)	5,5 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Adenovirus (typ 18)	3,6 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Respiratorní syncytial virus (typ A-2)	2,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Human metapneumovirus (hMPV)	1,5 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml	Streptococcus pneumoniae	2,3 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Parainfluenza virus (typ 4)	1,8 x 10 <sup>7</sup> CFU <sub>50</sub> /ml	Streptococcus thermophilus	3,8 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Infuzora A H1N1 virus	2,1 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Mycoplasma pneumoniae	4,5 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml
Infuzora A H2N2 virus	1,8 x 10 <sup>7</sup> FCU <sub>50</sub> /ml	Chlamydia pneumoniae	6,3 x 10 <sup>7</sup> PFU/ml

**REFERENCE**  
 1. Wang Y, Li H, Hu B, et al. Clinical characteristics and genomic characteristics of SARS-CoV-2. *Chin Med J (Engl)* 2020; 93(12):1661-1666.  
 2. Wu Y, Peng Y, Huang Y, et al. Clinical characteristics and genomic characteristics of SARS-CoV-2. *Chin Med J (Engl)* 2020; 93(12):1661-1666.  
 3. Wu Y, Peng Y, Huang Y, et al. Clinical characteristics and genomic characteristics of SARS-CoV-2. *Chin Med J (Engl)* 2020; 93(12):1661-1666.

IC50	Účinnost účinnosti	IC50	Účinnost účinnosti	IC50	Účinnost účinnosti
9,75 x 10 <sup>-5</sup> /ml	2000	100%	9,75 x 10 <sup>-5</sup> /ml	2000	100%

Pharmacia Singapore Medical Products Co., Ltd.  
 No. 128/12, 12th Street, Singapore Science and Technological Development Zone, Singapore, China, P.O. Box 100000  
 SINGAPORE 100000  
 Add: Chongqing, No. 24, 10th Street, Chongqing, China



# CERTIFICATE

**EC Certificate No. 1434-IVDD-459/2021**

**EC Design-examination  
Directive 98/79/EC concerning  
in vitro diagnostic medical devices**

Polish Centre for Testing and Certification certifies  
that manufactured by:

**Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.  
No.125 (E), 10th Street, Hangzhou Qiantang New Area,  
Zhejiang, China 310018**

*in vitro diagnostic medical devices  
for self-testing*

**COVID - 19 Test Kit (Colloidal Gold Method)**

*In terms of design documentation, comply with requirements  
of Annex III (Section 6) to Directive 98/79/EC (as amended)  
implemented into Polish law,  
as evidenced by the audit conducted by the PCBC*

Validity of the Certificate: from 22.09.2021 to 27.05.2024

The date of Issue of the Certificate: 22.09.2021

The date of the first issue of the Certificate: 22.09.2021

**CE** 1434

Issued under the Contract No. MS-50/2021  
Application No: 121/2021  
Certificate bears the qualified signature.  
Warsaw, 22/09/2021  
Model A1  
FBM-30-E\_10

Anna  
Malgorzata  
Wyroba  
Vice-President



**Certifikát ES č. 1434-IVDD-459/2021**  
**Směrnice ES o přezkoumání návrhu 98/79/ES týkající se**  
**diagnostických zdravotnických prostředků *in vitro***

Polské středisko pro zkoušky a certifikaci osvědčuje, že výrobek společnosti:

**Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.**  
**No.125 (E), 10th Street, Hangzhou Qiantang New**  
**Area, Zhejiang, Čína 310018**

diagnostické zdravotnické prostředky *in vitro* pro sebetestování

**Testovací souprava COVID - 19 (metoda koloidního zlata)**

Všechna technická dokumentace návrhu splňuje požadavky Přílohy III (oddílů 6) Směrnice 98/79/ES (ve znění  
pozdějších předpisů) transponované do polského práva,  
jak bylo prokázáno auditem provedeným PCBC.

Platnost certifikátu: od 22.09.2021 do 27.05.2024

Datum vystavení certifikátu: 22.09.2021

Datum prvního vystavení certifikátu: 22.09.2021



Vydáno na základě smlouvy č. MO-50/2021  
Číslo žádosti: 121/2021  
Certifikát je opatřen kvalifikačním podpisem.  
Varšava, 22.09.2021  
Modul A1  
PDM-30-C\_10

POLSKÉ STŘEDISKO PRO ZKOUŠKY A CERTIFIKACI 02-544 Varšava, 469 Paliwska ul., tel. +48 22 46 45 200, e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

### PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Lenka Petrášová, IČ: 73009911, soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. Spr 1341/2002, zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod evidenčním číslem: 13.442/2021.....

### TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Lenka Petrášová, ID No.: 73009911, a sworn translator of the Czech and English languages, appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava of 28 February 2002, File No. Spr 1341/2002, registered in the List of Interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby confirm that I have personally translated the attached document and that this translation is a literal translation of the text of the relevant document. No consultant has been hired for the translation.

This act is registered in the Register of Acts under the Reg. No.: 13.442/2021.....


v PRAZE..... dne / in PRAQUE....., on 2.12.2021.....



(Otisk razítka)  
(Stamp Imprint)



Lenka Petrášová

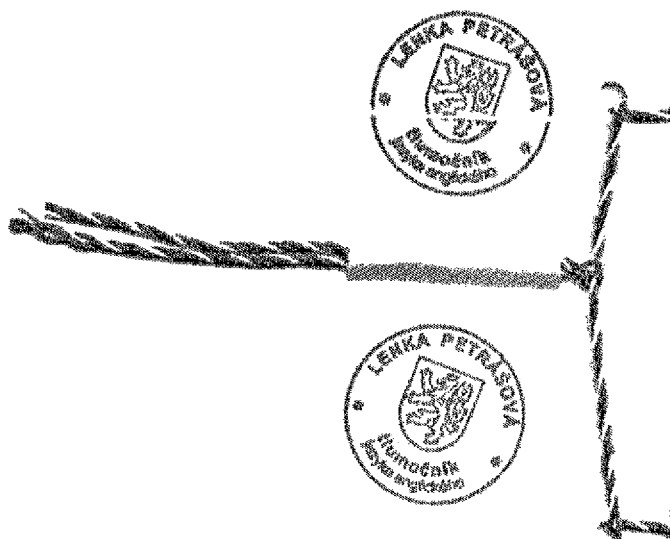

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 104112\_007217, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA HLINKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 411**

Česká pošta, s.p. úče 02.12.2021



143853735-19594-211202162522

**Příloha č. 5 - Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dovozce/distributora  
diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v registru zdravotnických prostředků**



<b>STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV</b>	Šrobárova 48 100 41 Praha 10	Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377	E-mail: <a href="mailto:posta@sukl.cz">posta@sukl.cz</a> Web: <a href="http://www.sukl.cz">www.sukl.cz</a>
--	---------------------------------	--	---

<b>ADRESÁT</b> MASANTA s.r.o. Mgr. Martin Ladyr	<b>ADRESA</b> Doňocholupická 915/65 Praha-Modřany 143 00
---	---

<b>Číslo jednací</b>	<b>Spisová značka</b>	<b>Vyřizuje / e-mail</b>	<b>Datum</b>
sukl101371/2020	sukls98026/2020	Zuzana Kunáčková <a href="mailto:zuzana.kunackova@sukl.cz">zuzana.kunackova@sukl.cz</a>	22. 4. 2020

**POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI**

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto splnění ohlašovací povinnosti níže uvedené osoby.

Registrační číslo	061436
IČ	25730533
Název	MASANTA s.r.o.
Sídlo	Doňocholupická 915/65, 143 00 Praha, Česká republika
Kontaktní osoba	Mgr. Martin Ladyr, <a href="mailto:m.ladyr@masanta.com">m.ladyr@masanta.com</a> , +420603474294

**Seznam činností**

- dovozce obecných zdravotnických prostředků
- dovozce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
- distributor obecných zdravotnických prostředků
- distributor diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

Platnost registrace osoby pro výše uvedené činnosti činí pět let ode dne vydání tohoto potvrzení.

Ing. Petr Vykypět  
vedoucí Oddělení registrací a notifikací  
Odbor zdravotnických prostředků  
Státní ústav pro kontrolu léčiv

## Příloha č. 6 - Rozhodnutí o registraci testu v registru zdravotnických prostředků



<b>STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV</b>	Šrobárova 48 100 41 Praha 10	Telefon: +420 272 385 111 Fax: +420 271 732 377	E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz
<b>ADRESÁT</b> MASANTA s.r.o. Mgr. Martin Ledyr		<b>ADRESA</b> Dolnochoťupická 915/65 Praha-Medřany 143 00	
Číslo jednací	Spisová značka	Vyřizuje / e-mail	Datum
sukl320524/2021	sukls310816/2021	Ing. Karolína Bryčová karolina.brycova@sukl.cz	30. 11. 2021

### ROZHODNUTÍ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“), nebo na základě § 9 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) s ohledem na ustanovení § 74 odst. 5 zákona č. 89/2012 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), rozhodl ve správním řízení, sp. zn. sukls310816/2021, v souladu s příslušným zákonem a s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

takto:

Ústav tímto v souladu s § 35 odst. 1 zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, nebo v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., ve spojení s § 74 odst. 5 zákona o zdravotnických prostředcích, vyhovuje žádosti osoby registrační číslo 061436, MASANTA s.r.o., se sídlem Dolnochoťupická 915, 14300 Praha, IČ: 25730533, o notifikaci zdravotnického prostředku.

Evidenční číslo	Název zdravotnického prostředku	Registrační číslo výrobce	Výrobce
01028558	Singclean® COVID-19 testovací sada (metoda koloidního zlata)		Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.

Platnost notifikace výše uvedených zdravotnických prostředků činí pět let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

#### Odůvodnění

Podle § 68 odst. 4 správního řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s § 35 odst. 1 zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, nebo v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., ve spojení s § 74 odst. 5 zákona o zdravotnických prostředcích nelze odvolat.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Petr Vykypěl  
vedoucí Oddělení registrací a notifikací  
Odbor zdravotnických prostředků