








Odběratel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav 	Odd.: Oddělení laboratorní mikrobiologie Středisko: 0330.0401 Vyřizuje: 	Poř. č. objednávky: 7-2022-21-30
ŽÁDANKA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY OBJEDNÁVKA		
Dodavatel: DiaSorin s.r.o., K Hájkům 2606/2b, 155 00 Praha 5 		
Na fakturu uveďte konečného příjemce: Oddělení laboratorní mikrobiologie, 		

	<i>Množství (balení, kusy)</i>
MOL4150 Simplexa COVID-19 Direct Kit	
MOL1455 3DAD discs	

Předpokládaná cena bez DPH:

489 600,- Kč



Dodací adresa

NEMOCNICE BŘECLAV, LAB. MIKROBIOLOG
PAVILON C - 1.PATRO
U NEMOCNICE 3066/1
690 74 BŘECLAV

Odběratel

NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.
U NEMOCNICE 3066/1
690 74 BŘECLAV

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník CZ00139000
Dodací adresa CZ00139001
Objednávka. 2000028758
Datum 22/02/2022


Číslo objednávky
7-2022-21-30
Datum Objednávky
22/02/2022

Podmínky doručení

Free on departure

Způsob doručení

Číslo produktu	Sériové číslo/Šarže	Popis	Objednané množství	Cena MJ	Cena celkem
MOL4150		Simplexa COVID-19 Direct			489.600,00
ominuta na základě rozhodnutí MF ze dne 16.12.2020 ve Finančním daji 35/2020.					
MOL1455		DIRECT AMPLIFICATION DISC KIT			



From: [Redacted]
Sent: Wednesday, February 23, 2022 8:48 AM
To: [Redacted]
Cc: [Redacted]
Subject: FW: SO 2000028758 FW: Message from KM_C308

Dobrý den,


Vaši objednávku č. 7-2022-21-30 ze dne 22.02.2022 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 489.600,00 Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: 22.02.2022. Předpokládaný termín dodání je tento nebo příští týden.

S pozdravem,



Customer Service Representative
Diasorin Order Entry Center

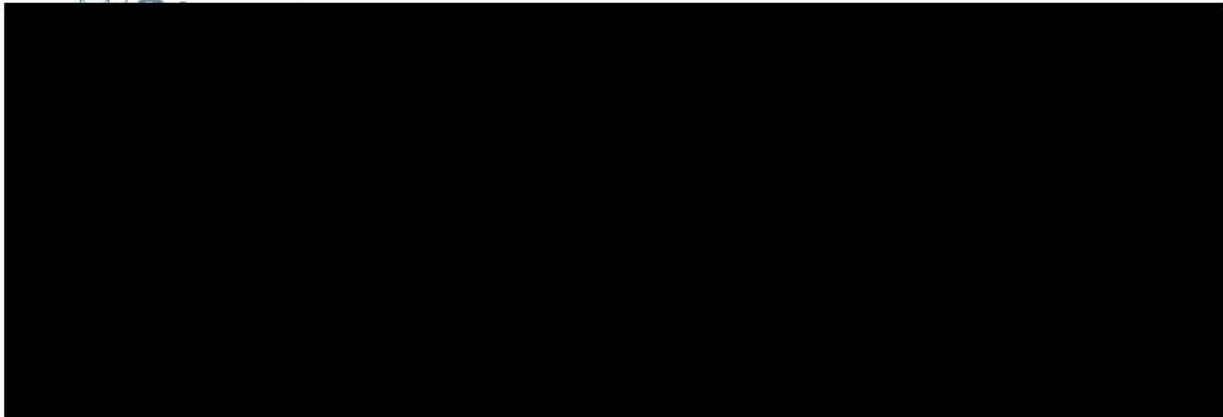

From: [Redacted]
Sent: Tuesday, February 22, 2022 2:21 PM
To: [Redacted]
Subject: SO 2000028758 FW: Message from KM_C308

Dobrý den,
Posílám objednávku a prosím o její potvrzení

Děkuji S pozdravem



2.3.2022

