

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „Kupující“

a

IMEDEX s.r.o.

se sídlem: Kladská 1092/1a, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27510204

DIČ: CZ27510204

zastoupená: Mgr. Richardem Uhlířem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23219

bankovní spojení: 117057983/0300, ČSOB, a.s.

na straně druhé jako „Prodávající“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Katetry PHmetrické impedanční k přístroji Digitrapper**“, interní evidenční číslo **VZ-2022-000356**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž se závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího průběžně dodávat, na základě dílčích písemných objednávek spotřební materiál - katetry PHmetrické impedanční k přístroji Digitrapper - uvedený v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět plnění**“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Množství předmětu plnění, uvedené v zadávací dokumentaci je orientační. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích objednávek dle svých aktuálních potřeb, bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího. Proávající není oprávněn stanovit minimální množství a finanční limit jednotlivých dílčích objednávek.
3. Jednotlivé objednávky budou činěny písemně, elektronicky či faxem. Dnem doručení se v pochybnosti rozumí 3. den po prokazatelném odeslání/učinění objednávky ze strany Kupujícího.
4. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní dokumentace: dodací list s uvedením názvu, kódu výrobku, množství jednotlivých druhů zboží v rozdělení dle výrobních čísel, resp. šarží, počtu ks v balení, cena za kus bez DPH a s DPH, popř. cena za balení.

III.

Doba a místo plnění

1. Proávající je povinen jednotlivé dílčí dodávky realizovat do 5 dnů ode dne vystavení dílčí písemné, elektronické či faxové objednávky objednatelem s doložením dodacího listu; u mimořádných objednávek do 2 pracovních dnů od okamžiku objednání.
2. Proávající je povinen předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2022-000356**. Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně 12 měsíců.
3. Místem dodání předmětu plnění je Fakultní nemocnice Olomouc, Sklad zdravotnických prostředků.
4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Proávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2022-000356**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci dle článku V. této smlouvy.

6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nespĺňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny nedodaného předmětu plnění za každý den prodlení.

IV.

Kupní cena

1. Kupní cena zboží je cenou smluvní a je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.

2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.).

3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a Prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturu vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.

2. Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu kupujícího nebo elektronicky na email fin@fnol.cz a nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.

3. Prodávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2022-000356**. Prodávající je dále povinen vystavovat samostatné faktury s tímto označením pouze na předmět plnění z tohoto smluvního vztahu, tzn. samostatné faktury na zboží dodané na podkladě této smlouvy. Uvede-li na faktuře jiné zboží, nebude taková faktura kupujícím akceptována a nestane se splatnou, když prodávajícímu vznikne povinnost fakturaci upravit v souladu s tímto ustanovením.

4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.

5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na jiný účet uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

VI.

Nebezpečí škody na zboží, vlastnické právo a reklamace

1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k dodanému zboží včetně obalu přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí.

2. V případě reklamace zboží z důvodu pochybnosti o kvalitě dodávky bude zboží obratem, nejpozději do 48 hodin vyměněno za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení. V případě prodloužení prodávajícího s dodávkou vyměněného zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny nedodaného předmětu plnění za každý i započatý den prodloužení.

3. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese servis@imedex.cz, faxem na faxovém čísle +420495260285 či telefonicky na telefonním čísle +420770179987. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.

VII.

Platnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od podpisu smlouvy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodloužení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodloužení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.

2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

5. Tuto smlouvu může kupující kdykoli vypovědět, a to ve dvouměsíční výpovědní době. Výpověď počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícím.

IX.


Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.
5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.
8. Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Příloha krycího listu nabídkové ceny
Příloha č. 2 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek

19 -05- 2022

V Olomouci dne.....

V Hradci Králové dne 12.05.2022

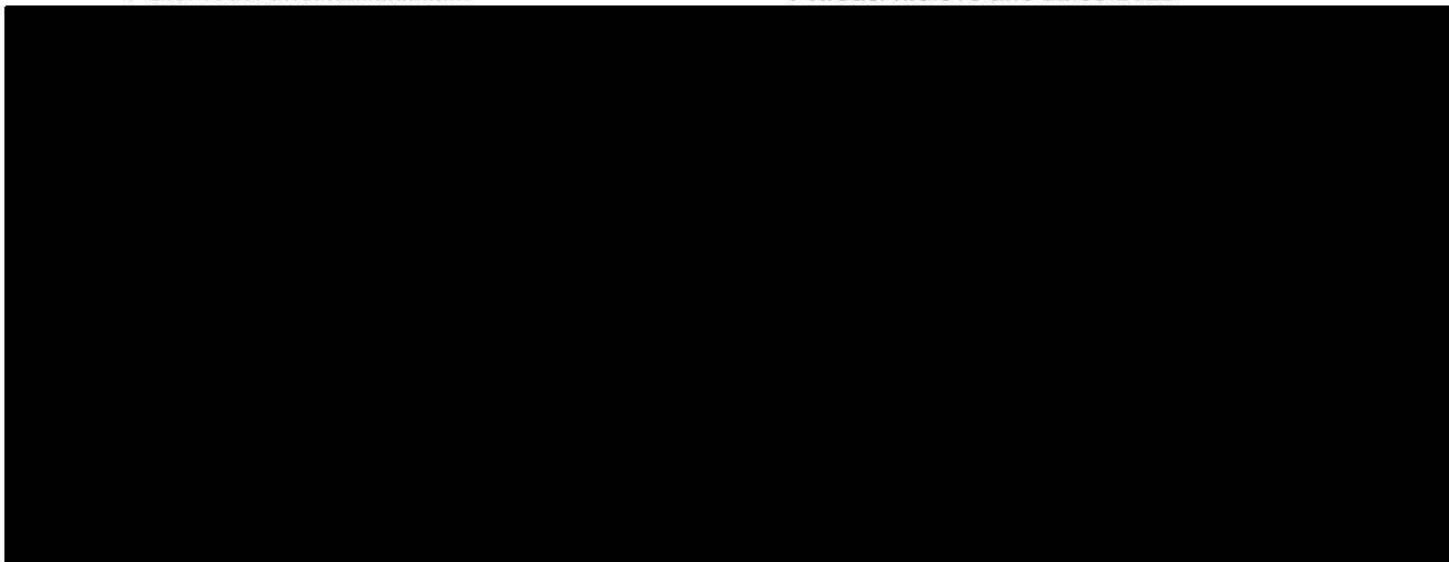


Cenové ujednání

VZ-2022-000356 - Katetry PHmetrické impedanční k přístroji Digitrapper



název	měrná jednotka (MJ)	obchodní název	katalogové číslo	počet MJ v balení	výrobce	třída míry rizika	UDI kód	kód VZP	úhradová cena VZP max.	sazba DPH v 21 %, výše DPH v Kč	cena za MJ v Kč bez DPH	cena za MJ v Kč s DPH
Katetr PHmetrický impedanční VERSAFLEX ZNIS+8R (pH-impedance catheter, single pH channel at 0 cm, 8 impedance rings at -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 and 13 cm, 6.0 Fr), jednorázový	ks	VersaFlex ZNIS+8R	955907	10	Given Imaging	Ila		151010	3 780,90	21%, 655,20	3 120,00	3 775,20
Katetr PHmetrický impedanční VERSAFLEX LPR ZNID19+8R (LPR pH-impedance catheter, dual pH channel at 0 (distal) and 19 cm (proximal), 8 impedance rings at -3, -1, 1, 10, 12, 14, 17 and 20 cm from distal pH channel, 6.0 Fr), jednorázový	ks	VersaFlex LPR ZNID19+8	FGS-9000-18	10	Given Imaging	Ila		153117	3 616,33	21%, 626,85	2 985,00	3 611,85
Katetr PHmetrický impedanční VERSAFLEX LPR ZNID22+8R (LPR pH-impedance catheter, dual pH channel at 0 (distal) and 22 cm (proximal), 8 impedance rings at -3, -1, 1, 13, 15, 17, 20 and 23 cm from distal pH channel, 6.0 Fr), jednorázový	ks	VersaFlex LPR ZNID22+8R	FGS-9000-19	10	Given Imaging	Ila		153117	3 616,33	21%, 626,85	2 985,00	3 611,85


pozn.: v případě, že některý z produktů neuvádí, nebo postrádá požadované údaje, doplňte do kolonky " NEUVEDENO "



Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR "Katetry PHmetrické impedanční k přístroji Digitrapper"


VZ-2022-000356

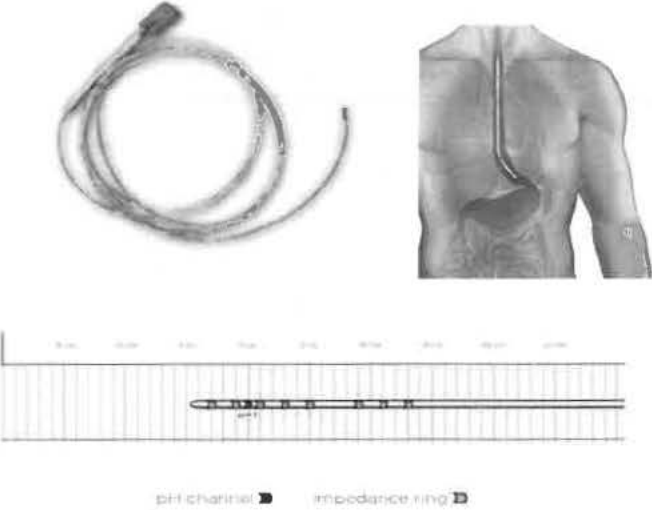Specifikace	ANO/NE	Poznámky/skutečné parametry	
PHmetrické impedanční katetry jsou kompatibilní s přístrojem Digitrapper (výr. Given Imaging)			
Katetr PHmetrický impedanční VERSAFLEX ZNIS+8R (pH-impedance catheter, single pH channel at 0 cm, 8 impedance rings at -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 and 13 cm, 6.0 Fr), jednorázový			
 <p style="text-align: center;">katalog. číslo IMEDEX (výr. Given Imaging) 955907</p>	Katetr jednorázový určený k měření pHmetrie s měřením intralumenového odporu jícnu, který je vyvolán přítomností refluxátu v jícnu. Kombinací těchto hodnot je umožněno zjištění počtu, trvání a výšky všech refluxních epizod, které jsou vztaženy k symptomu udávaným pacientem.		
	pH:		
	• Počet kanálů pH: 1	ANO	
	• Rozsah vzorkování: 1 vzorek/sekundu až 1 vzorek/10 sekund	ANO	1 vzorek/sekundu až 1 vzorek/10 sekund
	• Měřicí rozsah pH: 1 až 10	ANO	rozsah pH 1 až 10
	• Přesnost měření: 0,1 pH	ANO	
	• Typ katétru: Antimony	ANO	
	Impedance:		
	• Počet kanálů impedance: 6	ANO	
	• Měřicí rozsah: 100 Ω až 10 kΩ	ANO	100 Ω až 10 kΩ
	• Přesnost měření: Lepší než ± 5% nad 200Ω	ANO	Lepší než ± 5% nad 200Ω
	• Frekvence měření: Mezi 1 kHz a 2 kHz	ANO	Mezi 1 kHz a 2 kHz
	• Měřicí proud: Obvykle 6μ Arms	ANO	
	• Rychlost vzorkování: 64 Hz	ANO	
	Další vlastnosti:		
	• Vnitřní reference	ANO	
• Linearita pH od 2 do 8	ANO		
• Stabilita pH po dobu 24 hodin	ANO		
• Impedanční kroužky	ANO		
• Průměr katétru 6,0 Fr	ANO		
• 10pinový konektor RJ-45	ANO		
• Bez obsahu latexu	ANO		
• pH kanál na 0cm, 8 impedančních kroužků na -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 a 13 cm	ANO		
• kód UDI (pokud je přidělen)	-		
Katetr PHmetrický impedanční VERSAFLEX LPR ZNID19+8R (LPR pH-impedance catheter, dual pH channel at 0 (distal) and 19 cm (proximal), 8 impedance rings at -3, -1, 1, 10, 12, 14, 17 and 20 cm from distal pH channel, 6.0 Fr), jednorázový			
	Katetr jednorázový určený k měření 2 kanálové pHmetrie s měřením intralumenového odporu jícnu, který je vyvolán přítomností refluxátu v jícnu. Kombinací těchto hodnot je umožněno zjištění počtu, trvání a výšky všech refluxních epizod, které jsou vztaženy k symptomu udávaným pacientem.		
	pH:		
	• Počet kanálů pH: 2	ANO	
	• Rozsah vzorkování: 1 vzorek/sekundu až 1 vzorek/10 sekund	ANO	1 vzorek/sekundu až 1 vzorek/10 sekund
	• Měřicí rozsah pH: 1 až 10	ANO	rozsah pH 1 až 10
	• Přesnost měření: 0,1 pH	ANO	
	• Typ katétru: Antimony	ANO	
	Impedance:		
	• Počet kanálů impedance: 6	ANO	
	• Měřicí rozsah: 100 Ω až 10 kΩ	ANO	100 Ω až 10 kΩ
	• Přesnost měření: Lepší než ± 5% nad 200Ω	ANO	Lepší než ± 5% nad 200Ω
	• Frekvence měření: Mezi 1 kHz a 2 kHz	ANO	Mezi 1 kHz a 2 kHz
	• Měřicí proud: Obvykle 6μ Arms	ANO	

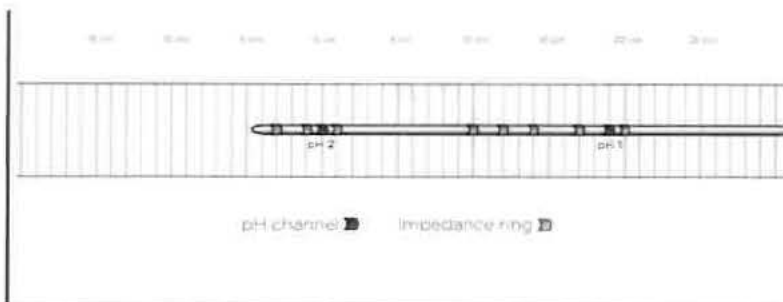

katalog. číslo IMEDEX (výr. Given Imaging) FGS-9000-18

Katetr PHmetrický Impedanční VERSAFLEX LPR ZNID22+8R (LPR pH-Impedance catheter, dual pH channel at 0 (distal) and 22 cm (proximal), 8 impedance rings at -3, -1, 1, 13, 15, 17, 20 and 23 cm from distal pH channel, 6.0 Fr), jednorázový

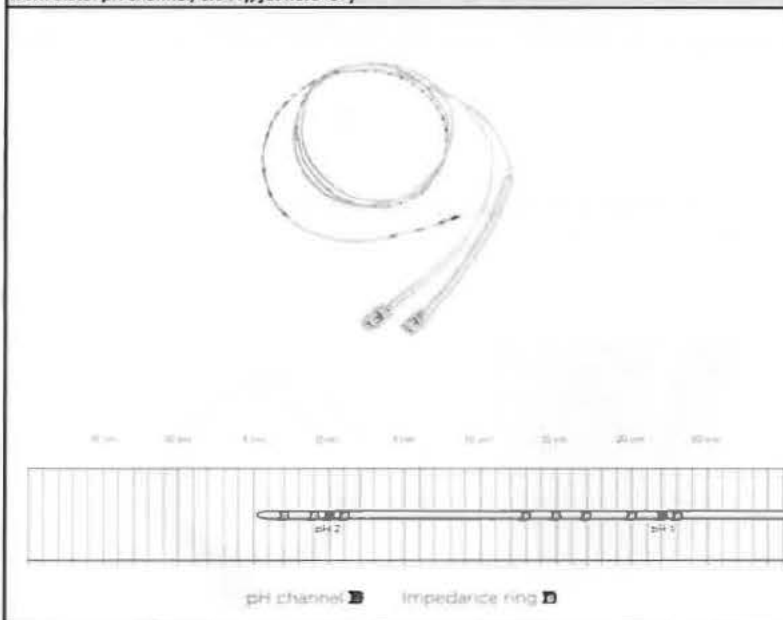

katalog. číslo IMEDEX (výr. Given Imaging) FGS-9000-19

• Rychlost vzorkování: 64 Hz	ANO	
Další vlastnosti:		
• Vnitřní reference	ANO	
• Linearita pH od 2 do 8	ANO	
• Stabilita pH po dobu 24 hodin	ANO	
• Impedanční kroužky	ANO	
• Průměr katétru 6,0 Fr	ANO	
• 10pinový konektor RJ-45	ANO	
• Bez obsahu latexu	ANO	
• dva pH kanály na 0 cm (distální) a na 19 cm (proximální), 8 impedančních kroužků na -3, -1, 1, 10, 12, 14, 17 a 20 cm od distálního pH kanálu	ANO	
• kod UDI (pokud je přidělen)	-	
Katetr jednorázový určený k měření 2 kanálové pHmetrie s měřením intralumenového odporu jícnu, který je vyvolán přítomností refluxátu v jícnu. Kombinací těchto hodnot je umožněno zjištění počtu, trvání a výšky všech refluxních epizod, které jsou vztaženy k symptomu udávaným pacientem.		
pH:		
• Počet kanálů pH: 2	ANO	
• Rozsah vzorkování: 1 vzorek/sekundu až 1 vzorek/10 sekund	ANO	1 vzorek/sekundu až 1 vzorek/10 sekund
• Měřicí rozsah pH: 1 až 10	ANO	rozsah pH 1 až 10
• Přesnost měření: 0,1 pH	ANO	
• Typ katétru: Antimony	ANO	
Impedance:		
• Počet kanálů impedance: 6	ANO	
• Měřicí rozsah: 100 Ω až 10 kΩ	ANO	100 Ω až 10 kΩ
• Přesnost měření: Lepší než ± 5% nad 200Ω	ANO	Lepší než ± 5% nad 200Ω
• Frekvence měření: Mezi 1 kHz a 2 kHz	ANO	Mezi 1 kHz a 2 kHz
• Měřicí proud: Obvykle 6μ Arms	ANO	
• Rychlost vzorkování: 64 Hz	ANO	
Další vlastnosti:		
• Vnitřní reference	ANO	
• Linearita pH od 2 do 8	ANO	
• Stabilita pH po dobu 24 hodin	ANO	
• Impedanční kroužky	ANO	
• Průměr katétru 6,0 Fr	ANO	
• 10pinový konektor RJ-45	ANO	
• Bez obsahu latexu	ANO	
• dva pH kanály na 0 cm (distální) a na 22 cm (proximální), 8 impedančních kroužků na -3, -1, 1, 13, 15, 17, 20 a 23 cm od distálního pH kanálu	ANO	
• kod UDI (pokud je přidělen)	-	

Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný lékařský účel.

