

OBJEDNÁVKA - Revize (BTK)

Odběratel : Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600
333 01 Stod

IČ : 26361086

DIČ : CZ699005333

Obchodní společnost Stodská nemocnice, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Plzeň, oddíl B, vložka 1072.

Řada dokladu : 990

Číslo dokladu : 220103

Sklad : 123.00107

Telefon

Fax

E-mail

Dodavatel : BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50
602 00 Brno

Datum pořízení : 24.05.2022

Datum dodání : 24.06.2022

IČ : 46346996

DIČ : CZ46346996

řádek č.	Označení	Popis	Výrobní číslo	Oddělení
1	00056	Sterilizátor parní Unisteri 336-1ED	041218	gynekologie sál
2	00057	Sterilizátor parní Unisteri 336-1ED	090150	gynekologie sál
3	00133	Sterilizátor parní Unisteri 336-1ED	041217	chirurgie sál
4	01177	Sterilizátor parní Sterivap 666-1 ED	5201072	CHIR-OS sterilizace
5	01234	Sterilizátor Stericell BMT	B042453	ORL

Dobrý den

Prosím o provedení PBTK na výše uvedené zařízení.

Prosím o předběžnou cenovou nabídku a brzký termín revize


Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a zašlete na

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem



tomas.bryna@stod.nemocniceplk.cz

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:



Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den,







Technik již informován, ozve se ohledně vlastního provedení prohlídek.

Je nutné taky udělat tlakovou zkoušku včetně revize tlakových nádob na přístrojích rok výroby 2004 - 2 x UNISTERI, provádí se 1x za devět let)



Potvrdíte, prosím, objednávku, technik by mohl provést revize a BTK do konce června 2022.

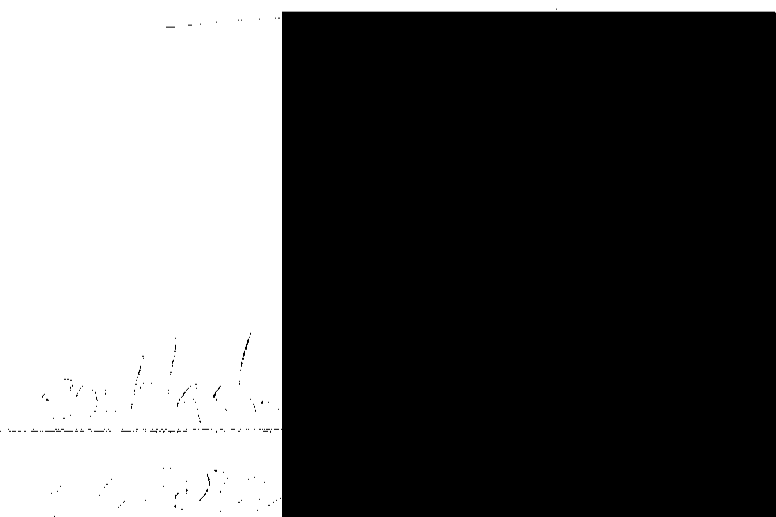



Dobrý den

V příloze objednávka Sterilizátorů Stodské nemocnice.
Prosím o předběžnou cenovou nabídku a termín revize.

Velice děkuji a přeji hezký den.

