



...řešení pro vaši laboratoř

Daňový doklad: Faktura zboží
Číslo dokladu: 12206051
Referent:

Faktura zboží 12206051

Datum vystavení: 29.6.2022
Datum splatnosti: 29.7.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.6.2022

Dodavatel:
TRIGON PLUS s.r.o.

Odběratel:
**Ústav pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv**

Západní 93
251 01 Čestlice

Hudcova 232/56a
621 00 Brno - Medlánky, Brno-město

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

Sídlo: Hudcova 232/56a, 621 00 Brno - Medlánky, Brno-
město

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: 272680190, fax: 272680914
e-mail: mail@trigonplus.cz
Internet: www.trigonplus.cz

IČ: 00019453


Platební údaje:

Obchodní údaje:

Zakázka: **ZAK-2203-0631**

Fakturuje se za dodání zboží dle kupní smlouvy ze dne 12.5.2022 - laboratorní přístroje pro USKVBL, část 7 veřejné zakázky

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
THERMO Multifuge X1R, chlazená multifunkční centrifuga v konfiguraci:	75004250					
TX-400 slíde coat, výkyvný rotor, 4 x 400 ml	75003181					
kulaté buckety pro rotor TX-400, sada 4 ks	75003655					
adaptor 9 x 15 ml, kónické, sada 4 ks	75003682					
adaptor 5 x 25/30 ml, prům 25,5 x 110 mm, sada 4 ks	75003703					
adaptor 3 x 50 ml prům 35 mm, kulaté dno, sada 4 ks	75003707					
hermetické kryty pro TX-400, sada 4 ks	75003656					
Validace laboratorní chlazené centrifugy, vystavení protokolu, kontrola	S5200132					
Celkem:		8 mj		237 800,00	49 938,00	287 738,00
Sazba	Základ	DPH		Zaokrouhlení:		0,00 Kč
21%	237 800,00	49 938,00		Celkem:		287 738,00 Kč

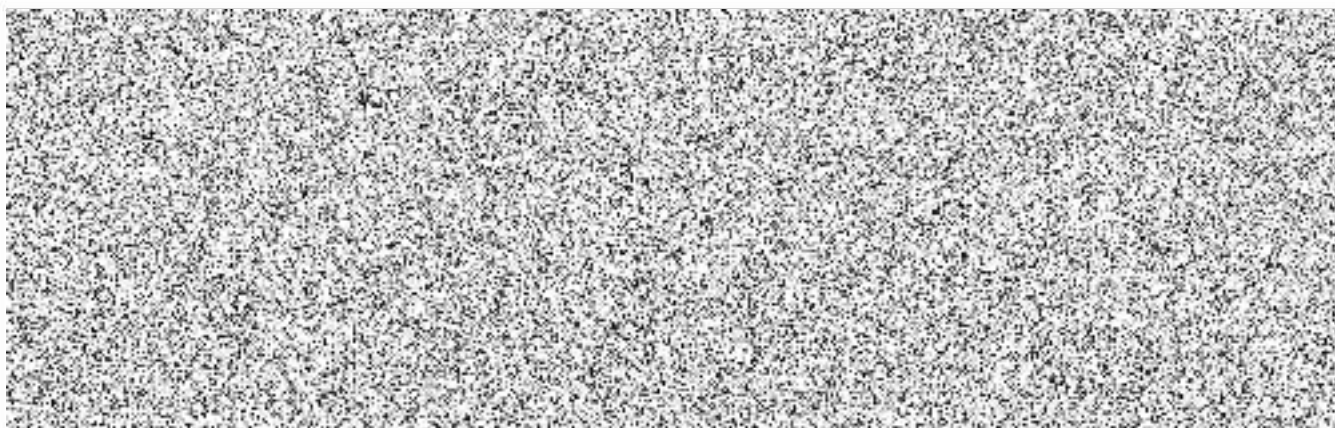

12206051

10.06.2022

K dokladu:

Výdeika SV-2206-0159

Referent:



Datum vystavení:

Doprava:

Objednávky: kupní smlouva

Zakázky: ZAK-2203-0631

Dodavatel

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
Spisová značka v OR Praha: C11127
tel: 272680190, fax: 272680914
e-mail: mail@trigonplus.cz
Internet: www.trigonplus.cz

Odběratel

**Ústav pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv**

Hudcova 232/56a
621 00 Brno - Medlánky, Brno-město

Sídlo: Hudcova 232/56a, 621 00 Brno -
Medlánky, Brno-město

IČ: 00019453

Popis / Série

Číslo

Množství

THERMO Multifuge X1R, chlazená multifunkční centrifuga

Sériové číslo: 42674258

TX-400 slide coat, výkyvný rotor, 4 x 400 ml

kulaté buckety pro rotor TX-400, sada 4 ks

adaptor 9 x 15 ml, kónické, sada 4 ks


adaptor 5 x 25/30 ml, prům 25,5 x 110 mm, sada 4 ks

adaptor 3 x 50 ml prům 35 mm, kulaté dno, sada 4 ks

hermetické kryty pro TX-400, sada 4 ks

Validace laboratorní chlazené centrifugy, vystavení protokolu, kontrola

Celkem:

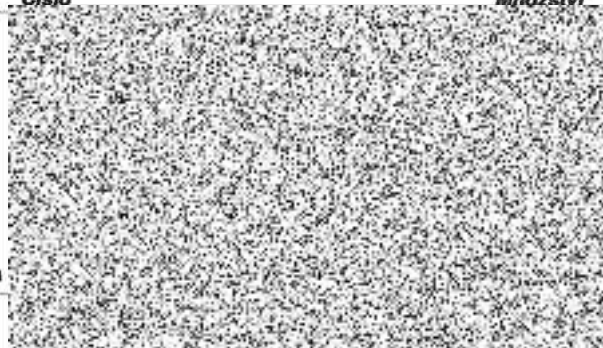

Přístroj byl předveden v chodu a pracuje bez závad. Zástupce uživatele potvrzuje řádné převzetí přístroje do užívání. Upozornění: Prodejce potvrzuje tímto záruku 24 měsíců na přístroj. Záruka začíná dnem podpisu tohoto protokolu. V záruce budou bezplatně opraveny všechny funkční závady vzniklé vadným materiálem a konstrukcí přístroje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou a nedodržením provozních podmínek podle dokumentace. Manuál a prohlášení o shodě bylo dodáno spolu s přístrojem. Zboží se stává majetkem odběratele až po úplném zaplacení kupní ceny zboží. Zaškolení pracovníci: (jméno, podpis, telefon)

