

KUPNÍ SMLOUVA č. 22/2022

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: HZZ, a.s.
se sídlem: CZ, Brno, Košinova 785/24, 612 00
IČ : 25309749
DIČ: CZ25309749
jehož jménem jedná: David Hübel, předseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení / číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2102
(dále označován krátce též jako **prodávající**)

a

kupujícím, jímž je:

obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00
IČ : 268 73 346
DIČ: CZ26873346
jehož jménem jednají: Ing. Ivo Vlach, předseda představenstva
MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] z
bankovní spojení / číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957
(dále označován krátce též jako **kupující**),

pro uživatele: AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04

Článek I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a to: Elektrochirurgický přístroj ALSATOM SU 140/D MPC

Dle cenové nabídky č. E-b - HZZ - Nabídka ALSATOM SU 140-D MPC, ze dne 6.6.2022

Kupující se zavazuje zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Článek II. Kupní cena

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH:	64 458,50 Kč
DPH: 21 %	13 536,30 Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	77 994,80 Kč

- 2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu montáže zboží a záruční servis včetně bezpečnostně technických kontrol během záruční doby. Zaškolení obsluhy je poskytováno zdarma.
- 3) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 4) Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Článek III.

Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy

- 1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
- 2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.

Článek IV.

Místo a termín plnění

- 1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předání zboží kupujícímu na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu a dodacího listu, manuálu v českém

- jazyce, dokladu o CE, dokladu o způsobilosti k provádění servisu a instruktaži a dokladu o způsobilosti uvedeného zařízení k zamýšlené činnosti.
- 2) Místem plnění pro dodání zboží je AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov.
 - 3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

Článek V.

Prohlášení a záruky smluvních stran

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmkoli právními nebo faktickými vadami.
- 2) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 30 měsíců ode dne předání zboží v příslušném místě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti, jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, v takovém případě je záruka rovna životnosti.

Článek VI.

Záruční servis

- 1) Prodávající se zavazuje zajistit a provést záruční servis na základě písemného nahlášení vady uživatelem e-mailem na adresu [REDACTED]
- 2) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního technika na místo plnění k opravě závady do 1 kalendářního dne od nahlášení závady, což se považuje za uplatnění vady. Prodávající se zavazuje, že do 1 kalendářního dne od příjezdu servisního technika na místo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu. Prodávající může závadu odstranit i tím, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.
- 3) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobu trvání záruční lhůty.
- 4) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a to nejméně po dobu 10 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovení podmínek poskytování pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

Článek VII.

Smluvní pokuta

- 1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% (jedna desetina procenta) z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. Smluvní pokuta nebude z důvodu efektivity vymáhána, nedosáhne-li částky minimálně 1000 Kč. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 2) V případě, že prodávající v záruční době nedodrží termíny specifikované v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných závad.

Článek VIII.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:
na straně prodávajícího:
David Hübel, předseda představenstva
tel. [redacted]; email: [redacted]
na straně kupujícího:
[redacted] ředitel Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.,
tel. [redacted] email: [redacted]
na straně uživatele:
[redacted] hlavní správce AGEI. Středomoravská nemocniční a.s.,
tel. [redacted], fax [redacted] email: [redacted]
- 2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Toto uveřejnění zajistí kupující.
- 3) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) **Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha: cenová nabídka č. E-b - HZZ - Nabídka ALSATOM SU 140/D MPC, ze dne 6.6.2022**

V Brně

dne: 30.6.2022

[redacted]

jménem prodávajícího:

David Hübel, předseda představenstva

V Olomouci

dne :

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

12. 07. 2022

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČ: 268 73 346, IČ: CZ26873

jménem kupujícího: ...

[redacted]

Ing. Ivo Vlach
předseda představenstva

[redacted]

MUDr. Ivo Mareš, MBA
místopředseda představenstva



AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Přerov
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc, Hodolany

V Brně, dne 6.6.2022

Nabídka na elektrochirurgický přístroj ALSATOM SU 140/D MPC

na základě tohoto poptávkového řízení Vám předkládám touto cestou cenovou nabídku dodání vysokofrekvenčního elektrochirurgického přístroje **ALSATOM SU 140/D MPC s ručním ovládáním a použitím dvojitého pedálového spínače pro monopolární i bipolární režim (maximální výkon na řezu 160 W)**. Tento přístroj je vhodný pro použití v **chirurgii, laparoskopii, základní endoskopické zákroky pod kapalinou a artroskopii**. Velkou výhodou jsou **nové PULZNÍ REŽIMY**.

Nová typová řada přístrojů **ALSATOM SU MPC** využívá vyspělé technologie se systémem ovládání pomocí **dvou mikroprocesorů**, které garantují jak výkony skutečně vhodné pro aktuální **chirurgické potřeby**, tak vysokou úroveň bezpečnosti pro **obsahu** a především pak pro **pacienta**.

- SEFT-TEST: automatická kontrola přístroje při každém zapnutí, tak i během provozu (4000x/sek.)
- počítačová automatická kontrola a automatické seřizování proudů pomocí PER (Hodnocení účinnosti příkonu > 98 %).
- V případě poruchy, anomálního výkonu nebo nesprávném použití, přístroj přeruší provoz
- Alarmy, chybové kódy
- Automatické nastavení optimálního výkonu podle odporu tkáně
- Nezávislé nastavení výkonu pro všechny režimy

Přístroj má řídicí obvod neutrální elektrody, který uživatelům umožňuje:

- Použití s normálními elektrodami pro dospělé nebo s malými elektrodami pro dětské pacienty
- Použití s jednorázovými neutrálními elektrodami - jednodílnými („Single section - Non Split“) nebo dvoudílnými („Double section - Split“).

PROUDY PRO MONOPOLÁRNÍ ŘEZÁNÍ A KOAGULAČNÍ ŘEZÁNÍ – 5 REŽIMŮ

ČISTÝ ŘEZ (PURE) – 160W. Proud pro řezání bez koagulačního účinku.

ČISTÝ ŘEZ PULZNÍ (P PULSED) – 80W. Proud pro pulzní řezání bez koagulačního účinku.

SMÍŠENÝ ŘEZ (BLEND) – 140W. Proud pro řezání se slabým koagulačním účinkem.

SMÍŠENÝ ŘEZ PULZNÍ 1 (BLEND PULSED 1) – 70W. Proud pro rychlé pulzní řezání s koagulačním účinkem doporučeno pro práci s flexibilním endoskopem)

SMÍŠENÝ ŘEZ PULZNÍ 2 (BLEND PULSED 2) – 38W. Proud pro pomalé pulzní řezání s koagulačním účinkem (doporučeno pro polypektomii)

PROUDY PRO MONOPOLÁRNÍ KOAGULACI – 4 REŽIMY

MIKRO KOAGULACE (MICRO) – 100W. Proud s velmi nízkým povrchovým jiskřením.


PULZNÍ MIKRO KOAGULACE (M PULSED) – 100W. Proud s velmi nízkým povrchovým jiskřením. S časovým nastavením jednotlivého pulzu (od 0,1 do 1 sek.) **TENTO REŽIM JE NEJLEPŠÍ PRO MIKRO KOAGULACE.**

FULGURAČNÍ KOAGULACE (FULG) – 120W. Proud se silným povrchovým jiskřením. Vhodné pro práci v kapalině.


PULZNÍ FULGURAČNÍ KOAGULACE (FULG PULSED) – 60W. Proud pro rychlou pulzní fulguraci.

PROUDY PRO BIPOLÁRNÍ KOAGULACI – 1 REŽIM

(BIPOLAR) – 100W. Standartní bipolární koagulace s použitím bipolárních kleští, nůžek a jehel

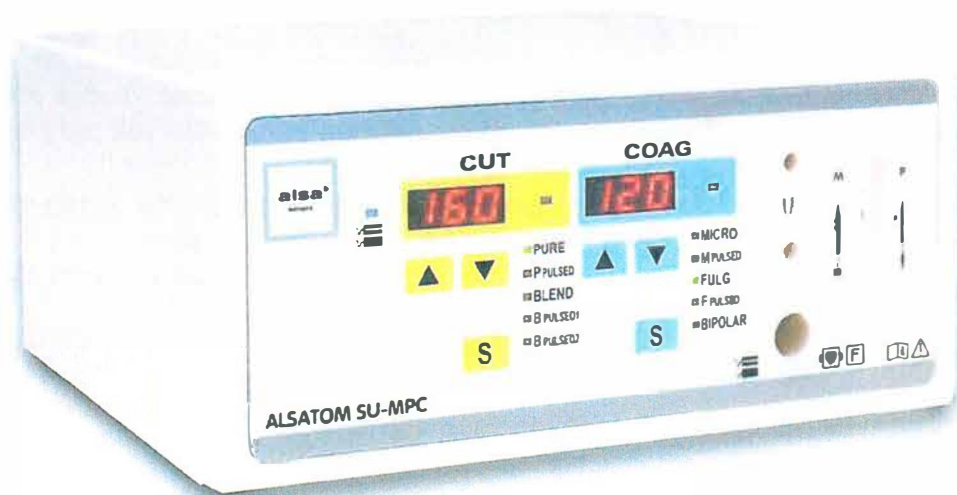

MPE/CMS-A-100:

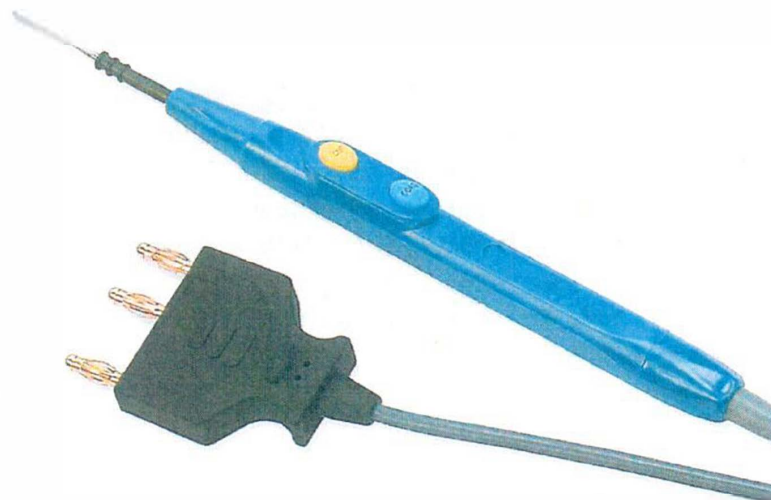

Cenová nabídka přístroje **SU 140/D MPC** s příslušenstvím

MONOPOLÁRNÍ REŽIM OVLÁDANÝ DRŽÁKEM ELEKTROD SE DVĚMI TLAČÍTKY (řez/koagulace) A BIPOLÁRNÍ REŽIM PEDÁLEM

Ref.č.	Popis	KS	Cena bez DPH/1k	DPH
B 730	ALSATOM SU 140/D MPC pro monopolární a bipolární použití - bez příslušenství (výkon 160W)	1		
MPE/CMS -A-100	Držák elektrod s aretací se 2 tlačítka., garance 100 sterilizací, vč. nožové elektrody (rovný nůž), kabel délky 3 m	1		21
CMS/E5	Kabel délky 5 m k nalepovacím neutrálním elektrodám, sterilizovatelný	1		
NP/GP	Neutrální elektroda z vodivého silikonu, rozměr 8x18 cm, kabel 3 m	1		
D-STOP/P	Dvojitý pedálový spínač	1		
H23/SE	Vozík, 3 police, brzděná kolečka	1		

VÝSLEDNÁ CENA NABÍZENÉ SESTAVY BEZ DPH 67 851 Kč

SLEVA PRO NEMOCNICI AGEL PŘEROV A.S. 5%

VÝSLEDNÁ CENA NABÍZENÉ SESTAVY PO SLEVĚ BEZ DPH 64 458,50 Kč

VÝSLEDNÁ CENA NABÍZENÉ SESTAVY S DPH 77 994,80 Kč

DPH 21 % 13 536,30 Kč

NOVÝ VOZÍK H23/SE



Mezi další výhody elektrochirurgického přístroje řady ALSATOM SU MPC patří:

- **snadné ovládání** – přehledný ovládací panel, na displeji se pak zobrazují aktuální nastavené hodnoty
- **lehká manipulace**, přenosnost – malé rozměry: 24x24x12 cm, nízká hmotnost přístroje: 5 kg
- **cenová dostupnost** – vynikající poměr **ceny, výkonu a užitné hodnoty** přístroje
- **prodloužená záruka** – **30 měsíců** na přístroj - první **2 roční** povinné prohlídky **zdarma**. Po provedené kontrole vyhotovujeme **certifikát bezpečnosti**.
- prodáno **145 ks** přímo této řady ALSATOM SU MPC a celkem elektrochirurgických přístrojů ALSA čítá pak více jak **450 ks** dodaných od r. 1996 v ČR a SR firmou HZZ a.s.

Záruční, platební, servisní a dodací podmínky, možnost zápůjčky

Cena: je konečná, **dopravné se neúčtuje**. V ceně dodávky je zahrnuto i základní zaškolení obsluhy přístroje a následné **2 roční** garanční a bezpečnostní **prohlídky zdarma** s vyhotovením certifikátu bezpečnosti

Warranty: na přístroj poskytujeme prodlouženou záruku v délce **30 měsíců**, na příslušenství **24 měsíců** od protokolárního převzetí přístroje do užívání

servisní podmínky: montáž a záruční servis i pozáruční servis provádí servisní technici HZZ a.s. (certifikát od výrobce na požádání)

Dodací lhůta: 4-6 týdnů, ale většinou přístroj dodáváme do 2-3 týdnů od objednávky.
Nyní máme přístroj skladem!!!

Přeji pěkný den a těším se na naši další spolupráci

obchodní oddělení HZZ, a.s.

	ELEKTROCHIRURGICKÝ GENERÁTOR	
	- specifikace minimálních požadavků Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov Kód ID: 00003179 Množství: 1 ks	
	Uchazeč	HZZ, a.s.
	Název nabízené technologie	ALSATOM SU 140/D MPC
	Výrobce	ALSA
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita		
zaručená kompatibilita bipolárního modu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)	NE	NE
Se spotřebním materiálem apod.	NE	NE
Medicinský účel		
Multioborový generátor pro všechny chirurgické obory, otevřenou i endoskopickou operativu včetně bipolárních aplikací a bipolárních aplikací ve fyziologickém roztoku s primárním použitím pro ...	ANO; oční ambulance	ANO, oční ambulance
Technické parametry		
Mikroprocesorově řízená vysokofrekvenční koagulační jednotka s jednoduchým a přehledným ovládáním v českém jazyce	ANO, Uveďte hodnotu	ANO
Generátor musí být určen pro drobnou chirurgii	ANO, Uveďte hodnotu	ANO
Zabezpečovací systémy: Automatický self-test; Monitorování neutrální elektrody, monitoring LF / HF unikajícího proudu	ANO, Uveďte hodnotu	ANO
Monopolární výstup - minimálně	1	1
Bipolární výstup - minimálně	1	1
výkon pro monopolár	Minimálně 140 W	160 W
výkon pro bipolár (Dle DI)	Minimálně 100 W	100 W
Možnost použití minimálně X nástrojů bez nutnosti jejich záměny (Dle DI)	Minimálně 2 nástrojů	Minimálně 2 nástrojů
Minimálně řez, pulsní řez, smíšený řez pulsní, smíšený řez, koagulace, mikrokoagulace, pulsní mikrokoagulace pro monopolární řezání	ANO; Uveďte hodnotu	ANO, čistý řez, čistý řez pulsní, smíšený řez, smíšený řez pulsní, koagulace, mikro koagulace, pulsní mikro koagulace
Monopolární koagulační proudy pro kontaktní a sprejovou koagulaci	Uvede dodavatel	koagulace, mikro koagulace, pulsní mikro koagulace, fulgurální koagulace, pulsní fulgurální koagulace
Monopolární řez hladký a s podílem koagulačního efektu	Uvede dodavatel	čistý řez, čistý řez pulsní, smíšený řez, smíšený řez pulsní
Bipolární koagulace (koagulace povrchová, povrchová s autostopem)	Uvede dodavatel	bipolární koagulace povrchová
Rozšíření funkcí o další typy monopolárních a bipolárních řezů a koagulací	Uvede dodavatel	NE
Automatická regulace výstupního výkonu	Uvede dodavatel	ANO
Automatické přerušení el. obvodu generátorem v návaznosti na měření zvýšeného přechodového odporu obvodu neutrální elektrody	Uvede dodavatel	ANO
možnost nastavení výkonu po 1 W	ANO, Uveďte hodnotu	ANO, nastavení výkonu po 1W
Barevný dotykový displej / fóliová klávesnice (tlačítka) pro nastavení parametrů řezu, koagulace, výběru programů a funkčních režimů	ANO; minimálně oročné ovládací prvky s informací o nastaveném výkonu na displeji přístroje - Uveďte způsob ovládání	ANO, fóliová klávesnice (tlačítka) pro nastavení parametrů řezu, koagulace, výběru programů a funkčních režimů
stálý monitoring kontaktu neutrální elektrody	ANO, Uveďte hodnotu	ANO
ovládání nožním spínačem, rukou, automatika pro bipolár (Autostart/Autostop)	ANO, Uveďte hodnotu	ANO, ovládání nožním spínačem, rukou
Automatické rozpoznávání nástrojů	Uvede dodavatel	NE
Přepnutí mezi dvěma výstupy i použitím nožního spínače	Uvede dodavatel	ANO
Bipolární resekce a bipolární vaporizace	Uvede dodavatel	NE
Automatická detekce a nastavení hodnot po připojení bipolárního resektoskopu	Uvede dodavatel	NE
Automatická detekce a nastavení hodnot po připojení bipolárních kleští pro otevřenou operativu	Uvede dodavatel	NE
Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor	ANO, Uveďte hodnotu	ANO, zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor
Rozšíření funkčnosti generátoru o bipolární koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu nebo obdobnou technologií - včetně příslušenství	NE	NE
Rozšíření funkčnosti generátoru o mód radiofrekvenční ablace bez nutnosti výměny nástroje - včetně příslušenství (resterilizovatelné nástroje pro laparoskopickou a otevřenou operativu	NE	NE
Příslušenství		
Kabel pro připojení neutrální elektrody pro opakovatelné použití	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks
Kabel pro připojení neutrální elektrody pro jednorázové použití	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks
autoklávovatelné ručky	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks
autoklávovatelné kabely k ručce	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks
Nožní spínač pro všechny provozní módy dvojité	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks
Přístrojový vozík s brzděnými kolečky	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks
Elektroseskční skalpely		
nožová elektroda resterilizovatelná	ANO; 1 ks	ANO, 1 ks