



KUPNÍ SMLOUVA č.....

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Boskovice s.r.o.**

sídlo: Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01
jednatel: RNDr. Dan Štěpánský, jednatel
IČ: 26925974
DIČ: CZ26925974
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**

sídlo: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6
jednatel: Radek Šubotník, prokurista
Ing. David Litterbach, prokurista
IČ: 27068641
DIČ: CZ27068641
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
(dále jen „prodávající“)

II. Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších služeb zakázky, která je realizována v rámci veřejné zakázky s názvem „**Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o.**“.

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Pro realizaci předmětu koupě je kromě této smlouvy závazná též nabídka prodávajícího, kterou předložil v rámci zadávacího řízení na:

část 5 veřejné zakázky s názvem: „Vybavení pro COS (centrální operační sály)“ (dále jen „NABÍDKA“) a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY, a to v rozsahu, v němž není, či nejsou v rozporu s touto smlouvou.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.



III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je pořízení přístrojů typového označení / výrobce:

1.1. síta pro COS / Olympus (Přístroj 1)

nástrojové vybavení / Olympus (Přístroj 2)

souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.

1.2. Součástí dodávky je:

- doprava přístroje/ů do místa instalace, vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů, vč. pojištění přepravy;
- instalace přístroje/ů a jejich zprovoznění do plného provozu, včetně provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, validace, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění;
- záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly, servisní práce a provádění bezpečnostně preventivních prohlídek, kalibrací a validací po dobu záruční doby;
- provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
- zajištění a provozování technické telefonické podpory Hot line zařízení
- kompletní technická dokumentace k zařízení v ČR
- zaškolení určené obsluhy zadavatele,
- demontáž, odvoz a ekologická likvidace a stávajících/ho přístrojů, včetně vystavení a předání dokladů o ekologické likvidaci Kupujícímu.

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby součástí a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou. Kupující zaplatí kupní cenu a předmět koupě převezme.

IV. Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístroj/e typového označení podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle specifikace požadované kupujícím v příloze č. 1 této smlouvy. Přesná specifikace přístroje/ů a příslušenství vč. dodávaného množství je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.
2. Prodávající dodá předmět koupě dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu podle této smlouvy a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle zadávací dokumentace a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, technická dokumentace, pokyny pro údržbu a servis (servisní knížka), apod.

V. Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Předmět koupě bezpodmínečně splňuje požadavky kupujícího uvedené příloze č. 1 této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje dodá Prodávající nové, ne repasované, ne demo verze, ne výstavní či předváděcí.
2. Prodávající prohlašuje podpisem této smlouvy, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevážnou žádné věcné ani právní vady.

VI. Doba, místo dodání, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě nejpozději do 26 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.



- Místem dodání je sídlo kupujícího.
- O dodání předmětu koupě, včetně jeho instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, zaškolení obsluhy kupujícího, předání kupujícímu manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k předmětu koupě, sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 4 této smlouvy. Pokud bude předmět koupě dodáván po částech, sepiší smluvní strany předávací protokol pro každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním předmětu této smlouvy rozumí podpis protokolu na poslední část předmětu koupě.
- Nebezpečí za škodu na předmětu koupě/přístrojích a vlastnické právo k předmětu koupě/přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
- Prodávající je povinen písemně uvědomit o termínu předání celého či části předmětu koupě pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 4 této smlouvy alespoň 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
- Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě či jeho část, pokud prodávající předmět koupě nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá předmět koupě v dohodnuté konfiguraci a kvalitě nebo předmět koupě je poškozený nebo rozbitý nebo prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k předmětu koupě nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení předmětu koupě do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

VII. Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za celý předmět koupě kupní cenu ve výši:

cena celkem bez DPH 928 163,- Kč

DPH sazby 21 % 194 914,23 Kč

cena celkem vč. DPH 1 123 077,23 Kč

- Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku předmět koupě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.
- Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, zaškolení obsluhy, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace v souladu s příslušným zákonem o odpadech, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce celého předmět koupě dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII. Záruční podmínky a servis

- Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít předmět koupě vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.

Záruční doba činí předmětu koupě

24 měsíců (nejméně však 24 měsíců)

a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

Je-li předmětem koupě více přístrojů (viz odst. 1.1. článku III. této smlouvy) platí, že výše uvedená záruční doba se vztahuje na každý přístroj samostatně.

- Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na předmět koupě, tj. bezplatné opravy. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady.
- Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady předmětu koupě zjištěné



v záruční době do

48 hodin (reakční doba) (nejpozději však do 48 hodin)

od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 2 týdny, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

Smluvní strany sjednávají možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 5 dní) na základě žádosti kupujícího. Zapůjčení náhradního přístroje dohodne s prodávajícím zástupce kupujícího dle čl. X. odst. 4 této smlouvy, přičemž tento zástupce rovněž podepíše předávací protokol.

Ukáže-li se, že vada předmětu koupě je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně nový přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na:

tel. č.



nebo

e-mailové adrese

servis-msd@olympus.cz

nebo

datovou schránkou



IX. Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním předmětu koupě v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII., odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.
4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

X. Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
3. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších



předpisů, zveřejnit v registru smluv, podle zákona o registru smluv, úplné znění kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

4. *Kupující pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:*
[REDACTED]
5. *Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:*
vedoucí zakázky [REDACTED]
6. *Ke změně pověřených pracovníků postačí prokazatelné oznámení druhé smluvní straně, a to nejpozději do tří dnů, kdy k takové změně dojde.*
7. *V případě, že v období mezi podpisem této smlouvy a předáním předmětu koupě dojde k výrobě vyšší verze přístroje nebo jeho části, může prodávající po předchozím písemném souhlasu kupujícího dodat za podmínek uvedených v této smlouvě kupujícímu tuto vyšší verzi předmětu koupě, a to bez navýšení kupní ceny, při zachování lhůty předání předmětu koupě a při zachování totožných nebo lepších parametrů předmětu koupě oproti parametrům předmětu koupě původně sjednaným v této smlouvě.*
8. *V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se podpisem této smlouvy prodávající zavazuje poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly. Závazek rovněž zahrnuje právo přístupu poskytovatele dotace v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole).*
9. *Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy včetně účetních dokladů, po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu smlouvy. Každý daňový doklad bude označen číslem projektu (CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016358). Prodávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddávatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.*
10. *Prodávající je povinen dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v pravidlech pro publicitu v rámci Evropských fondů, veřejně dostupných, a to ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, pokud kupující nestanoví jinak.*
11. *Prodávající je povinen zpracovávat všechny součásti a dokumenty související s předmětem smlouvy v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce.*
12. *Prodávající bude minimálně po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Prodávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddávatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.*
13. *Tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí kupující.*

XI. Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ.

XII. Závěrečná ustanovení

1. *Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí OZ.*
2. *V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.*
3. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:*
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
4. *Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení*



nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejlíže.

5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 4 a 5 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.

V Boskovicích dne

RNDr. Dan Štěpánský
Digitálně podepsal
RNDr. Dan Štěpánský
Datum: 2022.08.15
14:11:52 +02'00'

za Kupujícího

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel společnosti

V Praze dne

Radek Šubotník
Digitálně podepsal
Radek Šubotník
Datum: 2022.07.25
09:59:31 +02'00'

David Litterbach
Digitally signed by
David Litterbach
Date: 2022.07.25
13:34:38 +02'00'

za Prodávajícího

Radek Šubotník, prokurista
Ing. David Litterbach, prokurista



PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Technická specifikace části 5

Vybavení pro COS – síta pro COS

Požadovaná technická specifikace	Splnění ANO/NE	Nabízená hodnota/parametr
1. síto		
HD Rigidní optika, 1 ks	ANO	1 ks
úhel pohledu 12°	ANO	12°
průměr optiky 4 mm	ANO	4 mm
pracovní délka optiky 280 mm	ANO	280 mm
safírová sklíčka	ANO	
kompatibilní s endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus a s bipolárními resektoskopy zn. Olympus na COS	ANO	
kompatibilní se stávajícími cystoskopy zn. Olympus	ANO	
kompatibilní se stávajícími hysteroskopy zn. Olympus	ANO	
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	134°C
součástí dodávky ochranný tubus ke každé optice	ANO	
pracovní můstek, 1 ks	ANO	1 ks
kompatibilní se stávajícím resektoskopickým pláštěm, zn. Olympus	ANO	
pracovní kanál min. 8 Fr.	ANO	8 Fr.
resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C
2. síto		
světlovodný kabel, 1 ks	ANO	1 ks
průměr 2,8 mm	ANO	2,8 mm
délka 3 m	ANO	3 m
kompatibilní s videosystémem OTV-S200 zn. Olympus	ANO	
resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C
semiflexibilní nůžky, 1 ks	ANO	1 ks
průměr 5 Fr.	ANO	5 Fr.
délka 360 mm	ANO	360 mm
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C
semiflexibilní úchopové kleště, 1 ks	ANO	1 ks
se zoubky	ANO	
průměr 5 Fr.	ANO	5 Fr.
délka 360 mm	ANO	360 mm
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C
3. síto		
semiflexibilní nůžky, 1 ks	ANO	1 ks
průměr 5 Fr.	ANO	5 Fr.
délka 360 mm	ANO	360 mm
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C
semiflexibilní úchopové kleště, 1 ks	ANO	1 ks



se zoubky	ANO	
průměr 5 Fr.	ANO	5 Fr.
délka 360 mm	ANO	360 mm
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C
pracovní můstek, 1 ks	ANO	1 ks
kompatibilní se stávajícím resektoskopickým pláštěm, zn. Olympus	ANO	
pracovní kanál min. 8 Fr.	ANO	8 Fr.
resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134 °C	ANO	134°C

1. síto

Rigidní optiky Olympus

Rigidní optiky OES Elite jsou určeny pro urologické, gynekologické a ORL nástroje připojitelné standardním okulárem všech renomovaných výrobců. Díky speciálnímu navržení čoček lze optiky používat s HD kamerovým hlavami bez zhoršení kvality výsledného obrazu. Optiky disponují tvrzeným (safírovým) sklem odolným proti poškrábání. Optiky lze používat ve speciálních módech světla NBI a jsou plně autoklávovatelné (134 °C).

Nabízené optiky jsou kompatibilní se všemi nástroji generace OES Pro a OES Elite (resektoskopy, cystoskopy, urethrothomy, ...) a světlovody zn. Olympus.

technické parametry:

úhel pohledu: 0°, 12°, 30°, 30°W, 70°

průměr: 4 mm

délka: 280,0 – 284,0 mm

autoklávovatelnost: ano

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE:

WA2T412A – hysteroskopická optika, **1 ks**,
HD, 12°, průměr 4 mm, délka 280,0 mm



součástí každé optiky je ochranný tubus
WA2P400A – ochranný tubus, **1 ks**



A42091A – pracovní můstek hysteroresektoskopu, **1 ks**
pracovní kanál 8 Fr., autokláv.




A0282 – náhradní těsnění 7 Fr., pro pracovní můstek hysteroresektoskopu, jednorázové, 1 bal. (**10 ks**)





2. síto


WA03300A – světlovodný kabel, 2,8 mm x 3 m, autokláv., 1 ks

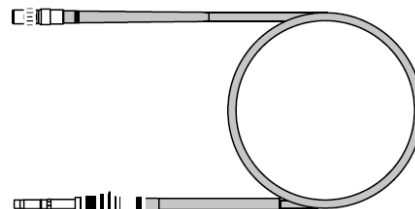

A4826 – semilexibilní nůžky, 5 Fr.x 360 mm, autokláv., 1 ks



A4825 – semilexibilní úchopové kleště, žraločí zuby, 5 Fr.x 360 mm, autokláv., 1 ks

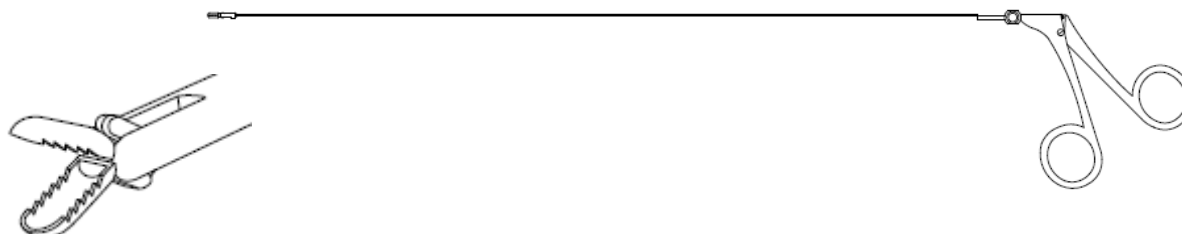


3. síto

A4826 – semilexibilní nůžky, 5 Fr.x 360 mm, autokláv., 1 ks




A4825 – semilexibilní úchopové kleště, žraločí zuby, 5 Fr.x 360 mm, autokláv., 1 ks

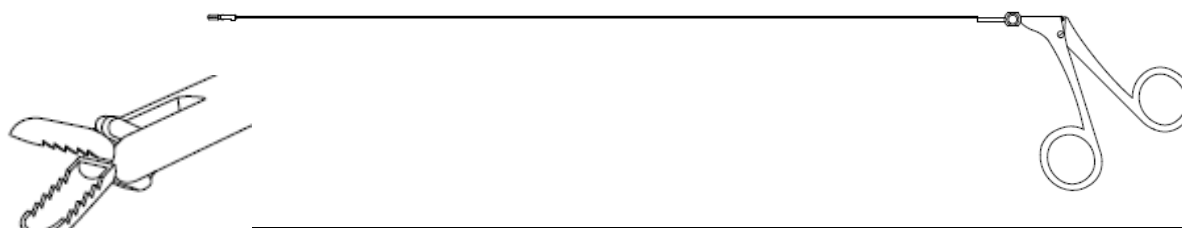



A42091A – pracovní můstek hysteroresektoskopu, 1 ks
pracovní kanál 8 Fr., autokláv.



A0282 – náhradní těsnění 7 Fr., pro pracovní můstek hysteroresektoskopu, jednorázové, 1 bal. (10 ks)

Vybavení pro COS – nástrojové vybavení

Požadovaná technická specifikace	Splnění ANO/NE	Nabízená hodnota/parametr
Flexibilní cystoskop, 1 ks	ANO	1 ks
opakovatelně resterilizovatelný	ANO	
průměr distálního konce maximálně 11,7 Fr.	ANO	11,7 Fr.
průměr pracovní části maximálně 16,5 Fr.	ANO	16,5 Fr.
zúžený atraumatický distální konec pro snadnější zavedení do močové trubice	ANO	
pracovní kanál minimálně 7,2 Fr.	ANO	7,2 Fr.
širokoúhlé zorné pole minimálně 120°	ANO	120°
úhel pohledu 0°	ANO	0°
hloubka ostrosti 3 – 50 mm	ANO	3-50 mm
vestavěný moiré filtr	ANO	
pracovní délka minimálně 380 mm	ANO	380 mm
ohyb tubus nahoru/dolů 210°/120°	ANO	n/d 210°/120°
kompatibilní s běžným kamerovými hlavami	ANO	
možnost doostření obrazu na očníci okuláru	ANO	
možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců	ANO	
kompatibilní se zdrojem světla CLV-S190	ANO	
možnost připojení přenosného LED zdroje světla	ANO	
kompatibilní se stávajícím kamerovou jednotkou OTV-S190	ANO	
kompatibilní se stávající zkoušečkou těsnosti nebo možnost dodání 1 ks zkoušečky těsnosti	ANO	kompatibilní se stávající WA23080A
základní čistící sada, 1 ks	ANO	1 sada (3 ks)
EtO uzávěr (sterilizace v Plasmě), 1 ks	ANO	1 ks
přípojný adaptér oplachu, 1 ks	ANO	1 ks
náhradní těsnění k přípojnému adaptéru, 10 ks	ANO	1 bal (po 10ti kusech)

FLEXIBILNÍ CYSTOSKOP CYF-5

- průměr distálního keramického konce 11,7 Fr.
- průměr tubus 16,5 Fr.
- pracovní kanál 7,2 Fr.



- zorné pole 120°
- úhel pohledu 0°
- hloubka ostrosti 3 – 50 mm
- pracovní délka 380 mm
- celková délka 700 mm
- ohyb tubus nahoru/dolů 210°/120°
- moiré filtr
- zúžený atraumatický distální konec pro snadnější zavedení do močové trubice
- korekce dioptrické chyby – úprava ostrosti obrazu pomocí ovládacího prstence na okuláru
- kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami
- kompatibilní se zdroji světla Olympus
- kompatibilní s kamerovými jednotkami Olympus
- kompatibilní s přenosným zdrojem světla EndoLED, Olymous
- kompatibilní se zkoušečkou těsnosti Olympus WA23080A
- možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců
- sterilizace plynem (plynová sterilizace ethylenoxidem, peroxidem vodíku, nízkoteplotní plasmovou sterilizací)
- vyšší stupeň desinfekce v roztoku
- příslušenství:
 - o 1 sada kartáčků pro čištění
 - o 1 ks přípojný adaptér k pracovnímu kanálu
 - o 10 ks těsnění pro adaptér pracovního kanálu
 - o 1 ks krytka pro sterilizaci endoskopu plynem

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE:


N6005450 – CYF-5, flexibilní cystoskop, 1 ks
endoskop obsahuje:

1 sadu – čistících kartáčků

1 ks – ETO krytka pro sterilizaci

1 ks – přípojný adaptér, 2cestný

10 ks – těsnění k přípojnému adaptéru

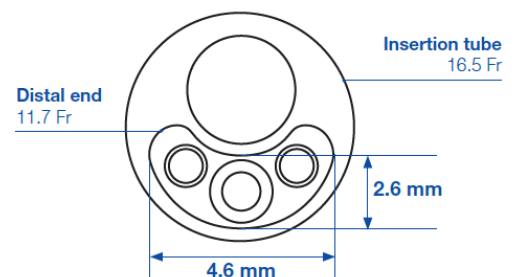



Požadovaná technická specifikace	Splnění ANO/NE	Nabízená hodnota/parametr
Endoskopické optiky		
HD Rigidní optika, 1 ks	ANO	1 ks
úhel pohledu 12°	ANO	12°
průměr optiky 4 mm	ANO	4 mm
pracovní délka optiky 280 mm	ANO	280 mm
safírová sklíčka	ANO	
kompatibilní s endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus a s bipolárními resektoskopy zn. Olympus na COS	ANO	
kompatibilní se stávajícími cystoskopy zn. Olympus na Centrálních operačních sálech zadavatele	ANO	
kompatibilní se stávajícími hysteroskopy zn. Olympus na Centrálních operačních sálech zadavatele	ANO	
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	134°C
součástí dodávky ochranný tubus ke každé optice	ANO	
HD Rigidní optika, 1 ks	ANO	1 ks
úhel pohledu 70°	ANO	70°
průměr optiky 4 mm	ANO	4 mm
pracovní délka optiky 284 mm	ANO	284 mm
safírová sklíčka	ANO	
kompatibilní s endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus a s bipolárními resektoskopy zn. Olympus na COS	ANO	
kompatibilní se stávajícími cystoskopy zn. Olympus na Centrálních operačních sálech zadavatele	ANO	
kompatibilní se stávajícími hysteroskopy zn. Olympus na Centrálních operačních sálech zadavatele	ANO	
resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	134°C
součástí dodávky ochranný tubus ke každé optice	ANO	

Rigidní optiky Olympus

Rigidní optiky OES Elite jsou určeny pro urologické, gynekologické a ORL nástroje připojitelné standardním okulárem všech renomovaných výrobců. Díky speciálnímu návrhu čoček lze optiky používat s HD kamerovými hlavami bez zhoršení kvality výsledného obrazu. Optiky disponují tvrzeným (safírovým) sklem odolným proti poškrábání. Optiky lze používat ve speciálních módech světla NBI a jsou plně autoklávovatelné (134 °C).

Nabízené optiky jsou kompatibilní se všemi nástroji generace OES Pro a OES Elite (resektoskopy, cystoskopy, uretrothomy, ...) a světlovody zn. Olympus.

technické parametry:

úhel pohledu: 0°, 12°, 30°, 30°W, 70°

průměr: 4 mm

délka: 280,0 – 284,0 mm

autoklávovatelnost: ano




POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE:

WA2T412A – cystoskopická optika, **1 ks**,
HD, 12°, průměr 4 mm, délka 280,0 mm



WA2T470A – Cystoskopická optika, **1 ks**,
HD, 70°, průměr 4 mm, délka 284 mm



součástí každé optiky je ochranný tubus

WA2P400A – ochranný tubus, 2 ks





Požadovaná technická specifikace	Splnění ANO/NE	Nabízená hodnota/parametr
Semirigidní ureteroskop, 1 ks	ANO	1 ks
opakovaně resterilizovatelný semirigidní ureteroskop	ANO	
ergonomická rukojeť	ANO	
různý průměr ureteroskopu (max. 6,7/max. 8,4 Fr.) v jeho délce - pro lepší a bezpečnější zavádění	ANO	6,7/8,4 Fr.
zúžený atraumatický distální konec pro snadnější a bezpečnější zavádění	ANO	
maximální vnější průměr 8,4 Fr.	ANO	8,4 Fr.
průměr atraumatického distálního konce max. 6,7 Fr.	ANO	6,7 Fr.
šikmý okulár pro připojení kamerové hlavy	ANO	
pracovní délka min. 430 mm	ANO	430 mm
úhel pohledu max. 7°	ANO	5°
atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“	ANO	
antireflexní úprava distálního konce	ANO	
přímý pracovní kanál s uzavíratelným vstupem (kohoutek)	ANO	
minimální šířka pracovního kanálu 4,2 Fr.	ANO	4,2 Fr.
2 konektory pro připojení proplachu s kohoutky	ANO	
endoskop je resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	134°C
sada těsnění na pracovní kanál s automatickou zpětnou klapkou, 10 ks	ANO	1 bal (po 10ti kusech)
sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje, 1 ks	ANO	1 ks

SEMIRIGIDNÍ URETEROSKOP OES ELITE OLYMPUS

- opakovaně resterilizovatelný
- jemný obraz díky vysokému počtu optických vláken (30 000 vláken)
- vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu na kameře
- HDTV kompatibilní
- různý průměr ureteroskopu (6,7/8,4 Fr.) v jeho délce – pro lepší a bezpečnější zavádění
- atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“
- průměr distálního konce 6,7 Fr.
- anti-reflexní úprava materiálu tubusu pro potlačení odlesku v obraze
- šikmý okulár pro připojení kamerové hlavy
- délka pracovní části 430 mm
- úhel pohledu 5°
- zorné pole 85°
- přímý pracovní kanál, 4,2 Fr.
- vstup do pracovního kanálu s kohoutem
- 2 konektory pro připojení proplachu s kohoutky
- zvětšená ergonomická rukojeť pro stabilnější a komfortnější úchop (alespoň pro 3 prsty)
- materiál tubusu se zvýšenou odolností proti trvalé deformaci po výkonu
- endoskop je resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134°C




POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE:

WA2UR11A – semirigidní ureteroskop, 6,7/8,4 Fr. x 430 mm, 5° úhel pohledu, prac. kanál 4,2 Fr., přímý vstup do pracovního kanálu, **1 ks**




WA2URADP – uzavíratelný kohout, **1 ks**



WA00387A – těsnící čepička, 0,7 mm, transparentní, jednorázové, **10 ks** (1 bal.)



WA2BSKTA – sterilizační kontejner, kovový, **1 ks**

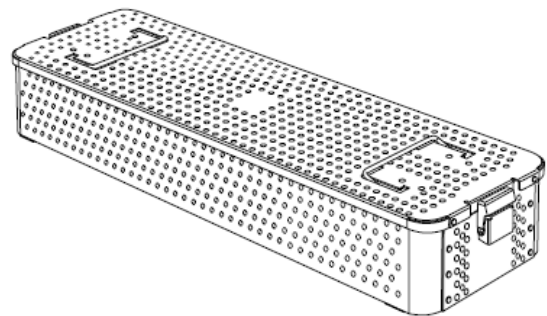



Semirigidní ureteroskop, 1 ks	ANO	1 ks
opakovaně resterilizovatelný semirigidní ureteroskop	ANO	
jemný obraz díky vysokému počtu optických vláken (min. 50 000 vláken)	ANO	50000 vláken
ergonomická rukojeť	ANO	
různý průměr ureteroskopu (max. 8,6/max. 10,4 Fr.) v jeho délce – pro lepší a bezpečnější zavádění	ANO	7,3/10,4 Fr.
zúžený atraumatický distální konec pro snadnější a bezpečnější zavádění	ANO	
maximální vnější průměr 10,4 Fr.	ANO	10,4 Fr.
průměr atraumatického distálního konce max. 8,6 Fr.	ANO	7,3 Fr.
šikmý okulár pro připojení kamerové hlavy	ANO	
pracovní délka min. 430 mm	ANO	430 mm
úhel pohledu max 7°	ANO	5°
atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“	ANO	
antireflexní úprava distálního konce	ANO	
přímý pracovní kanál	ANO	
minimální průměr pracovního kanálu 6,4 Fr.	ANO	6,4 Fr.
dvojitý vstup do pracovního kanálu s uzavíratelnými kohouty	ANO	
2 konektory pro připojení proplachu s kohoutky	ANO	
endoskop je resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134°C	ANO	134°C
sada těsnění na pracovní kanál s automatickou zpětnou klapkou, 20 ks	ANO	2 balení (1 bal. po 10 ks)
sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje, 1 ks	ANO	1 ks

SEMIRIGIDNÍ URETEROSKOP OES ELITE OLYMPUS

- opakovaně resterilizovatelný
- jemný obraz díky vysokému počtu optických vláken (50 000 vláken)
- vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu na kameře
- HDTV kompatibilní
- různý průměr ureteroskopu (7,3/10,4 Fr.) v jeho délce – pro lepší a bezpečnější zavádění
- atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“
- průměr distálního konce 7,3 Fr.
- anti-reflexní úprava materiálu tubusu pro potlačení odlesku v obraze
- šikmý okulár pro připojení kamerové hlavy
- délka pracovní části 430 mm
- úhel pohledu 5°
- zorné pole 85°
- přímý pracovní kanál, 6,4 Fr.
- 2 vstupy do pracovního kanálu s kohouty
- 2 konektory pro připojení proplachu s kohoutky
- zvětšená ergonomická rukojeť pro stabilnější a komfortnější úchop (alespoň pro 3 prsty)
- materiál tubusu se zvýšenou odolností proti trvalé deformaci po výkonu
- endoskop je resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134°C




POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE:

WA2UR14A – semirigidní ureteroskop, 7,3/10,4 Fr. x 430 mm, 5° úhel pohledu, prac. kanál 6,4 Fr., 2 vstupy do pracovního kanálu, **1 ks**





WA2URADP – uzavíratelný kohout, **2 ks**



WA00387A – těsnící čepička, 0,7 mm, transparentní, jednorázové, **20 ks** (2 bal.)



WA2BSKTA – sterilizační kontejner, kovový, **1 ks**

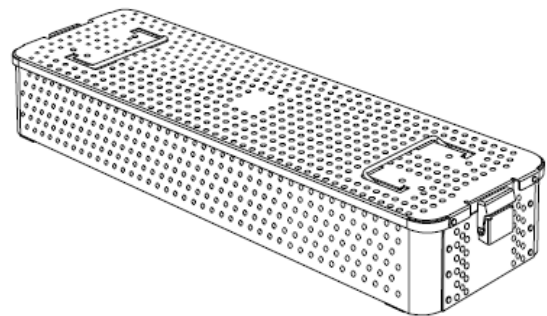



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY

Krycí list nabídky



Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o.

část VZ: 5 - Vybavení pro COS

Tabulka číslo 1

Krycí list nabídky

Název nebo obchodní firma uchazeče

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Sídlo uchazeče

Evropská 176/16, 160 41 Praha 6

Právní forma uchazeče

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo uchazeče

27068641

Daňové identifikační číslo uchazeče

CZ27068641

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů

Radek Šubotník a Ing. David Litterbach - prokuristé

Jméno a příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Petr Pouč - manažer prodeje

Telefon uchazeče

420 702 209 267

ID datové schránky

644rdaw

E-mailová adresa uchazeče

petr.pouc@olympus.cz

Celková výše nabídkové ceny

nabídková cena v Kč

bez DPH

síta pro COS

203 843,00

nástrojové vybavení

724 320,00

0,00

0,00

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

928 163,00

DODAVATEL UŽIJTE TABULKU PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZVLÁŠTĚ.

Legenda

takto označené buňky vyplní uchazeč

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Praze dne 2022

Radek Šubotník
prokurista
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

David Litterbach
prokurista
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Digitálně podepsal
Radek Šubotník
Datum: 2022.07.25
1000006 +0200

Digitally signed by
David Litterbach
Date: 2022.07.25
13:35:13 +0200