

SMLOUVA O VÝPŮJČCE**Videris s.r.o.**

se sídlem: Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
 IČ: 27189112
 DIČ: CZ27189112
 zastoupená: Ing. Janem Tichým, jednatelem
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103082
 bankovní spojení: [REDACTED]
 č. účtu: [REDACTED]
 kontaktní osoba: [REDACTED]
 (dále jen „půjčitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
 IČ: 25488627
 DIČ: CZ25488627
 zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
 bankovní spojení: [REDACTED]
 č. účtu: [REDACTED]
 kontaktní osoba za odbor obslužných klinických činností: [REDACTED]
 kontaktní osoba za oddělení: prim. [REDACTED]
 (dále jen „vypůjčitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku

Čl. 1**Předmět smlouvy**

1. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčiteli následující nezuživatelnou věc: křeslo chirurga UFSK surgiForce light, sedák Comfort, sériové číslo SN: 0520 a zavazuje se mu umožnit její bezplatné užívání podobu sjednanou v této smlouvě (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Hodnota předmětu výpůjčky je [REDACTED].
3. Předmět výpůjčky půjčitel přenechává vypůjčiteli pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice, o.z., oddělení COS, kde bude užíván obvyklým způsobem.
4. Půjčitel se zavazuje předat předmět výpůjčky vypůjčiteli nejpozději do konce září 2022. O předání předmětu výpůjčky bude pověřenými zástupci smluvních stran sepsán protokol, jehož stejnopis obdrží obě smluvní strany.

Čl. 2**Vrácení předmětu výpůjčky**

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky *na dobu určitou, a to na měsíc říjen 2022*.
2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky půjčiteli vrátit, jakmile ho nebude potřebovat, nejpozději však do výše sjednané doby.
3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
4. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby, jestliže vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem sjednaným touto smlouvou.

5. Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu odpovídajícím obvyklému užívání.

Čl. 3. Užívání předmětu výpůjčky

1. Půjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vypůjčitel předá předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k účelu sjednanému touto smlouvou a vypůjčitel se zavazuje ho řádně užívat v souladu se sjednaným účelem, a chránit ho před odcizením, poškozením a znehodnocením. Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou půjčiteli nesplněním této povinnosti.
2. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady na jeho zachování. Je-li k užívání předmětu výpůjčky nutný spotřební materiál, jehož dodavatelem je půjčitel, je spotřební materiál specifikován v příloze č. 2 této smlouvy, Specifikace spotřebního materiálu zároveň obsahuje ceny, které se půjčitel zavazuje garantovat po celou dobu trvání výpůjčky.*
3. Vzniklé vady předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli, který dál zajistí vyřízení reklamace apod.
4. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jeho technického stavu a za účelem provádění inventarizace.
5. Půjčitel provede případný servis (tj. bezpečnostně technické kontroly a opravy) v souladu s § 64 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, nebo s § 44 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, kalibrace*, validace*, revize dle § 67 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, nebo s § 47 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a v případě zařízení se zdroji ionizačního záření zkoušku dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu výpůjčky na své náklady.
6. Vypůjčitel se zavazuje, že v případě jím zaviněného poškození předmětu výpůjčky uhradí veškeré náklady nutné na jeho opravu.
7. Půjčitel se zavazuje při předání předmětu výpůjčky seznámit zdravotnický personál a určeného pracovníka odboru obslužných klinických činností vypůjčitele s návodem k použití, který je nutno při užívání předmětu výpůjčky dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při jeho užívání oproti obecně známým pravidlům. Vypůjčitel je povinen uvedený předmět výpůjčky užívat v souladu s návodem k jeho obsluze. O tomto seznámení vystaví půjčitel protokol o proškolení.
8. Půjčitel se zavazuje dodat veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu výpůjčky (event., které jsou vypůjčitelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že předmět výpůjčky je vyroben v souladu s platnými normami, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 186/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, v případě zařízení se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů. V případě předmětu výpůjčky, který je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako stanovené měřidlo, nebo

předmět výpůjčky je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, půjčitel se zavazuje dodat doklady o prvotní kalibraci či metrologickém ověření.

9. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí připojení do NIS/LIS (nemocničního či laboratorního informačního systému), půjčitel se zavazuje na své náklady připojit předmět výpůjčky do NIS/LIS vypůjčitele vč. případných převodníků. Půjčitel je povinen v průběhu výpůjčky na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků vypůjčitele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií [REDACTED]

Čl. 4

Odpovědnost za škodu

1. V případě zničení, ztráty či poškození předmětu výpůjčky se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení předmětu výpůjčky odpovídá vypůjčitel jako za poškození.
2. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné skryté vady (právní ani faktické). Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem skryté vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčiteli dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
3. Půjčitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předmět výpůjčky nepředal vypůjčiteli ani po domluvě s jeho kontaktní osobou, resp. že ho neumístil na oddělení dle této smlouvy. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky do doby podpisu smlouvy nepřevzít. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že bude – li předmět výpůjčky umístěn u vypůjčitele na oddělení před podpisem této smlouvy, není případná odpovědnost za škodu vzniklá v souvislosti s použitím předmětu výpůjčky kryta pojištěním z odpovědnosti vypůjčitele a půjčitel se zavazuje k náhradě škody takto vzniklé.

Čl. 5


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
3. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vez znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hodnoty předmětu výpůjčky.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv vypůjčitel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
6. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

7. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem téhož měsíce.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemnou formou.
9. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. *specifikace předmětu výpůjčky*





surgiForce light

SURGEON'S CHAIR



ENJOY QUALITY AND DESIGN



surgiForce light

Item No.: 2600 0006 with Comfort seat
Item No.: 2600 0009 with Formed seat (Illustration)

surgiForce light – extraordinary technology and materials in typical **surgiForce** premium design, in combination with other control elements:

A clearly structured twin foot keypad plus manually operated gas spring mechanisms in the arm supports – for surgeons wishing to precision-adjust their arm position with minimum fuss.



MED.TEC at its highest level

Double castors

The five high-grade double castors are smooth-running and rotated by 360 degrees. This means no-limits mobility, especially in confined operating room spaces. **surgiForce's** central front castor in particular gives extra stability to keep the treating surgeons safely in place whenever they shift their bodyweight forward.



Chassis

The drive mechanism's base is made of cast aluminum. This means maximum stability and longevity and no-limits mobility. And the material and workmanship meet the strictest sanitary requirements.



Plastic cover panels

The mirror-finish plastic cover panels with their scratch-resistant and impact-modified surface finish are extremely hygienic and easy to disinfect.



Mains-free operation


Accumulators

The charger-battery-control unit integrated in the drive mechanism permits mains-free operation at protective low voltage. Splash-protected charging socket on the bottom of the drive mechanism.



Braking system

The easy-to-reach and easy-to-use central brake acts on all four double castors to keep the *surgiForce light* safely and reliably in the desired position.

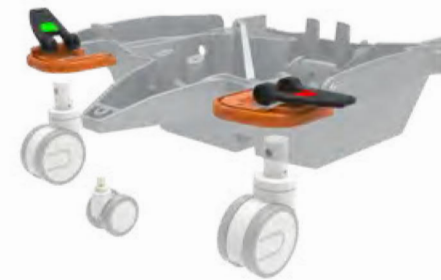

Multi-function unit

Foot operated

Timeless foot keypad design for UP/DOWN seat height adjustment with non-slip polyamide touch surfaces. Easy-to-reach brake levers on either side of the driving mechanism for centralized braking/unfettered maneuvering.



Abrasion-resistant corner guards (orange) made of synthetic rubber take the stress out of maneuvering *surgiForce light* even at close quarters to other medical equipment.


Armrests with gas-spring mechanism



3D freedom of movement

Armrest height is adjustable independently of seat height. It takes only simple rolling movement to manually control the gas spring mechanism.

Turning, tilting, rotating: The armrests have been designed for fast and unfussy 3D movements.

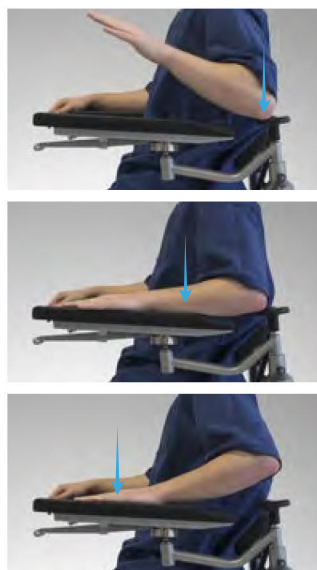

Need to readjust *surgiForce light* while maintaining sterile conditions? Not a problem! In addition to the foot keypad, *surgiForce light* features so-called "one-hand triggers" underneath the armrests.



High-precision, maintenance-free ball joint for full 360-degree range armrest movements around all axes. Ultra-lightweight guide system for fast, efficient and vibration-proof adjustment of individual underarm positions.

Seating systems



Comfort

The seating system Comfort: With mechanical individual adjustment functions. For a correct, back-friendly sitting and working posture, the seat surface or the seat depth can be adjusted by a sliding mechanism located underneath the seat.



Formed seat

The form seating system: With enlarged contact surface for more comfort and optimum weight distribution. The seat surface can be individually tilted forward and fixed together with the backrest. In addition, angle and height adjustment of the backrest ensure an ideal sitting posture.



Seat angle adjustment



Back angle adjustment



Back height adjustment



Seat angle adjustment



Back angle adjustment



Back height adjustment



NEW

Angled armrest support for increased freedom of armrest movement around the lateral axis.



Upholstery / colour card


Standard colour
black
Item No.: 3037 0223



"Periline" Page 111

Comfort

Standard colour
anthracite
Item No.: 3037 0052

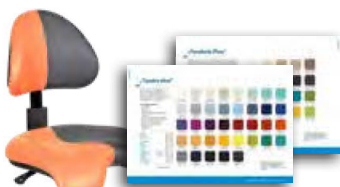

"Tundra skai" Page 108

"Pandoria Plus" Page 109

Formed seat

Technical specifications

Lifting column

- Lifting height of the seat 200 mm
- Lifting height of the armrests 130 mm
- Electromotive adjustment via the foot control elements

Dimensions

- Max. L x W x H (incl. armrests) 825 x 700 x 1,270 mm

Chassis

- Castors ø 100 mm
- 5th castors ø 65 mm
- Central brake acting on all four castors
- Emergency stop button

Battery unit

- Lead-gel battery, 2 pcs. 12 V, 2.9 A
- Universal battery charger: Input: 100 – 240 V
Output: 24 V

Sitzsysteme: Comfort (Formed seat)

- Min. sitting height 600 mm (580 mm)
- Max. sitting height 800 mm (780 mm)
- Seat angle adjustments -6° (-14°)
- Back angle adjustments -10° (-19° / +5°)

Weight

71 kg


Max. load

150 kg


Techn. Änderungen vorbehalten.

Technical dimensions

Seating system Comfort

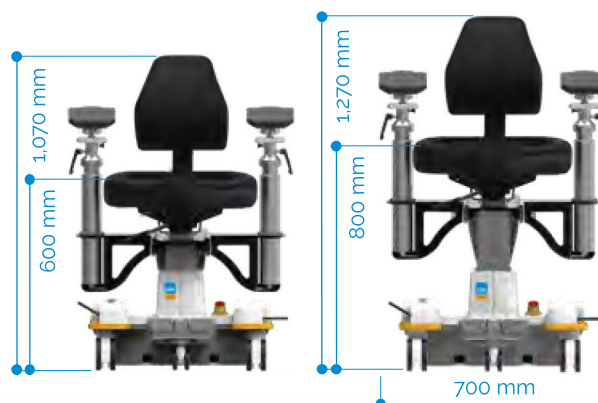

Seating system Formed seat

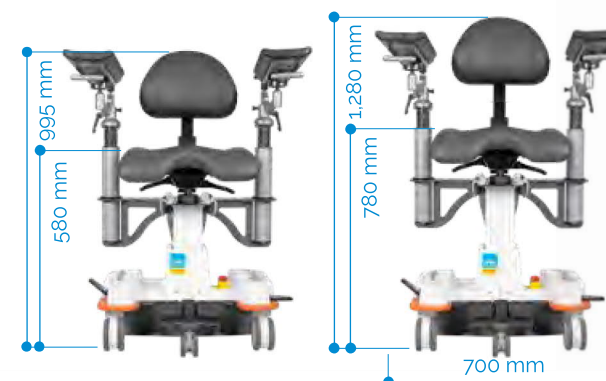


Components



surgiForce light
Formed seat Item No.: 2600 0009



surgiForce light
Comfort seat Item No.: 2600 0006



Armrest pair with
linear guide and
one-hand release,
factory-fitted

Item No.: 3351 1008



Seat adjustment mechanism
for optimum access to the
operating field,
adjustment 113 mm,
factory-fitted

Item No.: 3351 1013



Footswitch plate
429x820 mm, height 53 mm

Item No.: 3317 0000



Footswitch plate
429x670 mm, height 53 mm

Item No.: 3351 1041

PREMIUM
LINE

"Tundra skai"



High quality skai® material with fine calf leather grain and subdued matte-gloss-effect. The very extensive and trend-orientated colour spectrum enables many applications and combinations.

Product Specification

- Long-lasting
- Tear resistant
- Easy to clean
- Abrasion resistant (DIN EN ISO 6570-2)
- Lightfast
- Disinfectant resistant
- Fulfills medical standard (DIN EN ISO 10993-5+10)
- Blood- and urine resistant
- Phthalate-free
- Vegan

<i>eyeForce</i>	1800 0000
<i>500 XLE</i>	1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>	1500 0006
	+ 3037 0080
<i>500 bariatric</i>	1500 0002
<i>500 XLS</i>	1500 0005
<i>500 ECO</i>	1500 0008
<i>400 XL</i>	1400 0001
<i>surgiForce</i>	2600 0008
<i>surgiForce light</i>	2600 0009
<i>surgiLine</i>	2200 0008
<i>assistLine</i>	2400 0015
<i>motionLine</i>	1700 0000
<i>motionLine-E</i>	1700 0001

+ Item No.: 3037 0...

F6461198 Item No.:134	F6461210 Item No.:057	F6461636 Item No.:094	F6461230 Item No.:058	F6461610 Item No.:153	F6461495 Item No.:067	F6461456 Item No.:001	F6461338 Item No.:008
F6461288 Item No.:007	F6461550 Item No.:070	F6461608 Item No.:075	F6461496 Item No.:068	F6461609 Item No.:076	F6461581 Item No.:073	F6461196 Item No.:051	F6461453 Item No.:062
F6461356 Item No.:059	F6461381 Item No.:119	F6461354 Item No.:011	F6461350 Item No.:010	F6461199 Item No.:054	F6461454 Item No.:063	F6461557 Item No.:072	F6461556 Item No.:071
F6461458 Item No.:066	F6461457 Item No.:065	F6461607 Item No.:074	F6461542 Item No.:069	F6461343 Item No.:009	F6461543 Item No.:109	F6461455 Item No.:064	F6461273 Item No.:006
F6461205 Item No.:056	F6461204 Item No.:055	F6461357 Item No.:060	F6461195 Item No.:050	F6461197 Item No.:052			

The colours displayed on your device may differ slightly from the original colours. If you wish to receive original colour charts, please contact us at info@ufsk-osys.com.

"Pandoria Plus"



skai® Pandoria Plus is a high-quality upholstery material, whose fine micropore structure gives a certain unobtrusiveness, which is refined by an attractive tone-in-tone effect. The very pleasant feel of the material and the excellent material characteristic and the broad, modern color spectrum make skai® Pandoria Plus universally usable.

Product Specification

- Long-lasting
- Tear resistant
- Easy to clean
- Abrasion resistant (DIN EN ISO 5470-2)
- Resistant to oil and fat
- Lightfast
- Disinfectant resistant
- Flame protection
- Fulfills medical standard
- Resistant to sudor, blood and urine
- 0161-21 (IMO FTFC Part 8)
- Antibacterial according to JIS Z 2801
- Vegan

<i>eyeForce</i>		1800 0000
<i>500 XLE</i>		1500 0006
<i>500 XLE comfort</i>		1500 0006
		+ 3037 0080
<i>500 bariatric</i>		1500 0002
<i>500 XLS</i>		1500 0005
<i>500 ECO</i>		1500 0008
<i>400 XL</i>		1400 0001
<i>surgiForce</i>	Formed seat	2600 0008
<i>surgiForce light</i>	Formed seat	2600 0009
<i>surgiLine</i>	Formed seat	2200 0008
<i>assistLine</i>		2400 0015
<i>motionLine</i>		1700 0000
<i>motionLine-E</i>		1700 0001

+ Item No.: 3037 0136
+ Item No.: 3037 0...

weiß F6413046 Item No.:053	hellbeige F6413047 Item No.:141	kiesel F6413048 Item No.:158	birke F6413049 Item No.:159	smoke F6413050 Item No.:221
silbergrau F6413075 Item No.:275	platin F6413053 Item No.:161	anthrazit F6413076 Item No.:276	schwarz F6413052 Item No.:170	schoko F6413051 Item No.:160
gletscher F6413055 Item No.:162	sky F6413074 Item No.:277	royal F6413056 Item No.:163	smaragd F6413073 Item No.:278	kaktus F6413077 Item No.:281
feuer F6413058 Item No.:166	kirsche F6413079 Item No.:279	fuchsia F6413078 Item No.:280	mais F6413057 Item No.:164	limone F6413054 Item No.:165

The colours displayed on your device may differ slightly from the original colours. If you wish to receive original colour charts, please contact us at info@ufsk-osys.com.

"Periline"



Product Specification

- Without Phthalates
- Biocompatibility:
Cytotoxicity (EN ISO 10 993-5) and
test for irritation and delayed-type
hypersensitivity (EN ISO 10 993-10)
- Urine resistance
- Blood resistance
- Resistance to perspiration
- Resistance to spitting
- Light fastness
- Color fastness to rubbing
- Flame retardant

<i>surgiForce</i>	Comfort seat	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort seat	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort seat	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort seat	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyPro H</i>		2400 0006
<i>easyPro R</i>		2400 0013
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine H</i>		2400 0021
<i>easyLine R</i>		2400 0022
<i>easyLine Hs</i>		2400 0023
<i>easyLine Rs</i>		2400 0024

+ Item No.: 3037 0...

				
kastanie 015817 Item No.:240	light brown 016037 Item No.:239	creme 015812 Item No.:225	weiß 010881 Item No.:224	stein 015813 Item No.:236
				
saphir 015814 Item No.:231	delft 010766 Item No.:241	antistatisch schwarz Item No.:223	schwarz 011499 Item No.:235	anthracit 016046 Item No.:234
				
azur 015815 Item No.:230	aubergine 016041 Item No.:229	lavendel 016042 Item No.:228	rot 010878 Item No.:238	orange 016040 Item No.:237
				
kiwi 015816 Item No.:233	lime green 016043 Item No.:232	lemon 016039 Item No.:226	safran 010879 Item No.:227	

The colours displayed on your device may differ slightly from the original colours. If you wish to receive original colour charts, please contact us at info@ufsk-osys.com.

Upgrade your OR to perfection.



eyeForce



500 XLE



500 XLE comfort



500 bariatric



500 XLS



500 ECO



400 XL



motionLine



motionLine-E



surgiForce



surgiForce light



surgiTrend



surgiLine



stayClean wipes



stayClean



staySoft



stayClean roll



supportLine



supportLine plus



assistTrend



assistPro F



assistPro H



easyPro F



easyPro H



easyPro R



easyLine F



easyLine H



easyLine R



easyLine Hs



easyLine Rs



assistLine