

Smlouva o výpůjčce 19/Z/13

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
ve smyslu ustanovení § 659 a následujících občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Půjčitel:

název: Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
sídlo: Radiová 1, 102 27 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 134167,
IČ:28233492 DIČ:CZ28233492
zastoupená: jednatelem společnosti ing. Václavem Mádrem
(dále jen „půjčitel“)

a

Vypůjčitel:

název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava,
IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162
zastoupená: ředitelem MUDr. Tomášem Nyklem
*zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve znění usnesení
č. 0366/ZM1014/7 ze dne 27. 4. 2011, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;
registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 168788/2012 ze dne 06.02. 2013 ve znění následných rozhodnutí o registraci
dále jen „vypůjčitel“*

I.

Předmět smlouvy a výpůjčky

1. Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran, na základě které půjčitel přenechá vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání na určeném pracovišti vypůjčitele.
Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem hematologického analyzátoru. Přesné označení přístroje: DxH 800 ,výrobce: Beckman Coulter , Inc. 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 USA, v pořizovací hodnotě pro evidenční účely 2 000 000,- Kč bez DPH, dále jen „předmět výpůjčky“.
2. Předmět výpůjčky je /... ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zdravotnickým prostředkem. V kladném případě je při výpůjčce nutno předat příslušnou dokumentaci předepsanou pro používání zdr. prostředku.
3. Za podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání za účelem provádění hematologických vyšetření na oddělení klinické hematologie.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. **Vypůjčitel** je po dobu trvání výpůjčky povinen:
 - Pověřovat obsluhou předmětu výpůjčky pouze své zaměstnance, kteří jsou k tomu řádně vyškoleni půjčitelem (o čemž je zpracován písemný záznam).
 - Chránit předmět výpůjčky před poškozením, zničením, ztrátou, nadměrným opotřebením nebo zneužitím a provádět běžnou údržbu dle instrukcí půjčitele.
 - Do 10 pracovních dnů po skončení výpůjčky vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebením.
 - Neprodleně informovat půjčitele o všech případech poškození, zničení či ztrátě předmětu výpůjčky.
 - Uhradit půjčiteli škody, které vzniknou na předmětu výpůjčky během trvání výpůjčky s výjimkou obvyklého opotřebením a nezaviněných poruch.
 - Bez zbytečného odkladu nahlásit půjčiteli potřebu opravy předmětu výpůjčky a umožnit mu její provedení.
 - Na pracovišti vypůjčitele předmět výpůjčky převezme: [REDACTED]

2. **Vypůjčitel** není oprávněn:

- Provádět na předmětu výpůjčky jakékoliv technické úpravy
- Předmět výpůjčky nebo jeho část pronajmout nebo jiným způsobem přenechat k užívání jiné osobě.

3. **Půjčitel** je povinen do 45 dnů po podpisu této smlouvy předat vypůjčiteli předmět výpůjčky v provozuschopném stavu spolu s následujícími doklady, kterými osvědčí, že předmět výpůjčky je způsobilý k užívání v ČR pro účel poskytování zdravotní péče ve smyslu příslušných právních předpisů. Současně s předmětem výpůjčky předá půjčitel protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky (předávací protokol), a záznam o zaškolení na formuláři vypůjčitele. Předávací protokol vždy podepíše oprávněná osoba půjčitele a pověřený zaměstnanec oddělení zdravotnické techniky vypůjčitele, spolu s pověřeným zaměstnancem klinického oddělení, které předmět výpůjčky bude užívat.

3.1 V případě předmětu výpůjčky, který byl uveden na trh v některém z členských států Evropské unie a který je opatřený značkou CE ve smyslu vl. nařízení č. 336/2004 Sb., musí být doloženy tiskem i v elektronické podobě tyto doklady:

- kopie prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
- návod k obsluze v českém jazyce ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb., v platném znění,
- Doklad o způsobilosti předmětu výpůjčky k bezpečnému použití při poskytování zdravotnické péče (např. protokol o BTK),
- Protokol o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK. U pevně instalovaných zdravotnických prostředků bude doložena výchozí elektrická revize.

3.2 Vypůjčitel se zavazuje od půjčitele na své náklady zajišťovat spotřební materiál pro provoz movité věci podle článku I. této smlouvy. Seznam spotřebního materiálu včetně cenových ujednání je přílohou 2 této smlouvy.

4. **Půjčitel** je povinen

- zaškolit určené zaměstnance vypůjčitele, kteří budou předmět výpůjčky obsluhovat a pořídit o tom záznam na formuláři vypůjčitele,
- po dobu trvání výpůjčky dle této smlouvy zajišťovat a hradit všechny opravy předmětu výpůjčky, jejichž potřebu mu vypůjčitel oznámí. Půjčitel se zavazuje provádět bezplatně veškeré servisní práce po celou dobu výpůjčky.
- na úhradu ceny opravy má půjčitel právo jen prokáže-li, že nutnost opravy a škoda na předmětu výpůjčky vznikla výlučným zaviněním vypůjčitele,
- pokud bude provoz předmětu výpůjčky vyžadovat užití jednorázových SZM, dodá je půjčitel vypůjčiteli bezplatně v potřebném množství, nebo s ním uzavře samostatnou dohodu o jejich úhradě,
- po ukončení doby výpůjčky převzít zpět předmět výpůjčky, potvrdit jeho vrácení půjčiteli a odvézt od půjčitele,
- doložit při předání předmětu výpůjčky platný protokol o provedení bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů, jejichž provádění vyplývá z obecně závazného právního předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem,
- po dobu trvání smlouvy zajišťovat nebo provádět bezpečnostně technické kontroly, verifikace, kalibrace na předmětu výpůjčky a další servisní úkony vyplývající z obecně závazného právního předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem. Protokoly nebo zprávy o provedení těchto bezpečnostně technických kontrol, verifikací, kalibrací bude půjčitel bez zbytečného odkladu zasílat pověřenému zaměstnanci oddělení zdravotnické techniky vypůjčitele.

III.

Doba výpůjčky

Výpůjčka se sjednává na dobu pět let od data instalace po podpisu smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná sepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu výpůjčky podle čl. II. smlouvy.
- 2) Platnost smlouvy končí a výpůjčka podle smlouvy zaniká
 - uplynutím doby, na kterou byla výpůjčka sjednána,
 - výpovědí – výpověď může podat každá ze smluvních stran z jakýchkoliv důvodů nebo bez uvedení důvodů. Výpověď musí být podána písemně a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi,
 - dohodou obou smluvních stran uzavřenou v písemné formě,
 - z ostatních obecných důvodů zániku závazků podle občanského zákoníku.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4) Změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran, který musí být učiněn písemně ve formě dodatků, číselovaných v chronologickém pořadí. Smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 5) Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem smlouvy, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

22 -07- 2013

V Ostravě dne
Vypůjčitel

.....
MUDr. Tomáš Nykel
ředitel MNO


.....
.....
.....
.....
.....

- 4 -07- 2013

V Praze dne
Půjčitel

.....
Ing. Václav
jednatel společnosti

.....
.....
.....
.....
.....


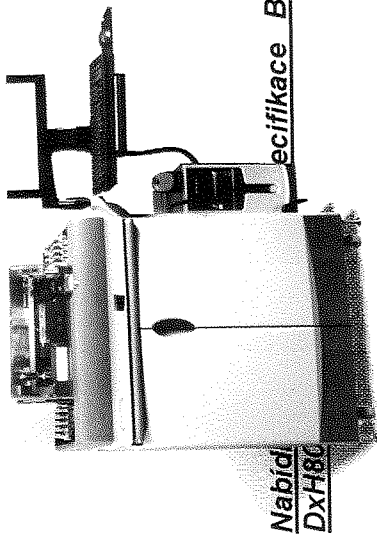



Nabídka
DxH800


specifikace BECKMAN COULTER



Technický popis DxH 800

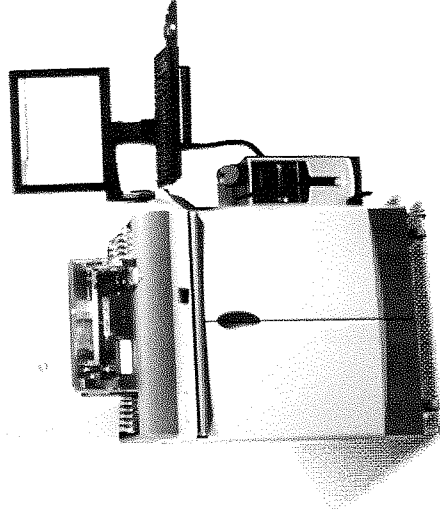





HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY BECKMAN COULTER
Reagencie DxH800 Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

PN	Název	CENA (Kč)
----	-------	-----------

Kontroly pro přístroje Coulter DxH800

628027	COULTER 6C Cell Control (12ks)	4 000,00
628028	COULTER Retic-X Cell Control	3 500,00

Reagencie pro přístroje DxH800

628017	FP,DxH Diluent, 10L	800,00
628018	FP,DxH Cell Lyse, 1L	2 500,00
628020	FP,DxH Diff Pack	12 000,00
628021	FP,DxH ReticPack	10 000,00
628022	FP,DxH Cleaner, 5L	1 900,00

Další spotřební materiál

baterie do UPS	jiný dodavatel
toner do tiskárny	jiný dodavatel

ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednávky a informace o dodávkách:

Obchodní oddělení

tel. [REDACTED]

[REDACTED]

HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY BECKMAN COULTER
Reagencie DxH800 Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

PN	Název	CENA (Kč)
----	-------	-----------

Kontroly pro přístroje Coulter DxH800

628027	COULTER 6C Cell Control (12ks)	4 000,00
628028	COULTER Retic-X Cell Control	3 500,00

Reagencie pro přístroje DxH800

628017	FP,DxH Diluent, 10L	800,00
628018	FP,DxH Cell Lyse, 1L	2 500,00
628020	FP,DxH Diff Pack	12 000,00
628021	FP,DxH ReticPack	10 000,00
628022	FP,DxH Cleaner, 5L	1 900,00

ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednávky a informace o dodávkách:

Obchodní oddělení

te

fa