

**DODATEK K SMLouvĚ NA PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO SERVISU
 ÚPRAVEN VODY GORO
 PRO ROK 2022 A DÁLE DO ODVOLÁNÍ**

Uživatel	Městská nemocnice Ostrava, p.o. - Fifejdy	Číslo: 2322022
Adresa	Nemocniční 20, 728 80 Ostrava	
IČ, DIČ	00635162	
Kontaktní osoba, tel.	[REDACTED]	


Firma GORO, spol. s r.o., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležitě provozní zabezpečení kompletů na přípravu velmi čisté vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „Přehled nezbytného spotřebního materiálu“.

Oddělení / pracoviště / uživatel v rámci organizace	Roční náklady v Kč	DPH
022 OKB	31.400,-	21%
023 centrální sterilizace	13.000,-	21%
		21%
Souhrn veškerých pracovišť	44.400,-	21%

Poskytovatel provozního zabezpečení:

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály.

V Cráštanech, dne 24.10.2022,




Majitel a provozovatel zařízení:

Souhlasíme s předloženou cenovou nabídkou a objednáme provozní zabezpečení. Objednávka se sjednává pro rok 2022 a dále do odvolání.

V Ostravě dne 11.11.2022

Podpis, razítko

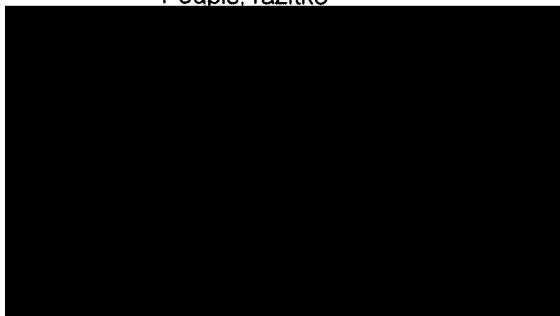

NEMOCNICE !!!
Č.j.MNOF/ 38841
Datum: 11-11-2022
100 008 187

ČESKÝ VÝROBCE CERTIFIKOVANÝCH ÚPRAVEN VODY - založeno 1991
GORO, spol. s r.o. Chrášťany 50 282 01 Chrášťany

Tel. [REDACTED] z, servis@goro.cz

IČ: 44265557, DIČ: CZ44265557, Firma je zapsána v Obch. rejstříku Měst. soudu v Praze 12.11.1991, odd.C, vložka 4982



PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2022 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času.


Uživatel	Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Fifejdy - OKB	IC	00635162	číslo	022
Typ úpravy	GORO MID 50	Účel použití	laboratoř		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	3 měsíce				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"	2	400,-	800,-
2	GAC aktivní uhlí blok 20"	1	900,-	900,-
3	Náplň DEMI ionex v litrech	50	80,-	4.000,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km	110	Cena za 1 km	15.-	Celkem bez DPH	1.650,-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	500.-	Celkem bez DPH	500.-
Čas strávený jízdou		Cena za 1 hod	300.-	Celkem bez DPH	
Celková cena jednoho provozního servisu			7.850,- Kč + 21% DPH		
Celkové roční provozní náklady			31.400,- Kč + 21% DPH		



ČESKÝ VÝROBCE CERTIFIKOVANÝCH ÚPRAVEN VODY - založeno 1991
Goro, spol. s r.o., Chrášťany 50, 282 01 Chrášťany

Tel. [redacted]

oro.cz

IČ: 44265557, DIČ: CZ44265557, Firma je zapsána v Obch. rejstříku Měst. soudu v Praze 12.11.1991, odd.C, vložka 4982



PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2022 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravní vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času.

Uživatel	Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Fifejdy - CS	IC	00635162	číslo	023
Typ úpravní	GORO MID 300	Účel použití	sterilizace		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	3 měsíce				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"	2	400,-	800,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km	110	Cena za 1 km	15,-	Celkem bez DPH	1.650,-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	500,-	Celkem bez DPH	500,-
Čas strávený jízdou	1	Cena za 1 hod	300,-	Celkem bez DPH	300,-
Celková cena jednoho provozního servisu			3.250,- Kč + 21% DPH		
Celkové roční provozní náklady			13.000,- Kč + 21% DPH		

