

Technická specifikace - na jeden rok									
Předpokládaná potřeba zboží									
pořadové číslo položky	Požadovaný produkt	Obchodní název produktu v katalogu uchazeče	číslo zboží v katalogu uchazeče	měrná jednotka	předpokládaný odběr m.j. za 1 rok	Sazba DPH %	nabídková cena za jeden rok		Poznámka
							jednotková bez DPH	celkem bez DPH	
Část 04 - Detekce DNA původců purulentních meningitid metodou real-time PCR			CELKEM ZA SKUPINU		150	30 232,50 Kč			
0401	Diagnostická souprava pro detekci DNA Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae								
0402	Diagnostická souprava pro detekci DNA Listeria monocytogenes								


Cena za dodávku (bez DPH) - celkem						30 232,50 Kč	OK	
Částka DPH - základní sazba - celkem						6 348,83	6 348,83	
Částka DPH - snížená sazba - 15%						0,00	0,00	
90000	Částka DPH - snížená sazba - 10%						0,00	0,00
Celková hodnota s DPH za dodávku						36 581,33 Kč		

Poznámka:

- 1) u číselných hodnot specifikace je přípustěna tolerance $\pm 10\%$, není-li uvedeno jinak
- 2) dodavatel nabídku
 - a) doplní sloupce "D" a "E" podle uvážení, **povinně** vyplní tyto údaje do přílohy A a přílohy C **kupní smlouvy**
 - b) povinně vyplní sloupce "H" (sazba DPH v % - výběrem z rozbalovací nabídky) a "I" (jednotková cena bez DPH) pro jednotlivé položky
 - c) uvede do sloupce "K" případnou vysvětlující poznámku (s možností upravit výšku řádku)
- 3) údaje do dalších záložek přílohy se přenesou automaticky, dodavatel je povinen provést kontrolu správnosti; v případě nejasností a problémů - požádat zadavatele o vysvětlení či doplnění
- 4) zadavatel připouští nabídnout dodávku i jiného balíčního množství (uvést v poznámce); j.c. bude stanovena přepočtem k uvedenému požadovanému množství testů
- 5) zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové ceny byly i další veškeré nezbytné reagentie
- 6) budou-li pro jednotlivá vyšetření nezbytné i další reagentie (nezahrnuté v dodávce diagnostik pro jednotlivé testy) doplní jejich přehled do samostatné přílohy nabídky (číslo 10)

Dne: 19.10.2022

Zpracoval / podpis:

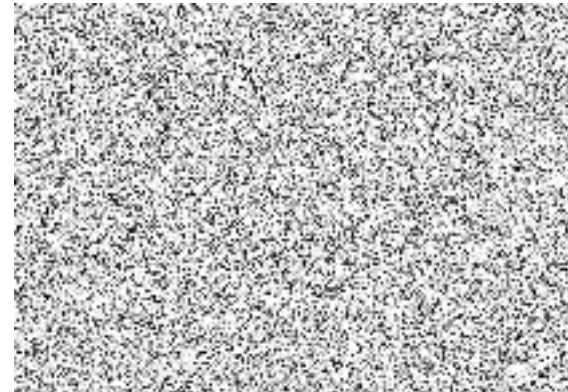

Technická specifikace za období trvání smlouvy								
Předpokládaná potřeba zboží								
pořadové číslo položky	Obchodní název produktu v katalogu uchazeče	Obchodní název produktu v katalogu uchazeče	číslo zboží v katalogu uchazeče	měrná jednotka	předpokládaný odběr za dobu smlouvy v letech 2	Sazba DPH %	nabídková cena	
							Cena za jednotku bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
	Část 04 - Detekce DNA původců purulentních meningitid metodou real-time PCR		CELKEM ZA SKUPINU		300	60 465,00 Kč		
0401	Diagnostická souprava pro detekci DNA Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae							
0402	Diagnostická souprava pro detekci DNA Listeria monocytogenes							


Cena za dodávku (bez DPH) - celkem								60 465,00 Kč
Částka DPH - základní sazba - celkem						12 697,65		12 697,65
Částka DPH - snížená sazba - celkem						0,00		0,00
Celková hodnota s DPH za dodávku								73 162,65 Kč

Poznámka:

Dne:

středa 19. říjen 2022

Zpracoval / podpis:

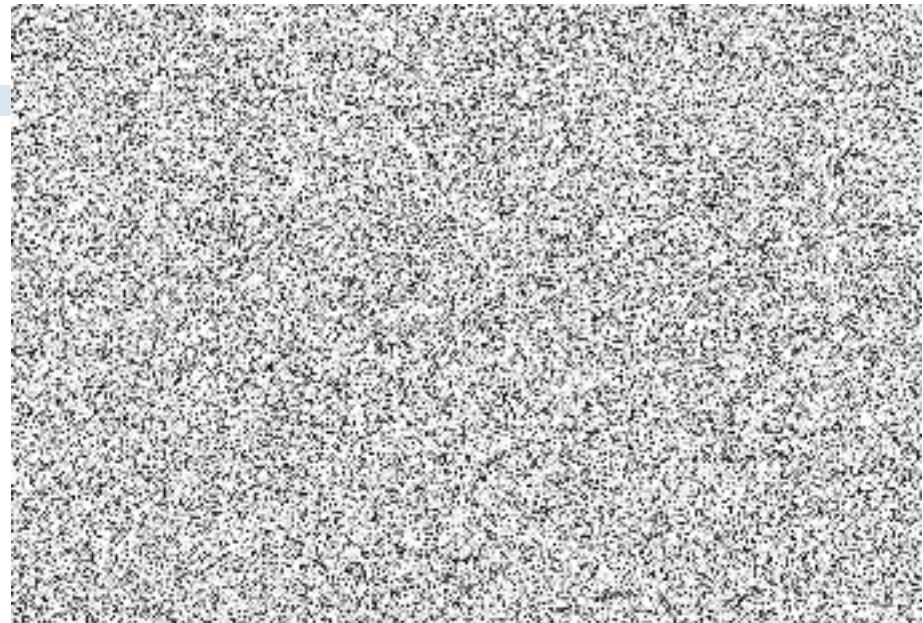


Technická specifikace za období trvání smlouvy								
Předpokládaná potřeba zboží								
pořadové číslo položky	Obchodní název produktu v katalogu uchazeče	Obchodní název produktu v katalogu uchazeče	číslo zboží v katalogu uchazeče	měrná jednotka	předpokládaný odběr za dobu smlouvy v letech	Sazba DPH %	nabídková cena	
							Cena za jednotku bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
	Část 04 - Detekce DNA původců purulentních meningitid metodou real-time PCR		CELKEM ZA SKUPINU			60 465,00 Kč		
0401	Diagnostická souprava pro detekci DNA Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae							
0402	Diagnostická souprava pro detekci DNA Listeria monocytogenes							

Cena za dodávku (bez DPH) - celkem							60 465,00 Kč
Částka DPH - základní sazba - celkem						12 697,65	12 697,65
Částka DPH - snížená sazba - celkem						0,00	0,00
Celková hodnota s DPH za dodávku							73 162,65 Kč

Poznámka:

Dne:
středa 19. říjen 2022

Zpracoval / podpis:

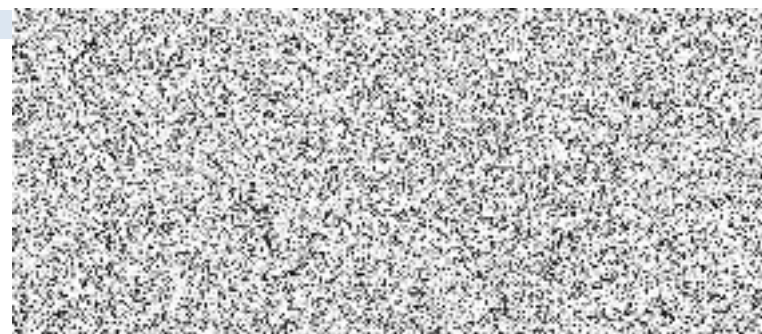

ZUUL – diagnostika pro pracoviště molekulární biologie 2022

Jednotkové ceny pro veřejnou zakázku					
Předpokládaná potřeba zboží					
pořadové číslo položky	Obchodní název produktu v katalogu uchazeče	číslo zboží v katalogu uchazeče	měrná jednotka	Sazba DPH %	nabídková cena
					Cena za jednotku bez DPH v Kč
Část 04 - Detekce DNA původců purulentních meningitid metodou real-time PCR					
0401	AmpliSens® N. meningitidis/H. influenzae/S. pneumoniae-FRT				
0402	AmpliSens® Listeria monocytogenes-screen/monitor-FRT PCR kit variant FRT-50 FN				

Poznámka:

Dne:

středa 19. říjen 2022

Zpracoval / podpis:

