

**Cenový návrh číslo:  
51776692/14471**ze dne: 11.07.2022  
platný do: 09.09.2022Číslo Vaší objednávky:  
250/2/2022Domažlická nemocnice, a.s.  
Interní oddělení - GEA

Kozinova 292

.....  
344 22 DomažlicePRACOVÍŠTĚ: Interní oddělení - GEA  
PŘÍSTROJ: videokolonoskop

DATUM INSTALACE: 23.11.2018

TYP: CF-H190L

VÝROBNÍ Č. : 2742451

**NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY  
PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:**


- poškozené vodící bovdeny lanka ovládání ohebné části ("cvakání")
- odštíplé hrany světlovodných čoček
- prasklá krytka distálního konce
- prasklý jistící segment lanka ovládání ohebné části

**S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :**

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu světlovodných čoček - 2x
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části
- výměnu jistícího segmentu lanka ovládání
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládání

**CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 149 076 Kč****CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% ..... 180 382 Kč**Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.  
Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

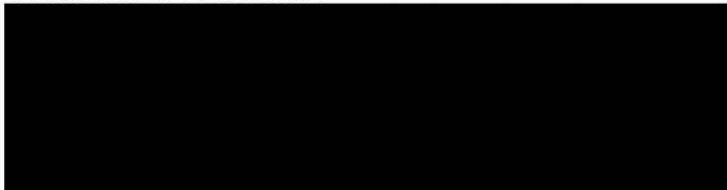

DNE:

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY  
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: .....

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

**OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU**