


Příloha č.1: Technická specifikace předmětu plnění

Digitální hrudní drenážní systémy ATMOS

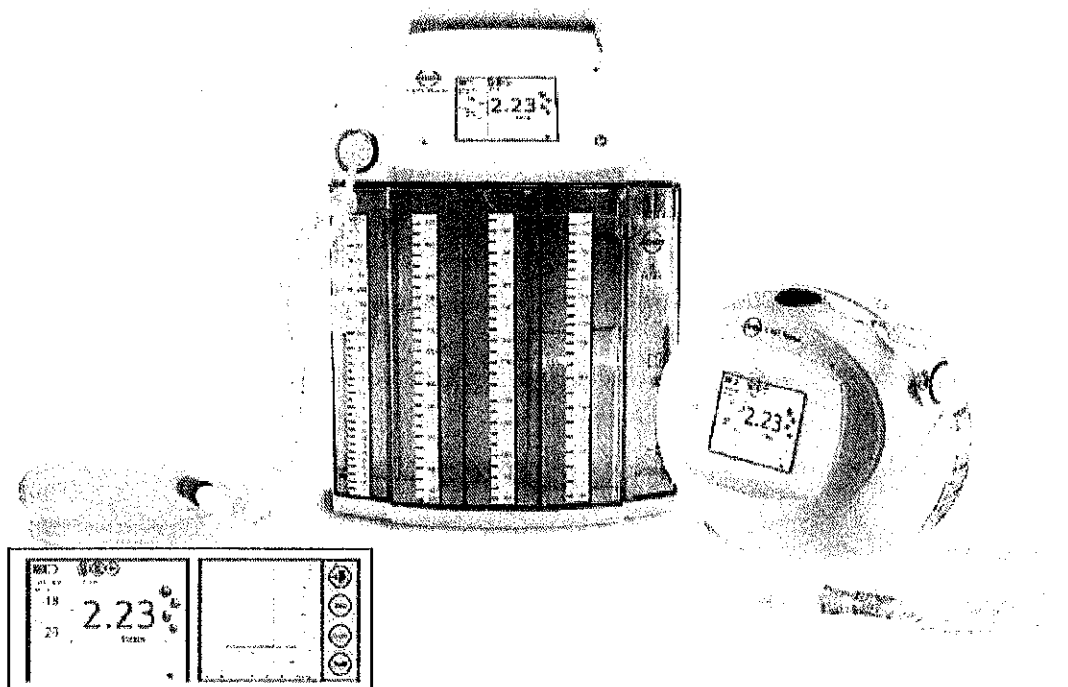

- Široká možnost využití – kardiochirurgie, plicní a hrudní chirurgie, emergency, intenzivní medicína
- Digitálně kontrolovaný průtok a sání s tichým provozem
 - Intuitivní ovládání přes dotykový LCD displej
 - Dvouhadíčkový set – 1x pro měření podtlaku, 1x pro proplach
 - Regulace podtlaku přímo v místě zákroku, ne pouze v přístroji, díky tomu dochází k eliminaci sifonového efektu
 - Objektivní terapeutická data v reálném čase
 - Automatické proplachování hadice zamezuje vytváření usazení a chybné interpretaci výsledků
 - Nezávislý na připojení k centrálnímu podtlaku, podporuje mobilitu pacienta
 - Přináší úsporu pracovní doby pro personál, zkrácení doby pro aplikaci drenáže, zkrácení pobytu pacienta na lůžku a obecně úspory v nemocniční péči
 - Možnost ukládání dat na USB klíč ve formátu PDF a Excel

Technické parametry	C 051 Thorax	S 201 Thorax
Max. sací výkon	5+/- 0,5l/min.	18+/- 2,0l/min.
Podtlak (nastavitelný)	-5 až -100 mbar	-5 až -100 mbar
Nádoba na sekret	800 ml	2000 ml
Provoz na baterii	Max. 16h.	Max. 12h.
Grafické zobrazení trendů zpětně	60 minut až 12 dní	60 minut až 12 dní
Hmotnost v Kg (vč. nádoby na sekret)	1,3kg	3,7kg
Rozměry ŠxVxH mm	164x206x95mm	366x250x168mm
Hladina hluku	34dB	31dB

Příloha č.2: Podrobná technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění

Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OUII	
Část 3	

<p>Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené podmínky a parametry specifikace. U parametrů vyznačených minimálními nebo maximálními hodnotami nebo rozsahem hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň itažovému požadovanému úrovní.)</p>	<p>Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozsah rozsahu/výkonnosti apod., je nutné uvést konkrétní hodnotu, která jim nabízené věci dosahuje. Má se na to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jim nabízené věci dosahuje uvedené udáváním ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model : typová výrobní označení a výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení a výrobce. Účastník uvedení hodnoty zanechává.)</p> <p>Zádejní uvedených účastníkem musí být zároveň, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické podmínky stanovené udáváním. Účastník uvede splnění požadovaného parametru originálním způsobem, například konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)</p>
--	---

Položka č. 3 Hrudní sání	Model - typová výrobní označení	Výrobce
	C 051 Thomax	ATMOS Medizintechnik GmbH
Počet kusů: 1 ks	Účastníkem nabízená hodnota	
Přístroj je provozován elektromotorickým, bezdráhovým čerpadlem		ANO
Display se zobrazuje vakuu.		ANO
Možnost uchování dat minimálně 10 dní zápisem.		ANO
Sací hadice s integrovaným bakteriálním filtrem		ANO
Minimální délka sací hadice 170 cm		ANO
Technické parametry:		
- nominální kapacita 700 ml		800 ml
- nominální požadavky na usměrň 230 V~, 50/60 Hz		ANO
- vestavěná dobijecí baterie s kapacitou minimálně 2000 mAh,		ANO (provoz až 16 hod.)
- displej s rozlišením číselného vakuu a skutečného vakuu v mbar nebo kPa		ANO
- nominální hmotnost 4 kg		ANO, 1,35 kg
- nominální hluková hladina při normálním provozu		ANO, <34 dBA

Celková nabídková cena veřejné zakázky:				
Položka	Počet kusů	Celková nabídková cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
3. Hrudní sání	1	97 100,- Kč	20 391,- Kč	117 491,- Kč
Nabídková cena VZ CELKEM		97 100,00 Kč	20 391,00 Kč	117 491,00 Kč