

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
ve smyslu ustanovení § 2193 a následujících občanského zákoníku zák.č. 89/2012 Sb.
(dále jen „smlouva“)

BAXTER CZECH spol. s r.o.

sídlo: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5

IČ: 49689011 DIČ: CZ49689011

zastoupená: PharmDr. Danielelem Feriancem, Ing. Petrou Rejzlovou,
Ing. Jiřím Michalíkem-jednateli

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
23921 ,

(dále jen „**půjčitel**“)

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava,

IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162

Zastoupená: ~~Stanislavem Saksou, pověřeným zastupováním funkce ř~~ ředitelem

MUDr. Petrem Uhligem

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění
usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná
v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 102898/2015 ze dne
19.8.2015 ve znění následných rozhodnutí o registraci

(dále jen „**vypůjčitel**“)

I.

Předmět smlouvy a výpůjčky

1. Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran, na základě které půjčitel přenechá vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání na určeném pracovišti vypůjčitele.
2. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu výpůjčky:
 - 4 ks odpařovačů Desflurane **Tec 6 Plus**. Přesné označení přístroje: **Odpařovač Tec 6 Plus** s příslušenstvím, výrobce: Datex-Ohmeda, Inc., Ohmeda Drive, P.O. Box 7550, Madison, WI 53707-7550, USA, země původu/výroby: USA, v pořizovací hodnotě/pro evidenční účely: 89 190,- Kč bez DPH a
 - 1 ks odpařovače Isoflurane Penlon Sigmadelta. **Odpařovač Penlon** s příslušenstvím, výrobce: Penlon, Inc. 11515 K-Tel Drive Minnetonka MN 55343, USA země původu/výroby: USA, v pořizovací hodnotě/pro evidenční účely: 30 000, Kč bez DPH, dále jen „předmět výpůjčky“.
3. Odpařovače plní níže uvedené minimální technické požadavky:
 - přesné koncentrace anestetika za měnících se podmínek průtoku a teploty

- bezpečné plnění
 - uchycení na narkotizační přístroje.
4. Předmět výpůjčky je ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů zdravotnickým prostředkem. Půjčitel je zavázán předat příslušnou dokumentaci předepsanou pro používání tohoto zdravotnických prostředku.
 5. Za podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání za účelem poskytování zdravotních služeb na ARO oddělení vypůjčitele. (*provádění vyšetření, výkonů apod.*).
 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmětem výpůjčky jsou nové nebo použité plně funkční přístroje, které splňují technické požadavky výrobce daného zařízení a zákona č. 268/2014 Sb., a na které se vztahují záruční podmínky, se kterými bude vypůjčitel v plném rozsahu seznámen.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. **Půjčitel** se zavazuje po podpisu této smlouvy předat vypůjčiteli předmět výpůjčky v bezvadném stavu spolu se všemi předepsanými a nezbytnými doklady, kterými osvědčí, že předmět výpůjčky je způsobilý k užívání v ČR pro účel poskytování zdravotní péče ve smyslu příslušných právních předpisů. Současně s předmětem výpůjčky předloží půjčitel protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky (předávací protokol), dále také záznam o zaškolení zaměstnanců na formuláři vypůjčitele. Předávací protokol vždy podepíše oprávněná osoba půjčitele a pověřený zaměstnanec oddělení BMI vypůjčitele, spolu s pověřeným zaměstnancem pracoviště/klinického oddělení, které předmět výpůjčky bude užívat.
 - Na pracovišti vypůjčitele předmět výpůjčky převezme: vrchní sestra na oddělení
- 1.1. V případě předmětu výpůjčky, který byl uveden na trh v některém z členských států Evropské unie a který je opatřený značkou CE ve smyslu vl. nařízení č. 336/2004 Sb., musí být doloženy tiskem i v elektronické podobě tyto doklady:
 - kopie prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
 - návod k obsluze v českém jazyce ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - Doklad o způsobilosti předmětu výpůjčky k bezpečnému použití při poskytování zdravotnické péče (např. protokol o BTK),
 - Protokol o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK. U pevně instalovaných zdravotnických prostředků bude doložena výchozí elektrická revize.
- 1.2. V případě předmětů výpůjčky, které nebyly uvedeny na trh v některém z členských států Evropské unie a nemají značku CE ve smyslu vl. nařízení č. 336/2004 Sb., avšak mohou být uváděny do provozu dle přechodných ustanovení vl. nař. č. 336/2004 Sb., musí být doloženy tyto doklady:
 - kopie prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., příslušných vládních nařízení (vl. nař. č. 336/2004 Sb., vl. nař. 25/2004 Sb. a vl. nař. 181/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů
 - kopie certifikátu české notifikované osoby, která se podílela na posuzování shody,

- kopie závěrečné zprávy o klinickém hodnocení
- návod k obsluze v českém jazyce ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Doklad o způsobilosti předmětu výpůjčky k bezpečnému použití při poskytování zdravotnické péče (např. protokol o BTK)
- Protokol o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK. U pevně instalovaných zdravotnických prostředků bude doložena výchozí elektrická revize.

2. **Půjčitel** je povinen dodat:

- Instalační protokol potvrzující, že dodaný přístroj (sestava) je instalován v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou a pokyny výrobců a je funkční a bezpečný pro poskytování zdravotní péče.
- Instalační protokol bude obsahovat (např. formou přílohy):
 - a) Protokoly o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK vč. Uvedení naměřených hodnot v souladu s normou ČSN EN 62353 /nejlépe formou přílohy G této normy/ (zkouška před uvedením do provozu) pro všechny jednotlivé dílčí zdravotnické prostředky, u nichž jsou pravidelné BTK výrobcem předepsány.
 - b) Zdokumentování propojení jednotlivých zdravotnických přístrojů navzájem resp. propojení zdravotnický přístrojů s nezdravotnickými prostředky vč. příslušenství, bylo-li nějaké takové propojení v souvislosti s instalací resp. dodáním předmětu smlouvy vytvořeno.
 - c) Měřené hodnoty ME systému dle normy ČSN EN 62353, pokud byl v souvislosti s realizací předmětu smlouvy vytvořen.

3. **Půjčitel** je povinen

- zaškolit určené zaměstnance vypůjčitele, kteří budou předmět výpůjčky obsluhovat a pořídit o tom záznam na formuláři vypůjčitele,
- po dobu trvání výpůjčky dle této smlouvy zajišťovat a hradit všechny opravy předmětu výpůjčky, jejichž potřebu mu vypůjčitel oznámí. Půjčitel se zavazuje provádět bezplatně veškeré servisní práce po celou dobu výpůjčky,
- odstraňovat vady nejpozději **do 24 hodin** od uplatnění oprávněné reklamace vypůjčitele a vady odstranit v co nejkratším možném termínu,
- v případě opravy trvající déle než **24 hodin** bude odpařovač nahrazen náhradním odpařovačem a následně provedena výměna za opravený odpařovač,
- v případě nedodržení termínů na odstranění vad je vypůjčitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý další i jen započatý den,
- na úhradu ceny opravy má půjčitel právo jen prokáže-li, že nutnost opravy a škoda na předmětu výpůjčky vznikla výlučným zaviněním vypůjčitele,
- pokud bude provoz předmětu výpůjčky vyžadovat užití jednorázových SZM, dodá je půjčitel vypůjčiteli bezplatně v potřebném množství, nebo s ním uzavře samostatnou dohodu o jejich úhradě,
- po ukončení doby výpůjčky převzít zpět předmět výpůjčky, potvrdit jeho vrácení půjčiteli a odvézt od půjčitele,
- doložit při předání předmětu výpůjčky platný protokol o provedení bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů, jejichž provádění vyplývá z obecně závazného právního předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem,

- po dobu trvání smlouvy zajišťovat nebo provádět bezpečnostně technické kontroly, verifikace, kalibrace na předmětu výpůjčky a další servisní úkony vyplývající z obecně závazného právního předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem. Protokoly nebo zprávy o provedení těchto bezpečnostně technický kontrol, verifikací, kalibrací bude půjčitel bez zbytečného odkladu zasílat pověřenému zaměstnanci oddělení zdravotnické techniky vypůjčitele.
4. **Vypůjčitel** je po dobu trvání výpůjčky povinen:
- Pověřovat obsluhou předmětu výpůjčky pouze své zaměstnance, kteří jsou k tomu řádně zaškoleni půjčitelem (o zaškolení bude zpracován písemný záznam).
 - Chránit předmět výpůjčky před poškozením, zničením, ztrátou, nadměrným opotřebením nebo zneužitím a provádět běžnou údržbu dle instrukcí půjčitele.
 - Do 10 pracovních dnů po skončení výpůjčky vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebením.
 - Neprodleně informovat půjčitele o všech případech poškození, zničení či ztrátě předmětu výpůjčky.
 - Uhradit půjčiteli škody, které vzniknou na předmětu výpůjčky během trvání výpůjčky s výjimkou obvyklého opotřebením a nezaviněných poruch.
 - Bez zbytečného odkladu nahlásit půjčiteli potřebu opravy předmětu výpůjčky a umožnit mu její provedení.
5. **Vypůjčitel** není oprávněn:
- Provádět na předmětu výpůjčky jakékoliv technické úpravy
 - Předmět výpůjčky nebo jeho část pronajmout nebo jiným způsobem přenechat k užívání jiné osobě.
6. **Vypůjčitel** se zavazuje od půjčitele na své náklady zajišťovat spotřební materiál pro provoz předmětu výpůjčky podle článku I. této smlouvy.

III.

Doba výpůjčky

Výpůjčka se sjednává na dobu účinnosti kupní smlouvy o dodávkách inhalačních anestetik uzavřené s půjčitelem na dobu 48 měsíců, dle výsledku zadávacího řízení na dodávku léčivých přípravků, které jsou aplikovány za použití zapůjčených odpařovačů.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná sepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu výpůjčky podle čl. II. smlouvy.
2. Platnost smlouvy končí a výpůjčka podle smlouvy zaniká
 - uplynutím doby, na kterou byla výpůjčka sjednána,
 - výpovědí – výpověď může podat každá ze smluvních stran z jakýchkoliv důvodů nebo bez uvedení důvodů. Výpověď musí být podána písemně a

- doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi,
- dohodou obou smluvních stran uzavřenou v písemné formě,
 - z ostatních obecných důvodů zániku závazků podle občanského zákoníku.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran, který musí být učiněn písemně ve formě dodatků, číslovaných v chronologickém pořadí. Smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem smlouvy, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Příloha č. 1: Specifikace zapůjčených odpařovačů(vč. , typ apod.)

V Praze dne 2016 03-08-2016
půjčitel
BAXTER CZECH spol. s r.o.




V Ostravě dne 12.8. 2016
vypůjčitel
**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

erianc

~~Stanislav Saksa~~
~~pověřen zastupováním funkce~~
~~ředitele~~

MUDr. Petr Uhlig
ředitel




PŘÍLOHA č. 1

Specifikace předmětu vypůjčky :

4 ks odpařovač Tec 6 Plus s příslušenstvím, výrobce: Datex-Ohmeda, Inc., Ohmeda Drive, P.O. Box 7550, Madison, WI 53707-7550, USA, země původu/výroby: USA, v pořizovací hodnotě/pro evidenční účely: 89 190,- Kč bez DPH.

1 ks odpařovač Penlon s příslušenstvím, výrobce: Penlon, Inc. 11515 K-Tel Drive Minnetonka MN 55343, USA země původu/výroby: USA, v pořizovací hodnotě/pro evidenční účely: 30 000, Kč bez DPH.

V Praze dne 03-08-2016 2016
prodávající
BAXTER CZECH spol. s r.o.

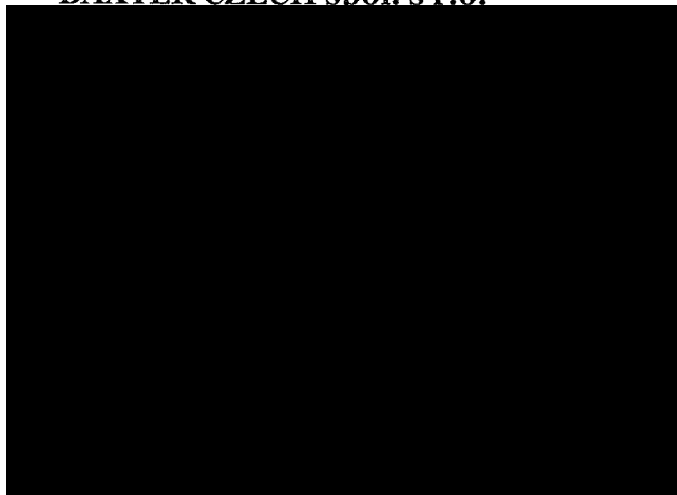

V Ostravě dne 12.8. 2016
kupující
**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**



~~Stanislav Saks~~
~~pověřen zastu~~
~~ředitele~~

MUDr. Petr Uhlíř
ředitel

