

Kupní smlouva

UTB – DNS laboratorní přístroje a měřicí technika 11/2023 – Analyzátor bioplynu II

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO:

70883521

DIČ:

CZ70883521

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu:

[REDACTED]

ID datové schránky:

ahqj9id

zastoupená:

Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem
agendy kvestora

za věcné plnění odpovídá:

[REDACTED]

(dále jen „*kupující*“)

a

MRU s.r.o.

se sídlem:

Plzeňská 313/217c, 150 00 Praha 5 - Motol

IČO:

27110524

DIČ:

CZ27110524

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

jednající:

Ing. Tomáš Folprecht

registrace:

Zápis do VR u Městského soudu v Praze

v oddílu C, vložka 97002

e-mail:

info@mru.cz

ID datové schránky:

vhbnysr

kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Folprecht

(dále jen „*prodávající*“)



utbzsc126a9b

Č.j.: S-UTB/23/017792

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení (viz. čl. III. smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.
- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí **analyzátor bioplynu** (dále jen „věc“), pořizovaný pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků.

Název položky	počet	cena za kus bez DPH
Analyzátor bioplynu	1 ks	113000,-Kč

Cena věci:

Celkem bez DPH: 113000,-Kč

21% DPH: 23730,-Kč

Celkem s DPH: 136730,-Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc sedm set třicet korun českých)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním do laboratoře v NP budovy určené kupujícím, odevzdáním kupujícímu a předáním veškeré související dokumentace (především návod na obsluhu zařízení v českém i anglickém jazyce). Věc bude dodána řádně zabalená v zalepených krabicích. O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je [REDACTED] oprávněný zástupce prodávajícího je Ing. Tomáš Folprecht.
- 2) Prodávající je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) Místem plnění (dodání věci) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů, tř. T. Bati 5678, 760 01 Zlín.
- 4) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději do **6 týdnů od účinnosti smlouvy**.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu protokolu. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
 - název zakázky: UTB – DNS laboratorní přístroje a měřicí technika 11/2023 – Analyzátor bioplynu II, ID 2125
 - označení předmětu plnění,
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 5) Platby budou probíhat výhradně v **Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „**záruka**“).
- 3) Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí **24 měsíců** od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.

- 7) Reklamací odešle kupující písemně na adresu sídla prodávajícího, datovou zprávou dle příslušného právního předpisu či e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž volba způsobu oznámení reklamace přísluší kupujícímu. V reklamaci musí být vada popsána včetně toho, jak se projevuje.
- 8) Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, přičemž pro vyloučení pochybností spolu oprávnění zástupci smluvních stran přesnou délku takové lhůty dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, je prodávající povinen reklamovanou vadu odstranit do 15 dní od doručení reklamace, a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíší smluvní strany zápis.
- 9) Záruční opravy budou poskytovány dodavatelem věci, výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy MRU s.r.o., Plzeňská 313/217c, 150 00 Praha 5 – Motol, info@mru.cz.
- 10) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 11) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.
- 12) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu k předmětu koupě pozáruční servis, a to po dobu **60 měsíců** s tím, že prodávající garantuje to, že budou k dispozici náhradní díly. Pozáruční servis bude fakturován dle této smlouvy za standardních cenových podmínek prodávajícího v okamžiku realizace servisního zásahu. Cena pozáručního servisu není součástí ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny věci včetně DPH za každý započatý den prodlení maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 8 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Poruší-li jakákoli strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvidala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající prohlašuje, že nenaplnuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 3) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 4) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – podrobná technická specifikace věci, příloha č. 2 – Informace pro dodavatele.

Ve Zlíně dne: 1. 8. 2023
Za kupujícího:

V Praze dne: 1. 8. 2023
Za prodávajícího:


.....
Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora UTB
ve Zlíně

.....
Ing. Tomáš Folprecht

(podepsáno elektronicky)

Odpovídá	Datum
PO/OO	31.7.23
EO	1.8.23
Věcně	1.8.23
Správa rozpočtu	2.8.23

11 425 - UB - Dus AP
11/2023 - ANALYZATOR BIOALUMIN




since 1984

EMISSION MONITORING SYSTEMS

CH₄ | CO₂ | H₂S | O₂ | H₂ | N₂ | CO | NO | NO₂ | NO_x

OPTIMA Biogas

Professional rugged handheld biogas analyzer.



For fast gas analysis at biogas, biomethane and landfill plants.



OPTIMA Biogas


Multi-use handheld device for fast control measurements

With OPTIMA Biogas we offer you additionally measurement of biogas pressure and temperature, gas flow velocity, with normalized flow rate calculation.

OPTIMA Biogas may measure, given an appropriate sensor configuration, C-P engine exhaust gases as well.


These are your special advantages:

- Biogas measurement: CH_4 , CO_2 , O_2 , H_2S
- Exhaust gas measurement: O_2 , CO_2 , CO , NO , NO_2
- Ambient air measurement: CH_4 , H_2O , H_2S
- Different measuring units settable by user
- Intuitive menu navigation with function keys
- Glass fiber reinforced enclosure with fixing magnets
- High volume data memory with interface to App and PC software
- Strong, Lithium-Ion battery for at least 15 h continuous operation

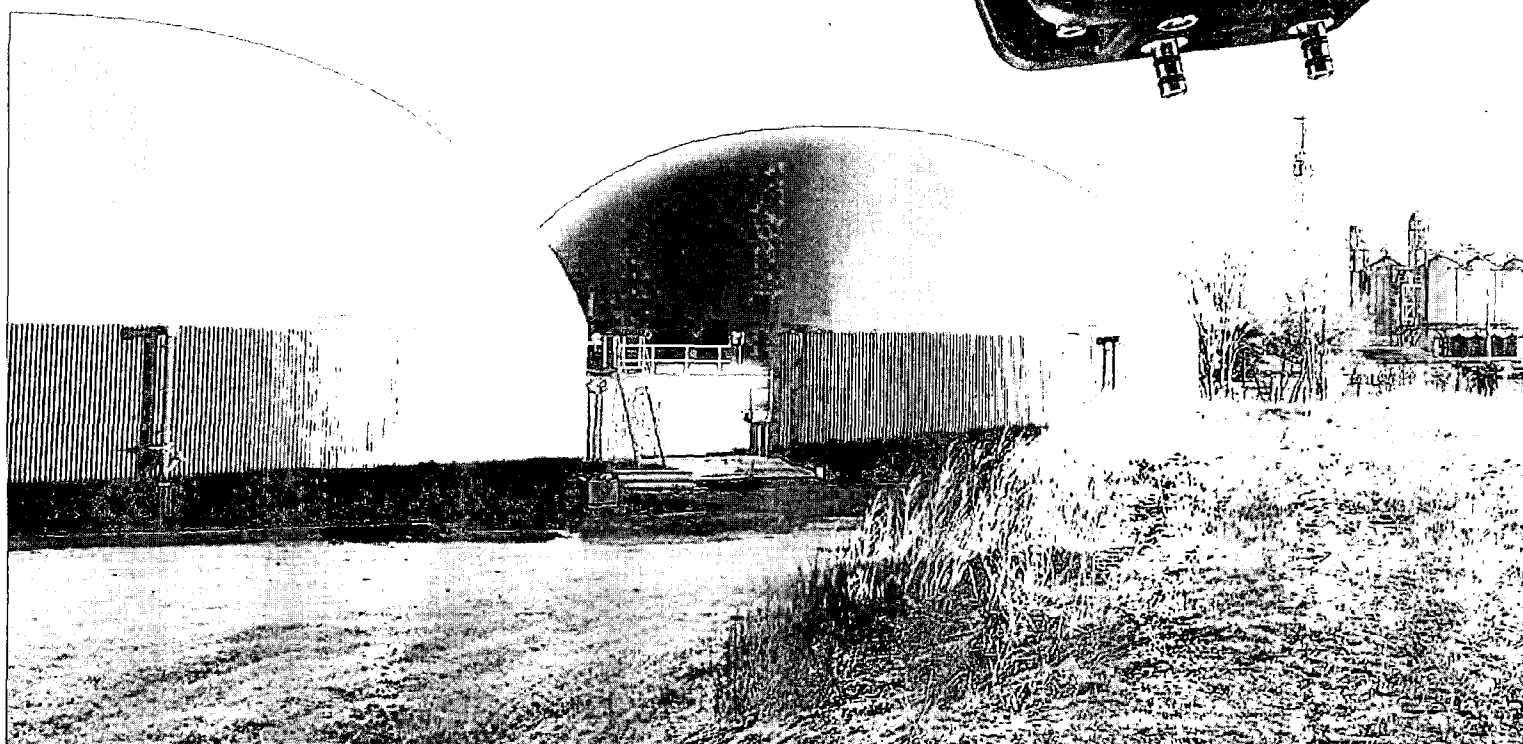


The device in detail

An overview of the special features

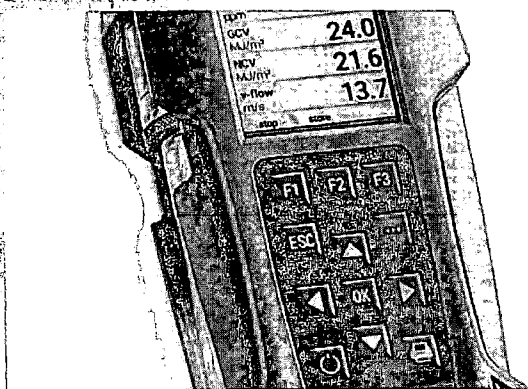


Operation and colour display

Intuitive guidance through the measuring programs, thanks to simple display and keypad interaction

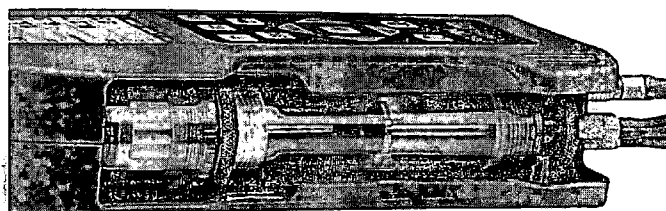


Condensate and dirt are kept out

Large-volume condensate separator with proven star filter, including water stop function

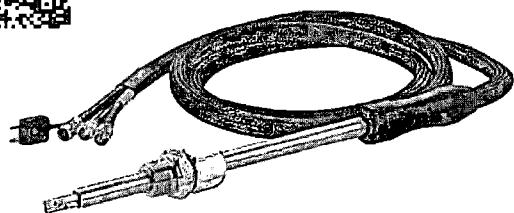


Combination probe

For simultaneous measurement of flow velocity and biogas sampling, with temperature and pressure measurement for normalized flow rate calculation





Store, transfer and print measurement data

SD card, Mini-USB and Bluetooth for data transfer to Smartphone, Tablet or PC – or infrared speed printer

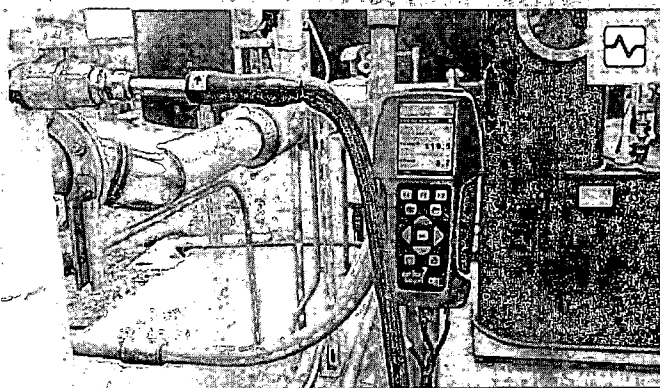

Simultaneous measurement of biogas and flow velocity

Measurement of bio- or landfill gas, using special S-type probe, with 2 ... 100 m/s and calculation of the flow rate in m^3/h

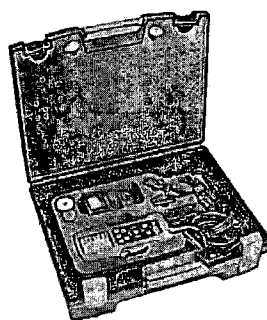

Practical accessories to carry along

Optionally: transport case, gas sampling probe, MRU speed printer and nylon transport bag

OPTIMA Biogas

Technical data



Biogas/-methane	Measuring method	Measuring range min/max	Resolution	Repeatability
Methane (CH ₄)	NDIR	0 ... 100%	0.01 %	± 0.3 % or 3 % reading*
Carbon dioxide (CO ₂)	NDIR	0 ... 100%	0.01 %	± 0.3 % or 3 % reading*
Hydrogen sulphide (H ₂ S)	electrochemical	0 ... 2,000/5,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 500 ppm), 10 % (> 500 ppm) reading
Oxygen (O ₂)	electrochemical	0 ... 25%	0.01 %	± 0.2 % absolute
Hydrogen (H ₂)	electrochemical	0 ... 1,000/2,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 500 ppm), 10 % (> 500 ppm) reading
Nitrogen (N ₂)	calculated	0 ... 100%	0.1%	
Calorific value (Hu)	calculated	0 ... 50 MJ/m ³	0.1 MJ/m ³	

Engine exhaust gas (CHP)	Measuring method	Measuring range min/max	Resolution	Repeatability
Oxygen (O ₂)	electrochemical	0 ... 25 %	0.01 %	± 0.2 % absolute
Carbon dioxide (CO ₂)	NDIR	0 ... 100 %	0.01 %	± 0.3 % or 3 % reading*
Carbon monoxide (CO)	electrochemical	0 ... 10,000/20,000 ppm	1 ppm	± 10 ppm or 5 % (0 ... 4,000 ppm), 10 % (> 4,000 ppm) reading
Nitric monoxide (NO)	electrochemical	0 ... 1,000/5,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 1,000 ppm), 10 % (> 1,000 ppm) reading
Nitric dioxide (NO ₂)	electrochemical	0 ... 200/1,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 200 ppm), 10 % (> 200 ppm) reading
Nitric dioxide (NO _x)	calculated	0 ... 5,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 1,000 ppm), 10 % (> 1,000 ppm) reading
Methane (CH ₄)	NDIR	100 ... 40,000 ppm	10 ppm	± 400 ppm or 5 % reading*

Landfill gas	Measuring method	Measuring range min/max	Resolution	Repeatability
Methane (CH ₄)	NDIR	0 ... 100%	0.01 %	± 0.3 % or 3 % reading*
Carbon dioxide (CO ₂)	NDIR	0 ... 100%	0.01 %	± 0.3 % or 3 % reading*
Hydrogen sulphide (H ₂ S)	electrochemical	0 ... 2,000/5,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 500 ppm), 10 % (> 500 ppm) reading
Oxygen (O ₂)	electrochemical	0 ... 25%	0.01 %	± 0.2 % absolute
Hydrogen (H ₂)	electrochemical	0 ... 1,000/2,000 ppm	1 ppm	± 5 ppm or 5 % (0 ... 500 ppm), 10 % (> 500 ppm) reading
Nitrogen (N ₂)	calculated	0 ... 100%	0.1%	
Calorific value (Hu)	calculated	0 ... 50 MJ/m ³	0.1 MJ/m ³	
Gas flow velocity	S-type probe	1 ... 100 m/s	0.1 m/s	± 0.2 m/s (2 ... 10 m/s), ± 0.5 % (> 10 m/s)
Flow rate	calculated	0.1 ... 6,000 m ³ /s	0.1 m ³ /s	user settable cross section area
Differential temperature	NiCrNi	-40 ... +1,200 °C	1 °C	± 2 °C, 0.5 % reading*
Differential pressure		± 300 hPa	0.01 hPa	0.03 hPa, 1 % reading*

General technical data	
Operating conditions	+5 ... +45 °C; RH up to 95 % non condensing
Storage conditions	-20 ... +50 °C
Data storage	>20,000 data sets
Interface	Mini-USB, SD, IRDA, Bluetooth (data transfer to Smartphone, Tablet or PC)
Internal power supply	Li-Ion battery
Mains power supply	wall plug unit 100 ... 240 Vac; 50 ... 60 Hz; 5V DC; 1.2 A
Protection class	IP30
Dimensions (W x H x D)	113 x 244 x 54 mm
Weight	approx. 750 g

MRU – Competence in gas analysis. Since 1984.

**MRU · Messgeraete fuer Rauchgase
und Umweltschutz GmbH**

Fuchshalde 8 + 12
74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Phone +49 7132 99620 · Fax +49 7132 996220
info@mru.de · www.mru.eu

MRU representative:



UTB – DNS laboratorní přístroje a měřicí technika 11/2023 - Analyzátor bioplynu II

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **analyzátoru bioplynu** pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Analyzátoru bioplynu:

Měření bioplynu: CH₄, CO₂, O₂, H₂S

	Rozmezí min./max.	Rozlišení	Způsob měření
Metan (CH ₄)	0 ... 100%	0,01%	NDIR senzor
Oxid uhličitý (CO ₂)	0 ... 100%	0,01%	NDIR senzor
Sirovodík (H ₂ S)	0 - 2000 ppm (max. 5 000 ppm)	1 ppm	elektrochemicky
Kyslík (O ₂)	0 ... 21%	0.01%	elektrochemicky
Hydrogen (H ₂)	0 - 1 000 ppm (max. 2 000 ppm)	1 ppm	elektrochemicky
Dusík (N ₂)	0 ... 100%	0.1%	vypočítaná
Výhřevnost	0 ... 50 MJ/m ³	0.1 MJ/m ³	vypočítaná

Provozní podmínky: +5 až +45 °C; RH do 95% bez kondenzace

Přenosný typ analyzátoru

Součást dodávky:

- hadice pro přívod bioplynu s rychlospojkou: min. 5m, ø3/7mm
- Bluetooth modul pro spojení s Windows/Android/iOS
- Program automatického ukládání měření na SD kartu
- Ochranné termoizolační pouzdro pro práci v nízkých teplotách (až -15°C)
- kufr, napájecí zdroj, baterie
- Ramenní popruh pro přístroj s rychlospojkami
- Návod na obsluhu zařízení v českém i anglickém jazyce

Požadovaný počet: 1 ks

Součástí dodávky jsou další příslušenství, kterých je zapotřebí pro správný chod přístroje (těsnění, spojky, kabely, držáky, atd.).

Informace pro dodavatele
**VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU**

**UTB – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 11/2023 - Analyzátor bioplynu
II**

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržáním těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.

- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);
- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení