



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEREJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Světelný zdroj - 2ks	Olympus CLV-S200IR		
Výrobce	Olympus Medical Systems Corp.		

Světelný zdroj určený pro IR fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastní látky – 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Světelný zdroj určený pro IR fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastní látky - 2 ks:</b>		
Samostatný světelný zdroj určený pro zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu	základní požadavek	ANO
Hlavní vyšetřovací lampa - 300W xenonová lampa	základní požadavek	ANO, 300 W
Minimální životnost lampy - 500 provozních hodin	základní požadavek	ANO, 500 hodin
Integrovaný záložní zdroj - 12V/35W halogen	základní požadavek	ANO, 12V / 35W
Automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou – dle světelných podmínek operačního pole	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky je datový kabel pro automatické řízení intenzity osvětlení připojenou kamerovou jednotkou	základní požadavek	ANO
Součástí nabídky musí být 1 ks laparoskopické optiky 30°, pr. 10 mm určená pro použití pomocí ICG, vč. světlovodného kabelu pr. 4,25 mm, délky min. 3 m a plastového sterilizačního kontejneru	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízením.


Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KR

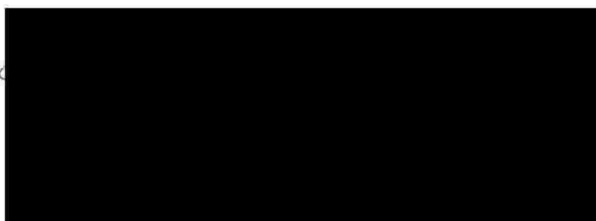



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNE ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Parní sterilizátor		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	OS		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
<b>Dodavatel:</b>			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Parní sterilizátor	3ks	Azteca AC 450	
Výrobce	Celltron Medical Technologies Kft.		

**3ks Parní sterilizátor**

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>3ks Parní sterilizátor</b>		
Sterilizátor se samostatným el. vyvlečením páry mimo komoru	základní požadavek	ANO
Vyhovující normám ČSN EN 285:A2 a ČSN EN 17665-1	základní požadavek	ANO
Sterilizátor o velikosti komory 1 STJ, stolní provedení	základní požadavek	ANO
Provoz na 230 V nebo 3x400 V/ 50 Hz	základní požadavek	ANO
Válcová, horizontálně uložená komora se základnou pro vložení 1 STJ kontejneru + policový systém se sity	základní požadavek	ANO
Jednodveřové provedení	základní požadavek	ANO
Ovládací jednotka vpravo od komory	základní požadavek	ANO
Součástí komory topný plášť s izolací pro snížení tepelných ztrát	základní požadavek	ANO
Automaticky uzavíratelné dveře	základní požadavek	ANO
Vestavěná úprava vody	základní požadavek	ANO
Vestavěná tiskárna	základní požadavek	ANO
Počítadlo šarží	základní požadavek	ANO
Vizuální a akustická signalizace stavu procesu	základní požadavek	ANO
Sterilizační procesy 121°C a 134°C	základní požadavek	ANO
Testovací programy Vakuum test, Bowie Dick test, program Priony	základní požadavek	ANO
Programy 134°C a 121°C pro sterilizaci pevného a porézního materiálu, dutých nástrojů <ul style="list-style-type: none"> <li>o Balené materiály</li> <li>o Materiály s intenzivním dosušením</li> <li>o Sklo, pryž</li> <li>o Laparoskopie, endoskopie, optika</li> <li>o Flash program</li> </ul>	základní požadavek	ANO
Integrovaný odpad	základní požadavek	ANO
Mechanický filtr na vstupu chladicí vody	základní požadavek	ANO
Bakteriologický filtr pro zavzdušnění komory	základní požadavek	ANO
Vývěva se zařízením na úsporu vody	základní požadavek	ANO
Ovládací dotykovým displejem v ČJ	základní požadavek	ANO
Ovládací dotykovým displejem, zobrazení grafu procesu a hodnot teploty, tlaku a čísla šarže	základní požadavek	ANO
Připojení sterilizátoru k síti LAN a servisnímu středisku, dálková diagnostika, záznam a archivace procesů na PC a serveru nemocnice	základní požadavek	ANO
Provedení výchozí revize tlakové nádoby včetně pasportu	základní požadavek	ANO
Provedení prvotní validace podle ČSN EN 17665, zpracování validačního protokolu	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB), při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravidlé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktový list, technický list, ...).

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEREJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - EKG přístroj		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	interna 6x; ARO, IIP 2x;		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení EKG přístroj	MAC2000		
Výrobce	GE Healthcare		

<b>8ks EKG přístroj pro interní oddělení</b>
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>8ks EKG přístroj pro interní oddělení</b>		
12-ti svodový EKG přístroj	základní požadavek	ANO
přístroj musí být vybaven indikátorem, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu (barevný semafor, tři samostatné indikátory pro každou barvu vedle sebe červená, žlutá, zelená).	základní požadavek	ANO
kontinuální monitoring se záznamem událostí (arytmii)	základní požadavek	ANO
EKG musí umožnit přenos EKG záznamů do NIS, EKG DICOM vč. licence SW EKG	základní požadavek	ANO
možnost připojení EKG do systému MUSE (archivace dat)	základní požadavek	ANO
detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min 75.000 vzorků/sec/kanál	základní požadavek	ANO, 75.000
digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sec/kanál	základní požadavek	ANO, 16.000
rekvenční rozsah: dolní hranice od 0,04 Hz, horní hranice 150 Hz	základní požadavek	ANO, 0,04 - 150 Hz
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií	základní požadavek	ANO
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé	základní požadavek	ANO
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu	základní požadavek	ANO
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů	základní požadavek	ANO, 100
displej minimální velikosti 7" se zobrazením všech 12 svodů s minimálním rozlišením 640x480	základní požadavek	ANO, 7" 800x480
přehledná klávesnice s funkčními klávesami v českém jazyce	základní požadavek	ANO
provoz ze sítě na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin) s vnitřním dobíjením akumulátorů, přípouštěme pouze interní zdroj napájení	základní požadavek	ANO
uživatelé volitelný tisk 12-ti svodového záznamu na termo citlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.)	základní požadavek	ANO
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s	základní požadavek	ANO, 5 / 12,5 / 25 / 50
menu, komunikace a ovládání v ČJ	základní požadavek	ANO
příslušenství: kabel napájecí, kabel pacientský s jednotlivými výměnnými svody, hrudní a končetinové elektrody (hrudní pás + destičky)	základní požadavek	ANO
k EKG se musí dát připojit číselka čárových kódů pro bezchytné zadání dat pacienta (z NIS)	základní požadavek	ANO
součástí dodávky je originální vozík pod EKG s držákem pacientského kabelu a odkládací poličkou (ne drátěnou, ale plnou)	základní požadavek	ANO
možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (tj. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg).	základní požadavek	ANO
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1	základní požadavek	ANO
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky	základní požadavek	ANO
přístroj musí mít možnost připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x	základní požadavek	ANO
přístroj musí mít možnost přenosu pacientských dat z nemocničního informačního systému (NIS) prostřednictvím HL7	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předloženo nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data).

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: .....

RICHARD KRUTINA

H  
IČ



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - plicní vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Plicní oddělení	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z TECHNIK s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 273, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10	DIC: CZ04115490
Typové označení	Bodypletyzograf celotělový + opce měření transferfaktoru (CO Difuze) – 2 ks	
Výrobce	Geratherm GmbH, Circassia, Lemon Medical GmbH	

**Bodypletyzograf celotělový + opce měření transferfaktoru (CO Difuze) – 2 ks**

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i požární servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a požárního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Bodypletyzograf celotělový + opce měření transferfaktoru (CO Difuze) – 2 ks</b>		
Základní funkce - statická spirometrie, dynamická spirometrie - křivka průtok/objem, intrathorakální objemy, proudový odpor Raw.	základní požadavek	ANO
Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ± 3 % nebo ± 0,05 litru v rozmezí průtoku 0 - 15 l/s.	základní požadavek	ANO, dle požadovaných hodnot
Četkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s musí být menší než 1,5 cmH <sub>2</sub> O/l/s.	základní požadavek	ANO, 14l/s, menší než 1,5cm
Kalibrační pumpa 3 l	základní požadavek	ANO, 3L
Výsuvná židle z kabiny pro snadnější nástup a výstup invalidních pacientů, výškové stavitelné židle v kabině.	základní požadavek	ANO
Výškové ovládatelný stavivý přístroj.	základní požadavek	ANO
Možnost ovládání výšky stavivu zvenčí při uzavřené kabině.	základní požadavek	ANO
Automatické elektromagnetické uzavírání dveří.	základní požadavek	ANO
Možnost otevření dveří zevnitř pacientem.	základní požadavek	ANO
Skleněná výplň kabiny přístroje z pěti stran - trizené nerozbitné sklo.	základní požadavek	ANO
Nízká nástupová hrana kabiny, max. 10 cm.	základní požadavek	ANO, 10 cm
Odolnost konstrukce přístroje vůči fyzikálním vlivům a chemickým látkám.	základní požadavek	ANO
Integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu.	základní požadavek	ANO
Modul pro vyšetření plicní difuze metodou Single breath.	základní požadavek	ANO
Methan jako transportní plyn pro vyšetření DLCO - pouze jedna láhev.	základní požadavek	ANO
Online vzorkování plynu pro vyšetření DLCO, možnost offline doplnění hodnoty Hb, PaO <sub>2</sub> , COHb a následné přepočítání výsledků DLCO.	základní požadavek	ANO
Softwarový modul pro provádění bronchoprovokačních testů.	základní požadavek	ANO
Externí bronchoprovokační jednotka s programem pro vyhodnocení testů, která je programově kompatibilní s uživatelským prostředím bodypletyzografu.	základní požadavek	ANO
Vyšetření maximálních tlaků MIP/MEP.	základní požadavek	ANO
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek.	základní požadavek	ANO
Plná kontrola ATG/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření.	základní požadavek	ANO
Předpost analýza opakovaného vyšetření.	základní požadavek	ANO
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření.	základní požadavek	ANO
Možnost dodatečné editace Wtg a odporu.	základní požadavek	ANO
Možnost editace protokolu dle potřeb zákazníka.	základní požadavek	ANO
Možnost importu databáze z již používaných přístrojů u zákazníka (Spirometr, FeNO).	základní požadavek	ANO
Export databáze pacientů a výsledků vyšetřených pacientů do uživatelských SW pro další zpracování a prezentace.	základní požadavek	ANO
Export grafů do pdf.	základní požadavek	ANO
<b>Součástí dodávky je 2ks analyzátor NO</b>		
2 ks - Přístroj pro měření vydechutého NO ( pro 15 000 měření)	základní požadavek	ANO
2ks - BCI1 Panel Opce Software, software pro Bluetooth spojení s PC, motivační software k měření FeNO, databáze pacientů	základní požadavek	ANO
2ks - Test Kit, Senzor pro 100 měření životnost 12 měsíců	základní požadavek	ANO
500ks - bakteriální a virový filtr	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaklizení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlášení, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktový list, technický list, ...).

Dne: 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRATINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKAZKY - intenzivní medicína - Přístroj EEG		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	ARO		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Přístroj EEG - 1kpl	TruScan EEG CL 32		
Výrobce	DEYMED Diagnostic s.r.o.		

Přístroj EEG - 1kpl
---------------------

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	Ano
Záruční doba v délce	24 měsíců	Ano, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	Ano
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	Ano
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Přístroj EEG</b>		
32 kanálová EEG snímací hlavička s možností bezdrátové komunikace a s možností ukládání dat při vypnutí bezdrátového spojení (dosah min. 150 m na volném prostranství), možnost výměny baterií za provozu uživatelem bez výpadku natačených dat, výdrž baterií min. 30 hod (v bezdrátovém režimu i v režimu ukládání dat na paměťové médium)	základní požadavek	Ano, 32 kanálů
licence software pro natačení, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu	základní požadavek	Ano
síťová verze softwaru	základní požadavek	Ano
možnost vzdáleného servisu natačící stanice (nutno zajistit připojení k internetové sítni)	základní požadavek	Ano
<b>Ridicí systém EEG stanice:</b>		
výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru, monitor LCD 24 DVI, 8GB RAM, SSD 500 GB	základní požadavek	Ano
<b>Pojízdný stolek s ramenem pro snímací jednotku:</b>		
rameno s držákem snímací jednotky	základní požadavek	Ano
výsuvná klávesnice	základní požadavek	Ano
upevnění PC s krytem kabeláže	základní požadavek	Ano
průmyslová kolečka	základní požadavek	Ano
Napájecí zdroj 500W včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01)	základní požadavek	Ano
Fotostimulační lampa ( bílá/červená) držák rameno	základní požadavek	Ano
<b>Laserová tiskárna ČB</b>		
Zálohovací modul EEG:	základní požadavek	Ano
externí pevný disk pro zálohování dat - licence software zálohování	základní požadavek	Ano
<b>Základní sada EEG spotřebního materiálu:</b>		
EEG čepice (výběr ze standardně dodávaných velikostí), hrudní pás	základní požadavek	Ano
EEG gel 0.5l, 3 ks tupých jehel, sřikačka pro dávkování gelu	základní požadavek	Ano
2 ks překlenovacích elektrod, pár ušních elektrod	základní požadavek	Ano
pár EKG Elektrod	základní požadavek	Ano
prací prostředek na EEG čepice 1l	základní požadavek	Ano
Standardně dodávána EEG čepice velikosti M (55 – 59 cm, barv. červená), jinak možnost výběru ze standardně dodávaných velikostí.	základní požadavek	Ano
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	Ano
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	Ano
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	Ano

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (p

Dne 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	:	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Přístroj EMG/EP
Místo	:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště	:	ARO
Vyřizuje	:	Ing. Karel Matas
Kontaktní mail	:	[redacted]
<b>Dodavatel:</b>		
Název dodavatele	:	Z Technik s.r.o. IČ: 04115490
Adresa dodavatele	:	Locholínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy DIČ: CZ04115490
Typové označení Přístroj EMG/EP - 1kpl	:	EMG/EP přístroj; Nicolet EDX, třída dle MDD IIb Magnetický stimulator Magstim 2002, třída dle MDD IIa
Výrobce	:	Natus Neurology Inc./ The Magstim Company Ltd.

**Přístroj EMG/EP - 1kpl**

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Přístroj EMG/EP</b>		
1ks - 5 kanálový EMG/EP přístroj s programem s kompletním vybavením	základní požadavek	ANO
EMG/EP centrální jednotka, 24" displej TFT s reproduktorovou lištou, mobilní stojan s integrovaným držákem monitoru, plně flexibilním ramenem pro hlavici, ovládací panel, 5-kanálový zesilovač a samostatná hlavice pro připojení elektrod u lůžka pacienta s 5m propojovacím kabelem. Interní elektrický stimulator s externí hlavici a nastavovací prvky pro intenzitu stimulace a ovládání přístroje. Nožní pedál. Oddělovací transformátor. Laserová černobílá tiskárna s automatickým duplexním tiskem. Programovatelný synchronizační vstup a výstup pro připojení externích stimulatorů. Modul pro evokované potenciály (VEP, SEP, BAEP) v plném vybavení včetně stimulatorů (akusticky nestíněná stimulační sluchátka, zrakový stimulator s monitorem VEP).	základní požadavek	ANO
Vyhodnocovací jednotka se SW, SW Office (Word, Excel a PowerPoint) v českém jazyce. Předdefinované a konfigurovatelné závěry ve Wordu.	základní požadavek	ANO
Programy pro NCS, repetitivní stimulaci, jehlovou EMG, reflexy, TIA analýzu, MUP a Multi-MUP, SF a Macro EMG. Programy pro vyšetření sympatického kožního potenciálu a variability srdeční frekvence (parasympatikus). Programy pro VEP, SEP, BAEP. Konfigurační průvodce umožňující plně nastavení celého systému dle požadavků uživatele. Balíček nástrojů umožňující tvorbu dynamických prezentací vyšetření pro výukové účely (Producer).	základní požadavek	ANO
Základní sada elektrod pro neurofii, EMG a EP.	základní požadavek	ANO
<b>1ks - Magnetický stimulator v následující sestavě:</b>	základní požadavek	ANO
Monofázický magnetický stimulator s ovládacím panelem s velkým aktivním displejem, čitelným od lůžka pacienta pro ovládání stimulačních cívek z předního panelu (např. sestrou). Synchronizační obvody pro spojení s elektromyografem s možností stimulace volitelně spouštěné z magnetického stimulatoru nebo z EMG přístroje.	základní požadavek	ANO
Standardní kruhová stimulační cívka 90 mm s dálkovým ovládním integrovaným v rukojeti (může ovládat přímo stimulujiící osoba od pacienta)	základní požadavek	ANO
Y cívka 110 mm pro stimulaci dolních končetin (ovládání se provádí z panelu stimulatoru)	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ([redacted])

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	ARO	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
<b>Dodavatel:</b>		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie - 1ks	SUDOSCAN2, třída dle MDD lia	
Výrobce	IMPETO MEDICAL	

**Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie- 1ks**

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie</b>		
přístroj pro časnou identifikaci a sledování periferní autonomní periferie	základní požadavek	ANO
přístroj s integrovaným displejem	základní požadavek	ANO
dvě dokovací jednotky Smart Dock pro Smart elektrody	základní požadavek	ANO
současné vyšetření horních a dolních končetin	základní požadavek	ANO
<b>Příslušenství:</b>		
sada Smart elektrod pro vyšetření HK + DK pro 1 000 pacientů	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KR [REDACTED]



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Kardiokograf		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Gyn-por		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
<b>Dodavatel:</b>			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Kardiokograf	CTG COROMETRICS 259		
Výrobce	Wipro GE Healthcare Private Limited		

**3ks Kardiokograf pro gyn-por oddělení**

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostné technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>3ks Kardiokograf pro gyn-por oddělení</b>		
kardiokograf pro monitorování dvojčat vč. FMD	základní požadavek	ANO
kardiokograf musí umožnit monitorovat dva plody	základní požadavek	ANO
standardní termocitlivý skládaný papír	základní požadavek	ANO
přístroj musí být kompaktní s minimálními pohyblivými komponenty	základní požadavek	ANO
přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG	základní požadavek	ANO
možnost připojení ručního značkovače na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.	základní požadavek	ANO
možnost nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min	základní požadavek	ANO, 1, 2, 3 cm / 1 min
možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu	základní požadavek	ANO
regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu	základní požadavek	ANO
nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.	základní požadavek	ANO
ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií	základní požadavek	ANO
součástí dodávky musí být dvě sondy UZ, jedna sonda pro snímání děložních kontrakcí, návod v ČJ, stolek pod přístroj	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

.....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KROT







Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Mazas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Locholnáská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videoprocessor se samostatným zdrojem světla 3ks	Videoprocessor ELUXEO VP-7000	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videoprocessor se samostatným zdrojem světla – 3ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezaplanovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po údobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Videoprocessor se samostatným zdrojem světla:</b>		
automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záložka nastavení systému do paměti.	základní požadavek	ANO
zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožňovat funkci zvýraznění žilových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných žilových struktur současně.	základní požadavek	ANO
Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu.	základní požadavek	ANO
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.	základní požadavek	ANO
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video.	základní požadavek	ANO
Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávícím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD.	základní požadavek	ANO
<b>DICOM rozhraní:</b>		
Videoprocessor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.	základní požadavek	ANO
Implementace do stávajícího NIS systému.	základní požadavek	ANO
Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.	základní požadavek	ANO
Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).	základní požadavek	ANO
Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.	základní požadavek	ANO
<b>LED zdroj světla – 3 ks:</b>		
Automatické řízení intenzity světla.	základní požadavek	ANO
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích.	základní požadavek	ANO, ve 4 krocích
Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod.	základní požadavek	ANO, 4 LED diody
Minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin.	základní požadavek	ANO, minimálně 10 000 provozních hodin
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru. Tento způsob přenosu snižuje riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru.	základní požadavek	ANO
Podpora optických zobrazovacích metod:	základní požadavek	ANO
musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.	základní požadavek	ANO
musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x český, 1xCDI/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci u nabídky. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktové

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KROUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
<b>Dodavatel:</b>		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Monitor 2ks	Medicinský monitor 32" EIZO, 4K UHD EX3241	
Výrobce	EIZO	

<b>Monitor – 2ks</b>
----------------------

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Monitor:</b>		
Úhlopříčka min. 26".	základní požadavek	32"
HDTV rozlišení obrazu.	základní požadavek	ANO
Minimální kontrast 1000:1.	základní požadavek	1000:1
Anti-reflexní úprava.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací úhel alespoň 170°.	základní požadavek	178°
Certifikace MDE.	základní požadavek	ANO
Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA.	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školiště výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.

24 -05- 2022

Dne .....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: ..





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
<b>Dodavatel:</b>		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Umělé inteligence 1ks	CAD AI - umělá inteligence AI-EX-1	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

<b>Umělá inteligence – 1ks</b>
--------------------------------

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Umělá inteligence:</b>		
Počítačem asistovaná technologie využívající umělou inteligenci, která napomáhá v reálném čase vyšetření k detekci a charakterizaci polypů v tlustém stěvě.	základní požadavek	ANO
Detekce – grafické označení přítomnosti polypů v tlustém stěvě.	základní požadavek	ANO
Charakterizace – rozlišení neoplastických a hyperplastických polypů v tlustém stěvě pomocí barev.	základní požadavek	ANO
Vstup: 1xDVI-I.	základní požadavek	ANO
Výstup: 1xDVI-I, 1xDVI-D.	základní požadavek	ANO
Paměť: integrovaný pevný disk (180 GB) s možností 30 hodin Full HD videozáznamů ve formátu MP4.	základní požadavek	ANO
Rozměry maximálně: š 370 mm x výška 100 mm x hloubka 466 mm.	základní požadavek	š 370 mm x výška 99,0 mm x hloubka 465,6 mm
Váha maximálně: 8 kg.	základní požadavek	7,1 kg
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

Dne .....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRŮT

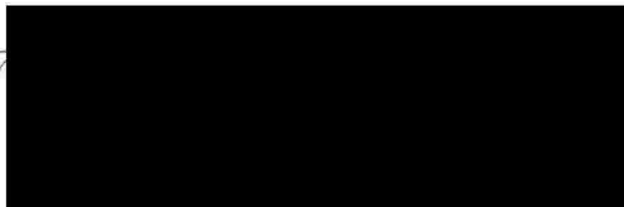



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Odsávací pumpa 2ks	Odsávací jednotka Medela BASIC	
Výrobce	Medela	

**Odsávací pumpa – 2ks**

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpávaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Odsávací pumpa:</b>		
Odsávací vakuové čerpadlo.	základní požadavek	ANO
Odsávací láhev min. 2 litry.	základní požadavek	2 litry
Nominální vakuum min. 90 kPa.	základní požadavek	90 kPa
Výkon minimálně 30 L / min.	základní požadavek	30 l/min
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.


Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KR





Projekt	: CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení
Místo	: Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště	: Endoskopie
Vyřizuje	: Ing. Karel Matas
Kontaktní mail	: [redacted]
<b>Dodavatel:</b>	
Název dodavatele	Z. Technik s.r.o. IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochtínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy DIČ: CZ04115490
Typové označení Videogastroskop 2ks	Videogastroskop ELUXEO EG-760R
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation

<b>Videogastroskop – 2ks</b>
------------------------------

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Videogastroskop:</b>		
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).	základní požadavek	ANO
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.	základní požadavek	ANO
<b>Optický systém:</b>		
- zorné pole minimálně 140°		zorné pole 140°
- směr pohledu přímý pohled	základní požadavek	směr pohledu přímý pohled
- pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm	základní požadavek	pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 9,2 mm		zevní průměr distálního konce 9,2 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 9,3 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 9,3 mm
- pracovní délka minimálně 1100,0 mm		pracovní délka 1100,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 2,8 mm
Ohybová část – rozsah angulace:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 210°		nahoru 210°
- dolů minimálně 90°	základní požadavek	dolů 90°
- doprava minimálně 100°		doprava 100°
- doleva minimálně 100°		doleva 100°
Přídavný oplachový kanál – požadován.	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCDI/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD K [redacted]



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lechotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videokolonoskop 2ks	Videokolonoskop ELUXEO EC-760R-VIL	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videokolonoskop – 2ks
-----------------------

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Videokolonoskop:</b>		
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korigují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barvé rozdíly a poskytuje lepší barvný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.	základní požadavek	ANO
Optický systém:	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 170° - směr pohledu přímý pohled - pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm	základní požadavek	zorné pole 170° směr pohledu přímý pohled pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 12,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm - pracovní délka minimálně 1690,0 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 12,0 mm zevní průměr tubusu 12,0 mm pracovní délka 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 3,8 mm
Ohybová část – rozsah angulace:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160°	základní požadavek	nahoru 180° dolů 180° doprava 160° doleva 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován.	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (

Dne 2.4.-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KAUTINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště	Endoskopie
Vyřizuje	Ing. Karel Matas
Kontaktní mail	
Dodavatel:	
Název dodavatele	Z Technik s.r.o. IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy DIČ: CZ04115490
Typové označení Tenký videokolonoskop 1ks	Videokolonoskop ELUXEO EC-760P-VL
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation

<b>Tenký videokolonoskop – 1ks</b>
------------------------------------

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
<b>Základní obecné požadavky:</b>		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
<b>Základní technické požadavky:</b>		
<b>Tenký videokolonoskop:</b>		
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii lůstého sířeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vícečetné a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který združňuje nepatrně barevně rozdílné a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podpojuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.	základní požadavek	ANO
Optický systém:	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 170°	základní požadavek	zorné pole 170°
- směr pohledu přímý pohled	základní požadavek	směr pohledu přímý pohled
- pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm	základní požadavek	pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 11,1 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 11,1 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 11,5 mm
- pracovní délka minimálně 1690,0 mm	základní požadavek	pracovní délka 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 3,2 mm
Ohybová část – rozsah angulace:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 180°	základní požadavek	nahoru 180°
- dolů minimálně 180°	základní požadavek	dolů 180°
- doprava minimálně 160°	základní požadavek	doprava 160°
- doleva minimálně 160°	základní požadavek	doleva 160°
Přídavný oplachový kanál – požadován.	základní požadavek	ANO
<b>Další požadavky na plnění</b>		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1XCUIUSB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce.

Dne 24-05-2022

Dne .....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTIK