



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č.

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

1. Prodávající:

Obchodní firma/jméno a příjmení: Altium International s.r.o.
Se sídlem/s místem podnikání: Na Jetelce 69/2, Praha 9, 190 00
Zastoupená:
IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079
Bankovní spojení:
Číslo bank. účtu:

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující:

Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Zastoupená:
Adresa: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČ : 71214011
Bankovní spojení:
Číslo bank. účtu:
(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující nebo též „smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu:

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace 3 ks sestav kapalinových chromatografů:

Digitálně podepsáno



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

SESTAVA 1 - Kapalinový chromatograf s detektory pro CTL PH (isokratické čerpadlo, automatický podavač vzorků („autosampler“) s chlazením, kolonový termostat s možností přepínání kolon, UV-VIS detektor a RI detektor)

SESTAVA 2 - Kapalinový chromatograf s detektory pro CTL HK (isokratické čerpadlo, automatický podavač vzorků („autosampler“) s chlazením, kolonový termostat, DAD detektor, RI detektor a analogově digitální převodník)

SESTAVA 3 - Kapalinový chromatograf s detektory pro CTL OV (gradientové čerpadlo, automatický podavač vzorků („autosampler“) s chlazením, kolonový termostat, DAD detektor, RI detektor a analogově digitální převodník)
včetně licence pro připojení ke stávajícímu analytickému SW OpenLab (dále jen „Zařízení“) do místa plnění včetně:

- dodání provozní dokumentace k Zařízení v českém jazyce, případně v anglickém jazyce společně se zkráceným manuálem v českém jazyce (např. návod k obsluze Zařízení),
 - zprovoznění Zařízení v místě plnění,
 - zajištění proškolení 1-2 uživatelů v obsluze Zařízení v každém místě plnění v rozsahu minimálně 1 pracovní den (celkem 3-6 uživatelů)
 - podrobné školení SW OpenLab (4 pracovní dny) pro tři osoby, realizovaných po dohodě se zadavatelem,
 - poskytování záručního servisu Zařízení po dobu minimálně 2 let ode dne dodání Zařízení zadavateli,
 - garance dostupnosti náhradních dílů a servisu k Zařízení po dobu 10 let ode dne dodání Zařízení zadavateli.
2. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace předmětu veřejné zakázky (která odpovídá Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technické požadavky na Zařízení a obslužný software).
 3. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (tj. po instalaci včetně verifikace deklarovaných parametrů přístroje, uvedení do provozu, odzkoušení funkčnosti a nezbytném vstupním zaškolení obsluhy v českém jazyce). Předmětný protokol musí prokazovat shodu se specifikací (viz Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu veřejné zakázky). Vzor tohoto protokolu je nedílnou přílohou této smlouvy jako Příloha č. 2.
 4. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, než je ujednáno v odst. 1, není kupní smlouva na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 NOZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
 5. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní § 2126 NOZ týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

prodlení jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany prodat.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky „Zajištění dodávky 3 ks sestav kapalinových chromatografů s detekcí DAD/UV-VIS a RID včetně licence pro připojení ke stávajícímu analytickému SW OpenLab“ a je uvedena v Příloze č.3 této smlouvy – Krycí list nabídky.
2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s dopravou, včetně balení podle zvyklostí, do místa plnění, instalaci a uvedení předmětu plnění do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c s výhradou uvedenou v odst. 8 a 9 tohoto článku.**
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 NOZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí.
5. Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů kupujícímu.
6. Peněžní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Proávající bere na vědomí, že kupující je organizační složkou státu, a proto financování předmětu plnění bude možné až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

(k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního Souboru programového financování) a s touto skutečností prodávající výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude kupující informovat prodávajícího neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny předmětu plnění v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení kupujícího.

9. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je

- a) Pro Sestavu č. 1 adresa kupujícího uvedená v záhlaví této smlouvy. Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je _____
 - b) Pro Sestavu č. 2 Celní úřad pro Královéhradecký kraj, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové - kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je _____)
 - c) Pro Sestavu č. 3 Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava, odd. 020 GŘC - CTL, Náměstí Svatopluka Čecha 4, 702 09 Ostrava - kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je _____
2. Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely této smlouvy považuje:
- a) předmět plnění, který svou jakostí či provedením zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím objednané tak, jak je uvedeno v článku I. této smlouvy,
 - b) nedodání kompletní dodávky zahrnující instalaci včetně verifikace deklarovaných parametrů přístroje, uvedení do provozu, odzkoušení funkčnosti a nezbytným vstupním zaškolení obsluhy v českém jazyce.
3. Termín dodání předmětu plnění je do 90 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Konkrétní termín bude prodávajícím dojednaný min. 24 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v odst. 1 tohoto článku.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 3 této smlouvy, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 NOZ přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 3 této smlouvy.
3. Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy a zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, s výjimkou ust. čl. III odst. 2.
4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání podle čl. III odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění.

V. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 3. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3000,00 Kč za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % bez DPH z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti garance dostupnosti servisu po dobu min. 10ti let od dodání předmětu plnění dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % bez DPH z kupní ceny.
6. V případě porušení povinnosti garance dostupnosti náhradních dílů po dobu min. 10ti let od dodání předmětu plnění dle čl. VII odst. 7 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % bez DPH z kupní ceny.



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

7. V případě porušení povinnosti prodávajícího ve smyslu čl. VIII. bod 10 a 11 je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní sankci ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
8. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3 až 7 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 8 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
10. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.
11. Smluvní strany si ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 NOZ.

VI. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými obecně závaznými právními předpisy, zejména NOZ.
2. Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

VII. Záruční podmínky

1. Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.
2. Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy záruku na bezvadnou funkci v délce trvání 24 měsíců. Specifikace předmětu veřejné zakázky je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této smlouvy. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje k zahájení záručního zásahu v záruční době nejpozději do 2 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení závady. Prodávající nahlašuje závadu



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

odesláním písemného požadavku na odstranění závady na e-mailovou adresu prodávajícího servis@hpst.cz. V případě, že závada bude takového charakteru, že nebude možné předmět plnění opravit na místě, dohodnou se pověřením zástupci smluvních stran na dalším postupu opravy vedoucím k co možná nejrychlejšímu uvedení předmětu plnění opět do provozu. V tomto případě činí doba pro odstranění závady maximálně 30 dnů ode dne nahlášení závady.

O dobu, po kterou nebude možnost předmět plnění užívat, se prodlužuje záruční doba, a to vždy o dobu od nahlášení poruchy do doby jejího odstranění. Kupující se zavazuje k maximální součinnosti s prodávajícím při odstraňování případných poruch a zpřístupní předmět plnění tak, aby závada mohla být efektivně odstraněna.

4. Prodávající se taktéž zavazuje po dobu trvání záruky zajistit dostupnost servisního technika nebo dispečinku servisu v českém jazyce v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.
5. Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených s dopravou předmětu plnění z místa plnění a zpět hradí prodávající.
6. Záruční servis předmětu plnění a dodání náhradních dílů, které jsou předmětem záruky, bude prodávající během záruční doby provádět bezplatně.
7. Prodávající touto smlouvou garantuje dostupnost pozáručního servisu a náhradních dílů k předmětu plnění na území České republiky po dobu min. 10 let ode dne dodání předmětu plnění kupujícímu.
8. Prodávající je povinen zaškolit prostřednictvím svého odborného zaměstnance a v českém jazyce příslušné zaměstnance kupujícího. Zaškolení bude provedeno v takovém rozsahu, aby byl zajištěn řádný chod dodaného předmětu plnění.
9. Záruka se nevztahuje na okolnosti vymezené ust. § 2913 odst. 2 NOZ.
10. V případě, že bude plněno prostřednictvím subdodavatele, dojednaly si smluvní strany vyloučení aplikace ust. § 2914 NOZ.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

2. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
3. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
4. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise s platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 7 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
10. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jako příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho



Spolufinancováno Evropskou unií

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise, Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD). Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.“

Příloha č.2 ZD– Závazný vzor smlouvy

realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k dílu archivovat po dobu 10 let od ukončení dodávky a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

11. Prodávající je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
12. Tato smlouva obsahuje následující přílohy:
 - Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu veřejné zakázky
 - Příloha č. 2 této smlouvy – Vzor předávacího protokolu (vyhotoví prodávající)
 - Příloha č. 3 této smlouvy - Krycí list nabídky

Prodávající:

Kupující:

V Praze dne: dle el. podpisu


V Praze dne: dle el. podpisu

Podpis: _____
Altium International s.r.o.

Podpis: _____
**Česká republika –
Generální ředitelství cel**

Kapalinové chromatografy

Sestava 1: Agilent 1260 Infinity II Praha
Sestava 2: Agilent 1260 Infinity II Hradec Králové
Sestava 3: Agilent 1260 Infinity II Ostrava

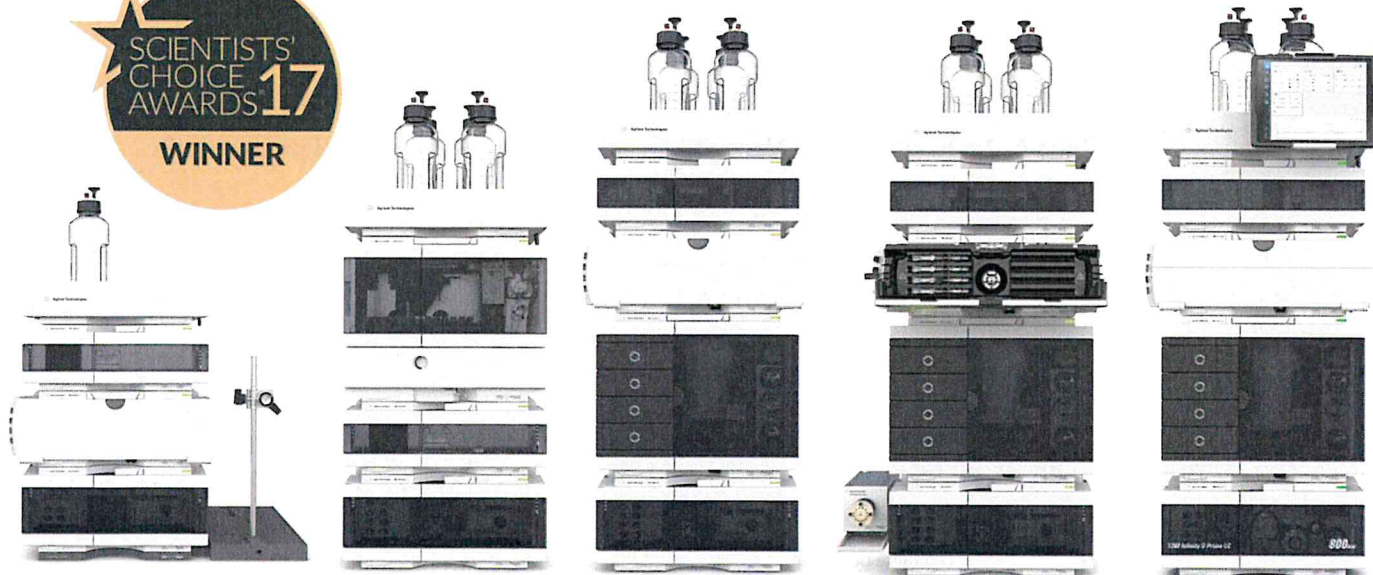

Agilent Technologies


Systém (všechny moduly) je připojitelný a plně ovladatelný prostřednictvím chromatografického SW OpenLab CDS

Sestava 1

Čerpadlo 600 bar

G7110B – Isokratické čerpadlo s vestavěným vakuovým degaserem

Nová generace isokratických čerpadel poskytuje uživatelům především maximální flexibilitu spojenou s vysokou robustností. Ideální volba pro ty z Vás, kteří plánují používat chromatografické kolony s průměry 3.0 a 4.6 mm. Ideální čerpadlo pro rutinní aplikace ve všech typech laboratoří.

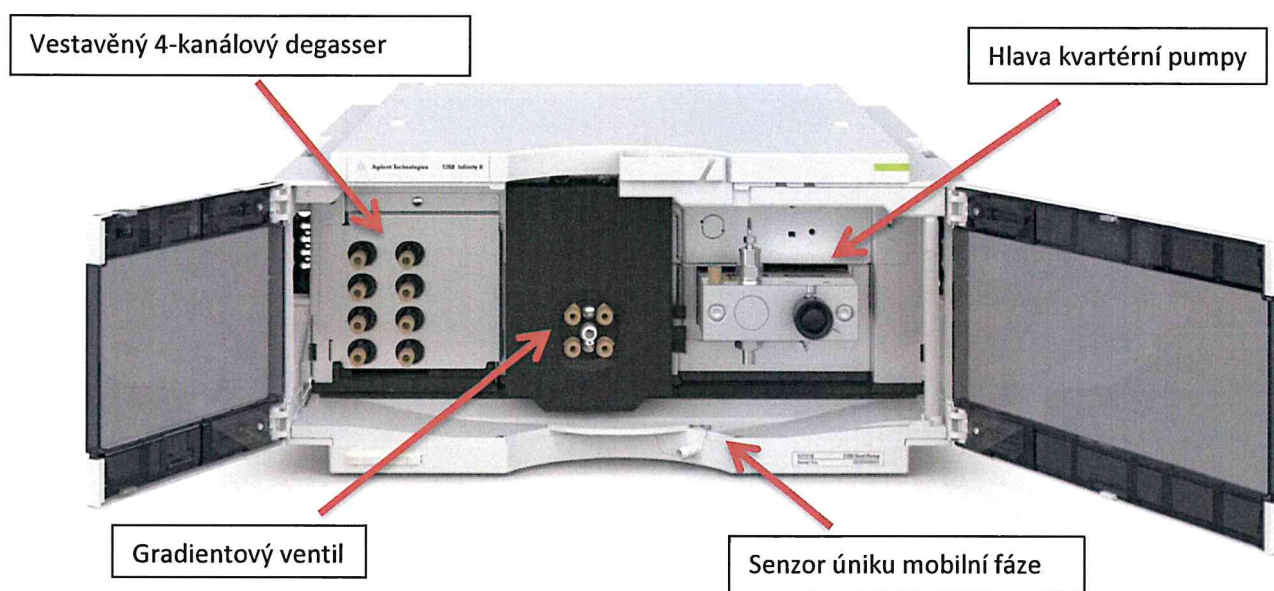


Technická specifikace čerpadla

- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích
- tlaková odolnost maximálně 600 bar (60 Mpa) až do průtoku 5 ml/min (G7110B)
- přesnost průtoku $\leq 0.07\%$ RSD
- integrovaný vakuový degaser
- integrovaný ventil pro přepínání mezi 3 mobilními fázemi
- pH rozsah 1.0 – 12.5
- hmotnost 14,7 kg
- rozměry (výška 180 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Vialsampler

G7129A – Vialsampler s integrovaným prostorem pro termostát kolon (verze 600 bar)

Nová generace a koncept autosampleru s integrovaným prostorem pro umístění až 2 chromatografických kolon. Robustní a především ekonomické řešení automatizace nástřiků při tlacích do 600 a 800 bar je ideální pro Vaše rutinní analýzy. Still-air princip ohřevu mobilní fáze v termostatu kolon zamezuje nežádoucímu radiálnímu přehřívání kolony, které prokazatelně při separacích za vyššího tlaku způsobuje snížení separační účinnosti na koloně až o 40%.

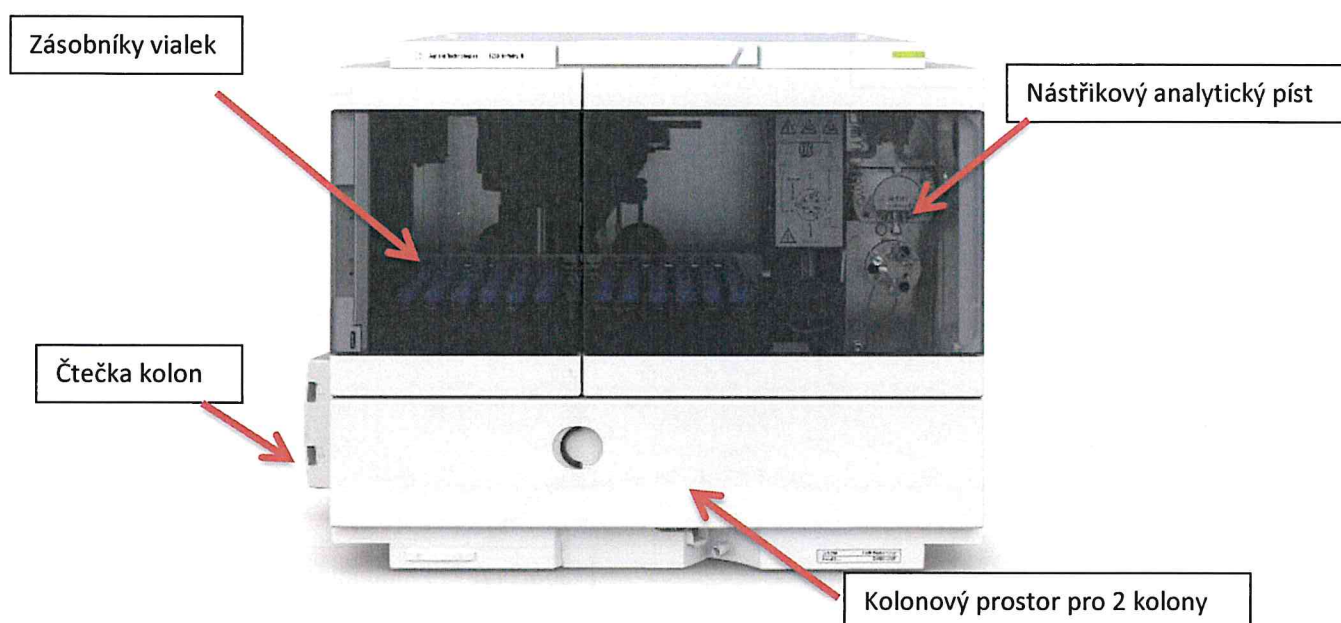


Technická specifikace Vialsampleru:

- flow-through design nástřikového systému, nástřik od 0.1 μ l do 100 μ l (v 0.1 μ l krocích)
- nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému
- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. přímo v dávkovací smyčce
- přesnost nástřiku <0.25 % RSD
- kapacita až 132ks 2 ml vialek nebo 36ks 6 ml vialek
- automatická identifikace zásobníku
- oplach jehly externím rozpouštědlem (peristaltické čerpadlo)
- carryover <0.004 % (40 ppm) pro chlorhexidine při oplachu jehly
- chlazení vzorků prostřednictvím integrovaného vysoce výkonného mini kompresoru v rozsahu do 4-40°C
- senzor úniku mobilní fáze

Termostat kolon

G7116B – Multikolonový termostat kolon (verze 1290 Infinity II)

Nová generace termostatu kolon s větší kapacitou kolon a novým 3D designem Quick-Connect Heat Exchanger pro zajištění nejúčinnějšího přechodu tepla (předkolonová temperace mobilní fáze). Je ideální volbou pro uživatele vyžadující temperování kolon při pokojových, nebo nižších teplotách. Možnost instalace integrovaného přepínacího ventilu umožní rozšířit aplikační využití HPLC systému.

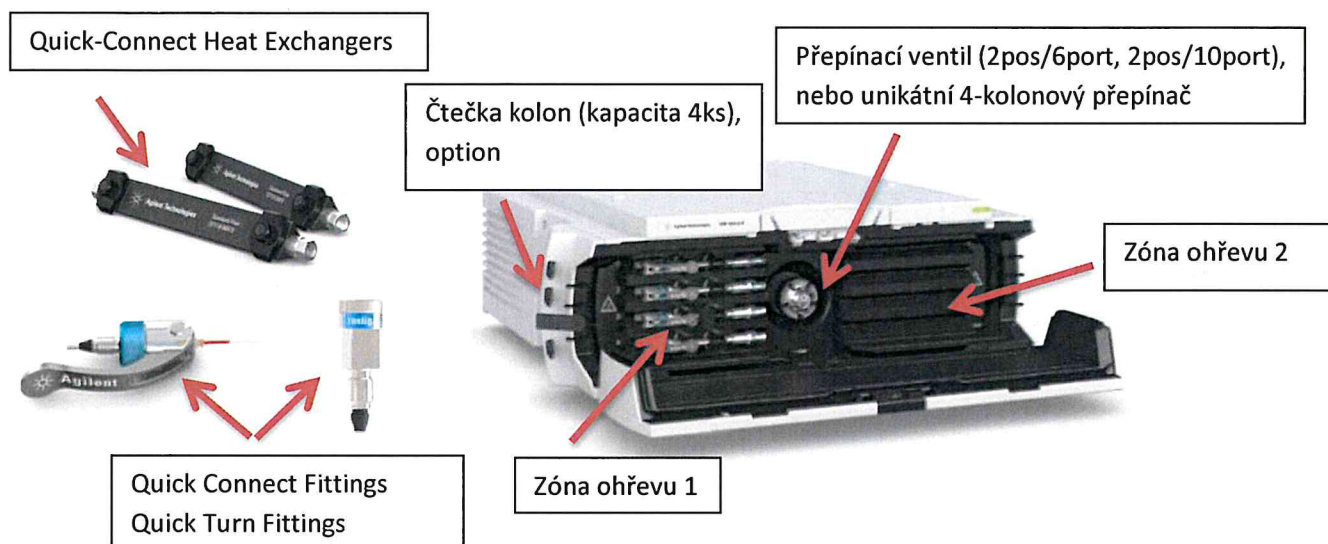



Technická specifikace Multikolonového termostatu kolon :

- teplotní rozsah od 20°C pod okolní teplotu (minimálně 4°C) až 110°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch
- teplotní stabilita $\pm 0,03$ °C
- rychlost ohřevu z pokojové teploty na 40°C během 5 minut
- rychlost chlazení z 40°C na 20°C během 10 minut
- dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná
- kapacita až 4 kusy 30-cm kolon, nebo 8 kusů 10-cm kolon (každá kolona může mít svůj vlastní heat exchanger)
- nový design dveří, umožňující odejmutí, otočení o 180° pro zajištění jednoduchého přístupu, nebo otočení o 90° pro využití jako stolku pro odložení kolony
- integrovaný termostátovaný přepínací ventil Quick-Change (2pos/6port 800 bar)
- hmotnost 12,5 kg
- rozměry (výška 160 × šířka 435 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Detektory

G7114A – UV-VIS detektor s možností simultánního sběru až při 2 vlnových délkách

Nová generace UV-VIS detektoru s deuteriovou lampou a možností simultánního sběru až dvou vlnových délek je ideální ekonomickou volbou pro rutinní laboratoře, tak pro výzkumníky s limitovaným rozpočtem vyžadující robustnost a spolehlivost.

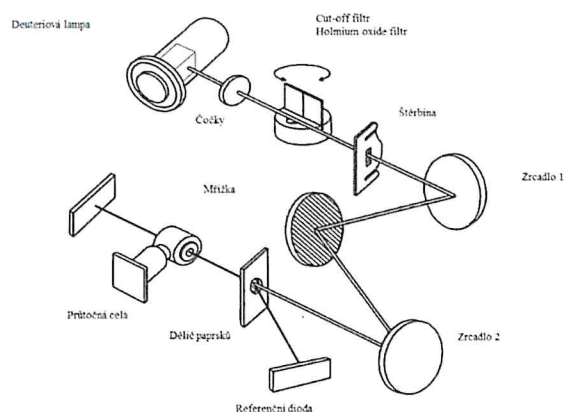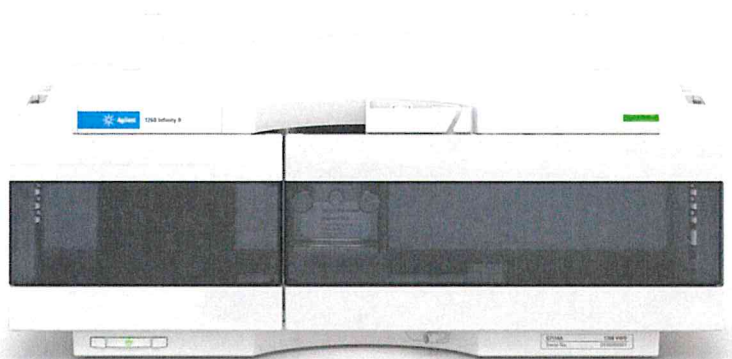

Technická specifikace UV-VIS detektoru :


- dvou paprskový design
- zdroj světla - deuteriová lamp
- rozsah vlnových délek od 190 do 600 nm
- možnost měření až při dvou vlnové délkách, nebo časové programování
- rychlost sběru dat až 120 Hz při měření na 1 vlnové délce
- rychlost sběru dat 2.5 Hz při měření na 2 vlnových délkách
- šum $< \pm 0.25 \times 10^{-5}$ AU při 230 nm (při 1 vlnové délce) a $< \pm 8 \times 10^{-6}$ AU (při 2 vlnových délkách)
- drift $< 1 \times 10^{-4}$ AU/h
- linearita > 2.5 AU
- přesnost nastavení vlnové délky + 1nm, kalibrace vestavěným holmiovým filtrem
- hmotnost 11 kg
- rozměry (výška 140 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Průtočná cela:

Standard flow cell for VWD G7114A #018 ...objem 14 μ L

G7162A – Refraktometrický detektor

Nová generace refraktometrického detektoru je ideální volbou pro detekci analytů které ve své struktuře neobsahují žádné chromofory nebo fluorofory. S ohledem na princip měření je možné tento typ detektoru využít pouze při isokratických analýzách. Nová generace detektorů nabízí především větší rychlost sběru dat a splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU - omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

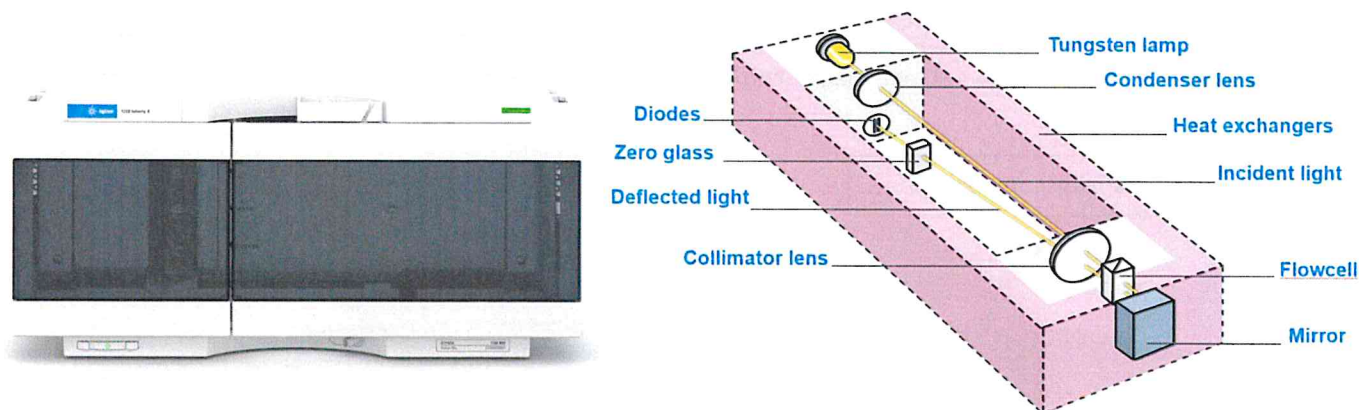

Technická specifikace Refraktometrického detektoru:


- typ detekce – deflekční metoda
- rozsah indexů lomu 1.00–1.75 RIU, kalibrováno
- krátkodobý šum $\leq \pm 1.25 \times 10^{-9}$ RIU
- rychlost sběru dat až 74 Hz
- měřicí rozsah detektoru $\pm 600 \times 10^{-6}$ RIU
- cela s objemem 8 μ l
- rozsah termostatování optiky od 5 °C nad okolní teplotu do 55 °C
- rozsah pH 2.3-9.5
- časově programovatelná polarita a šířka píku
- integrovaný automatický ventil na proplach a recyklaci mobilní fáze
- hmotnost 15 kg
- rozměry (výška 180 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Sestava 2

Čerpadlo 600 bar

G7110B – Isokratické čerpadlo s vestavěným vakuovým degaserem

Nová generace isokratických čerpadel poskytuje uživatelům především maximální flexibilitu spojenou s vysokou robustností. Ideální volba pro ty z Vás, kteří plánují používat chromatografické kolony s průměry 3.0 a 4.6 mm. Ideální čerpadlo pro rutinní aplikace ve všech typech laboratoří.

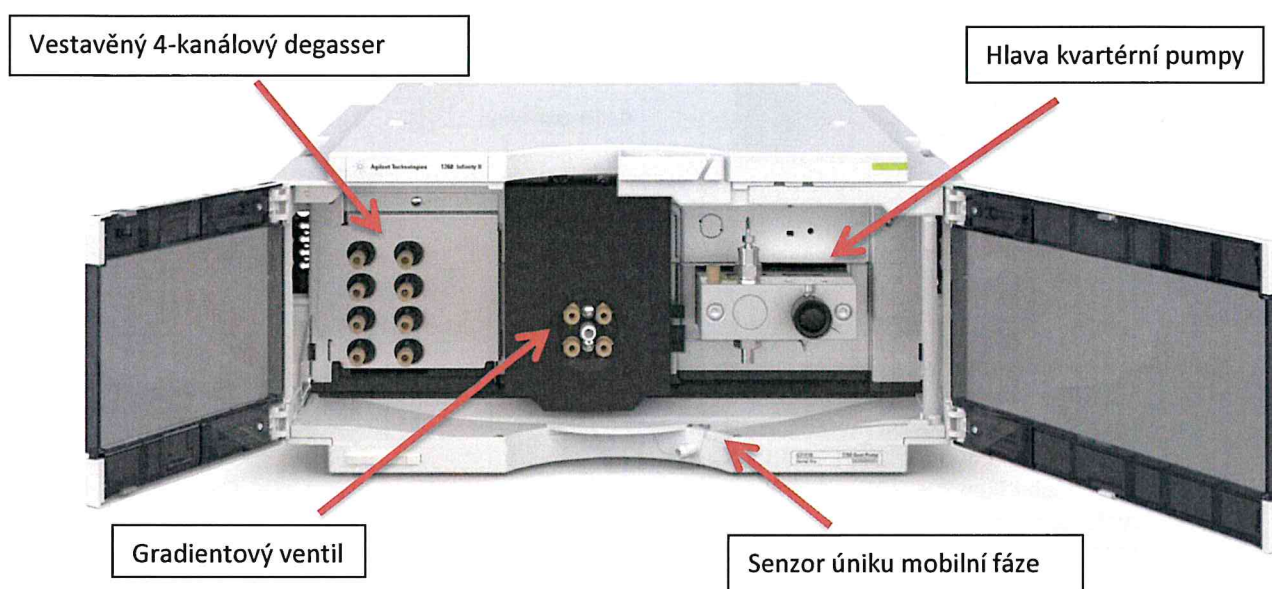


Technická specifikace čerpadla

- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích
- tlaková odolnost maximálně 600 bar (60 Mpa) až do průtoku 5 ml/min (G7110B)
- přesnost průtoku $\leq 0.07\%$ RSD
- integrovaný vakuový degaser
- integrovaný ventil pro přepínání mezi 3 mobilními fázemi
- pH rozsah 1.0 – 12.5
- hmotnost 14,7 kg
- rozměry (výška 180 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Vialsampler

G7129A – Vialsampler s integrovaným prostorem pro termostát kolon (verze 600 bar)

Nová generace a koncept autosampleru s integrovaným prostorem pro umístění až 2 chromatografických kolon. Robustní a především ekonomické řešení automatizace nástřiků při tlacích do 600 a 800 bar je ideální pro Vaše rutinní analýzy. Still-air princip ohřevu mobilní fáze v termostatu kolon zamezuje nežádoucímu radiálnímu přehřívání kolony, které prokazatelně při separacích za vyššího tlaku způsobuje snížení separační účinnosti na koloně až o 40%.

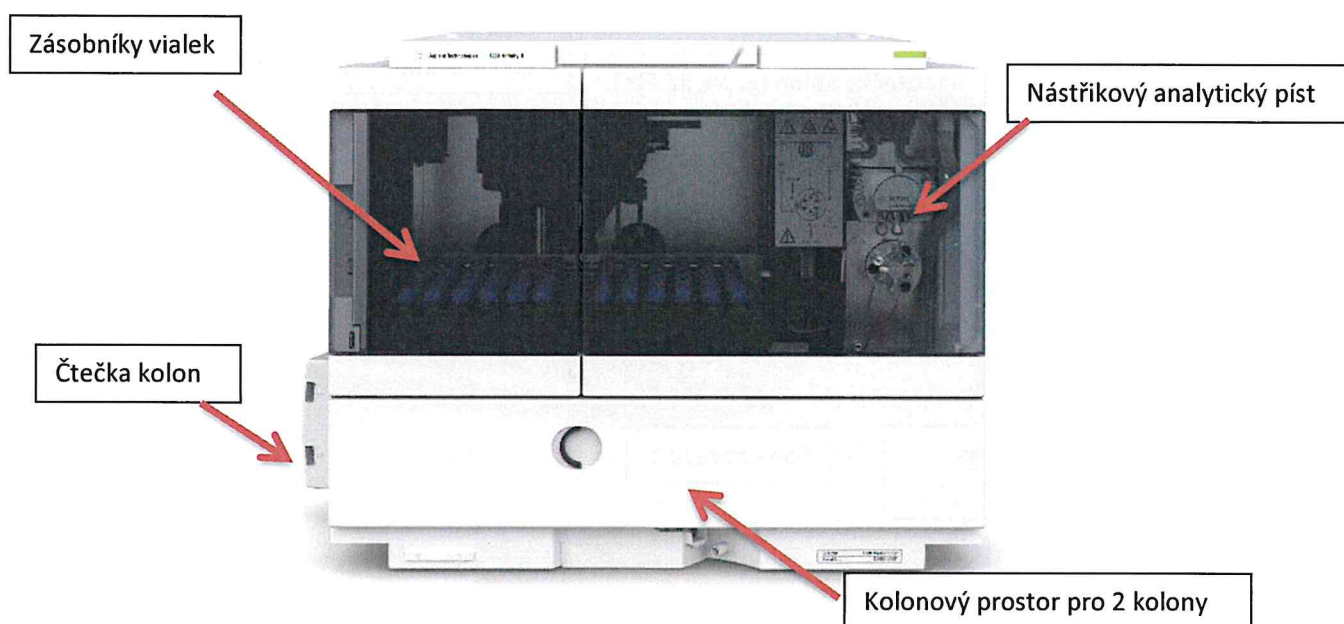


Technická specifikace Vialsampleru:

- flow-through design nástřikového systému, nástřik od 0.1 μ l do 100 μ l (v 0.1 μ l krocích)
- nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému
- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. přímo v dávkovací smyčce
- přesnost nástřiku <0.25 % RSD
- kapacita až 132ks 2 ml vialek nebo 36ks 6 ml vialek
- automatická identifikace zásobníku
- oplach jehly externím rozpouštědlem (peristaltické čerpadlo)
- carryover <0.004 % (40 ppm) pro chlorhexidine při oplachu jehly
- chlazení vzorků prostřednictvím integrovaného vysoce výkonného mini kompresoru v rozsahu do 4-40°C
- senzor úniku mobilní fáze

Termostat kolon

G7116B – Multikolonový termostat kolon (verze 1290 Infinity II)

Nová generace termostatu kolon s větší kapacitou kolon a novým 3D designem Quick-Connect Heat Exchanger pro zajištění nejúčinnějšího přechodu tepla (předkolonová temperace mobilní fáze). Je ideální volbou pro uživatele vyžadující temperování kolon při pokojových, nebo nižších teplotách. Možnost instalace integrovaného přepínacího ventilu umožní rozšířit aplikační využití HPLC systému.

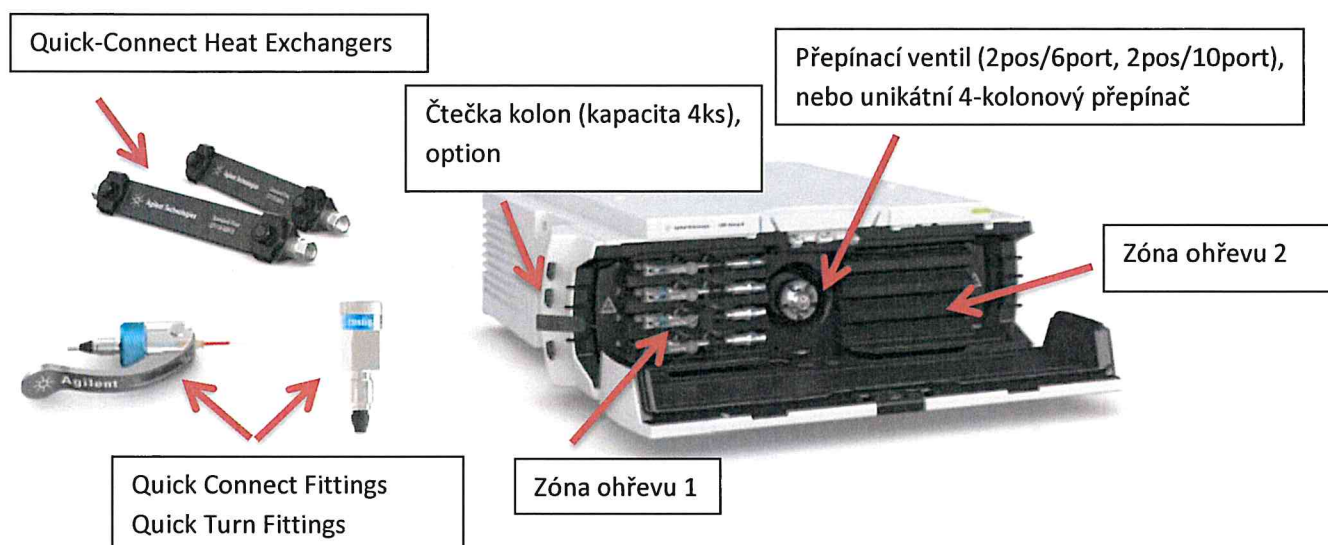



Technická specifikace Multikolonového termostatu kolon :

- teplotní rozsah od 20°C pod okolní teplotu (minimálně 4°C) až 110°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch
- teplotní stabilita $\pm 0,03$ °C
- rychlost ohřevu z pokojové teploty na 40°C během 5 minut
- rychlost chlazení z 40°C na 20°C během 10 minut
- dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná
- kapacita až 4 kusy 30-cm kolon, nebo 8 kusů 10-cm kolon (každá kolona může mít svůj vlastní heat exchanger)
- nový design dveří, umožňující odejmutí, otočení o 180° pro zajištění jednoduchého přístupu, nebo otočení o 90° pro využití jako stolku pro odložení kolony
- hmotnost 12,5 kg
- rozměry (výška 160 × šířka 435 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Detektory

G7115A – Detektor diodového pole WR (wide range)

Nová generace detektoru diodového pole s širokým rozsahem vlnových délek až do 950 nm. Detektor používá standardní (konvenční) konstrukci cely s rychlostí sběru dat až 120 Hz. Programovatelná šířka štěrbiny umožňuje uživatelům maximální flexibilitu při vývoji analytických metod. K dispozici je uživatelům na výběr až 12 analytických, preparativní a SFC průtočných cel.

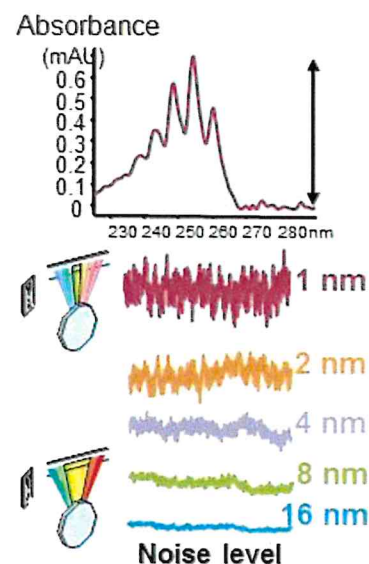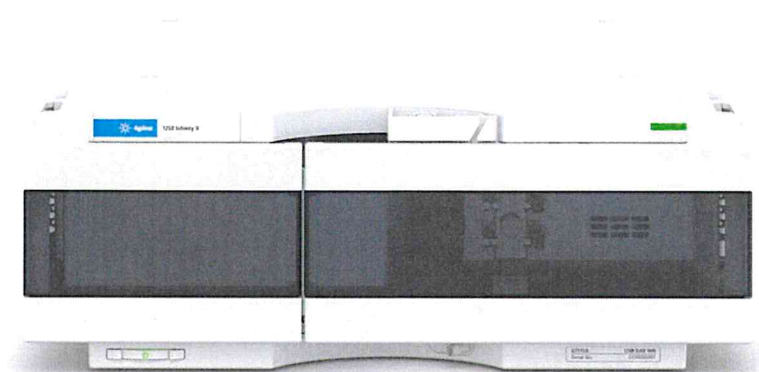

Technická specifikace detektoru diodového pole WR :


- zdroj světla deuteriová a wolframová lampa
- diodové pole s 1024 diodami
- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm
- programovatelná šířka štěrbiny (1-16 nm)
- přesnost nastavení vlnové délky ± 1 nm
- šum detektoru $< \pm 0.7 \cdot 10^{-5}$ AU při 254 a 750 nm
- drift detektoru $< 0.9 \cdot 10^{-3}$ AU/h při 254 nm
- lineární rozsah > 2 AU (5 %) při 265 nm
- možnosti sběru dat až při 8 vlnových délkách současně, možnost programování
- online sběr spekter a tvorba vlastní knihovny spekter
- rychlost sběru dat 120 Hz
- hmotnost 12 kg
- rozměry (výška 140 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Průtočná cela:

Standard flow cell délka 10mm a objem 13 μ L G7115A#018

G7162A – Refraktometrický detektor

Nová generace refraktometrického detektoru je ideální volbou pro detekci analytů které ve své struktuře neobsahují žádné chromofory nebo fluorofory. S ohledem na princip měření je možné tento typ detektoru využít pouze při isokratických analýzách. Nová generace detektorů nabízí především větší rychlost sběru dat a splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU - omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.


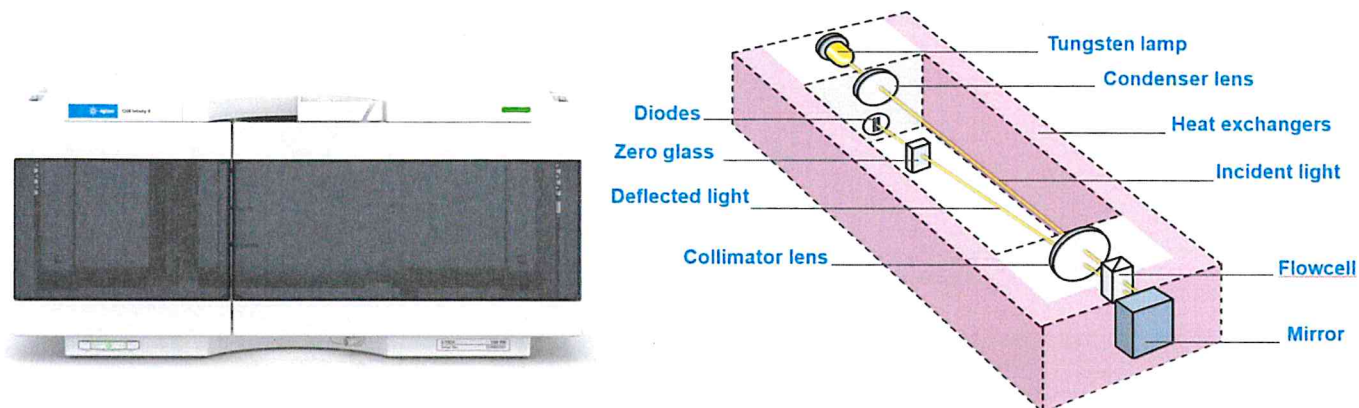


Technická specifikace Refraktometrického detektoru:

- typ detekce – deflekční metoda
- rozsah indexů lomu 1.00–1.75 RIU, kalibrováno
- krátkodobý šum $\leq \pm 1.25 \times 10^{-9}$ RIU
- rychlost sběru dat až 74 Hz
- měřicí rozsah detektoru $\pm 600 \times 10^{-6}$ RIU
- cela s objemem 8 μ l
- rozsah termostátování optiky od 5 °C nad okolní teplotu do 55 °C
- rozsah pH 2.3-9.5
- časově programovatelná polarita a šířka píku
- integrovaný automatický ventil na proplach a recyklaci mobilní fáze
- hmotnost 15 kg
- rozměry (výška 180 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

G1390A – 1200 Infinity Universal Interface Box II

- Modul, který umožní integrovat do chromatografického softwaru různé výrobce detektorů pro HPLC systémy
- Modul umožňuje vyhodnocovat data ze současného chromatografického softwaru

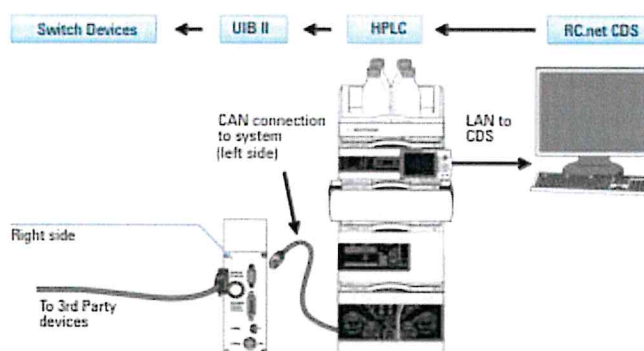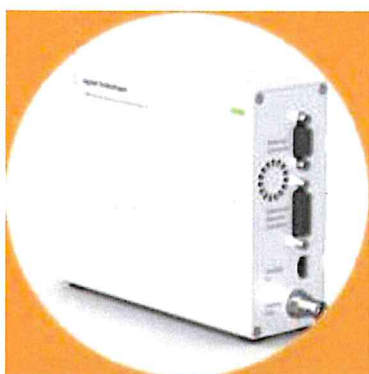


Sestava 3

Čerpadla 600 bar

G7112B - Binární vysokotlaké čerpadlo s vestavěným vakuovým degaserem

Nová generace binárních čerpadel poskytuje uživatelům především minimální mrtvý objem nutný pro rychlé gradientové metody. Nová generace přichází s již integrovaným 2-kanálovým vakuovým degaserem díky němuž se snižuje celková výška HPLC systému. Ideální čerpadlo pro rutinní aplikace ve spojení s UV a MS detektory.

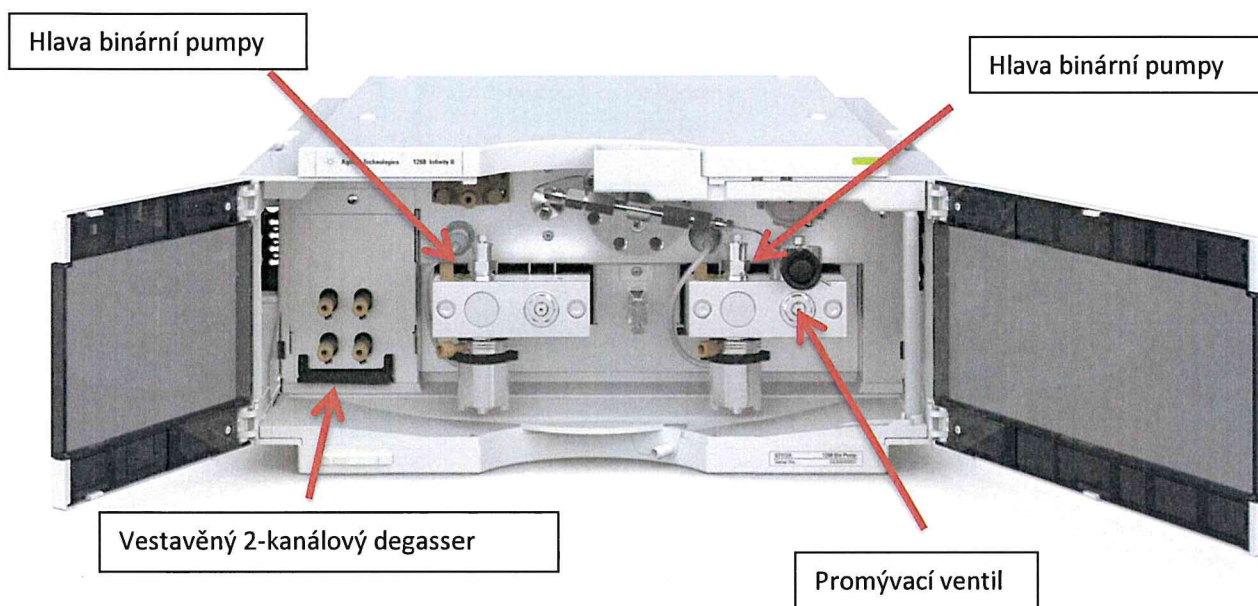


Technická specifikace čerpadel

- dvojice seriově zapojených pístů s plynule proměnným zdvihem
- vysokotlaké binární směšování
- aktivní oplach těsnění pístů
- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích
- nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze
- tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 Mpa) až do průtoku 5 ml/min
- přesnost mísení gradientu < 0.15 % RSD
- možnost mísení gradientu v rozmezí 0-100%
- přesnost průtoku ≤ 0.07 % RSD
- vestavěný 2-kanálový vakuový degaser
- pH rozsah 1.0 – 12.5
- mrtvý objem (low delay configuration: 120 µL)
- hmotnost 17,6 kg
- rozměry (výška 180 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Vialsampler

G7129A – Vialsampler s integrovaným prostorem pro termostát kolon (verze 600 bar)

Nová generace a koncept autosampleru s integrovaným prostorem pro umístění až 2 chromatografických kolon. Robustní a především ekonomické řešení automatizace nástřiků při tlacích do 600 a 800 bar je ideální pro Vaše rutinní analýzy. Still-air princip ohřevu mobilní fáze v termostatu kolon zamezuje nežádoucímu radiálnímu přehřívání kolony, které prokazatelně při separacích za vyššího tlaku způsobuje snížení separační účinnosti na koloně až o 40%.

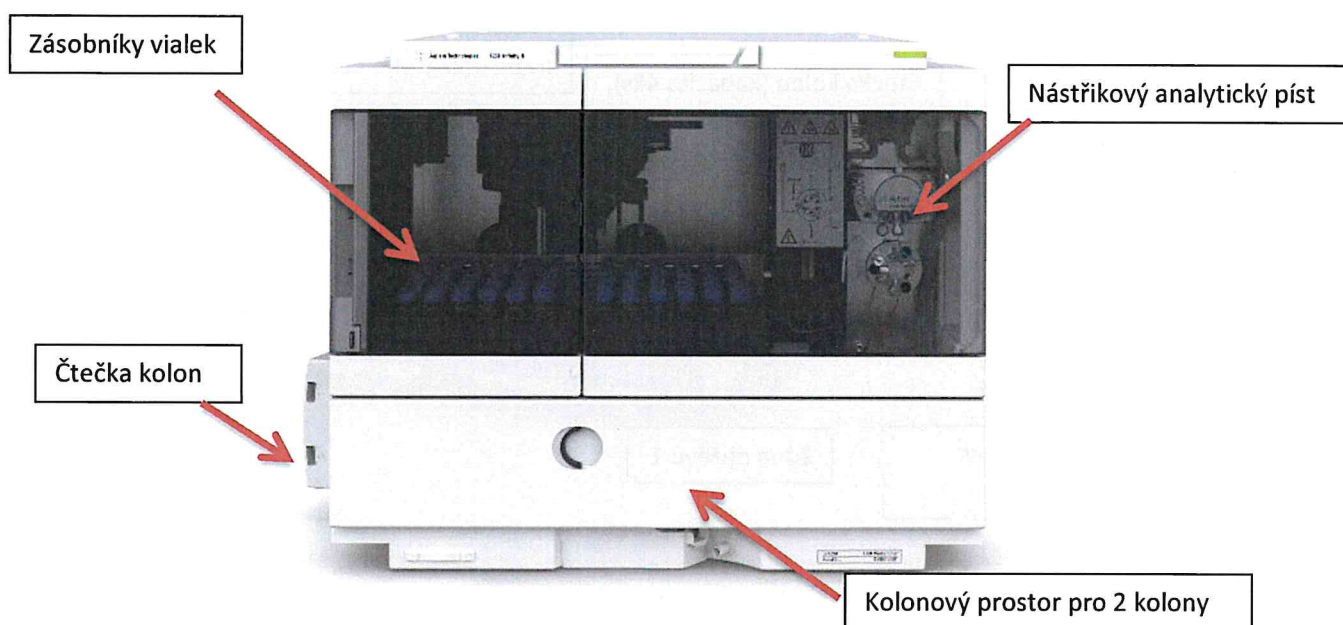


Technická specifikace Vialsampleru:

- flow-through design nástřikového systému, nástřik od 0.1 μ l do 100 μ l (v 0.1 μ l krocích)
- nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému
- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. přímo v dávkovací smyčce
- přesnost nástřiku <0.25 % RSD
- kapacita až 132ks 2 ml vialek nebo 36ks 6 ml vialek
- automatická identifikace zásobníku
- oplach jehly externím rozpouštědlem (peristaltické čerpadlo)
- carryover <0.004 % (40 ppm) pro chlorhexidine při oplachu jehly
- chlazení vzorků prostřednictvím integrovaného vysoce výkonného mini kompresoru v rozsahu do 4-40°C
- senzor úniku mobilní fáze

Termostat kolon

G7116B – Multikolonový termostat kolon (verze 1290 Infinity II)

Nová generace termostatu kolon s větší kapacitou kolon a novým 3D designem Quick-Connect Heat Exchanger pro zajištění nejúčinnějšího přechodu tepla (předkolonová temperace mobilní fáze). Je ideální volbou pro uživatele vyžadující temperovaní kolon při pokojových, nebo nižších teplotách. Možnost instalace integrovaného přepínacího ventilu umožní rozšířit aplikační využití HPLC systému.

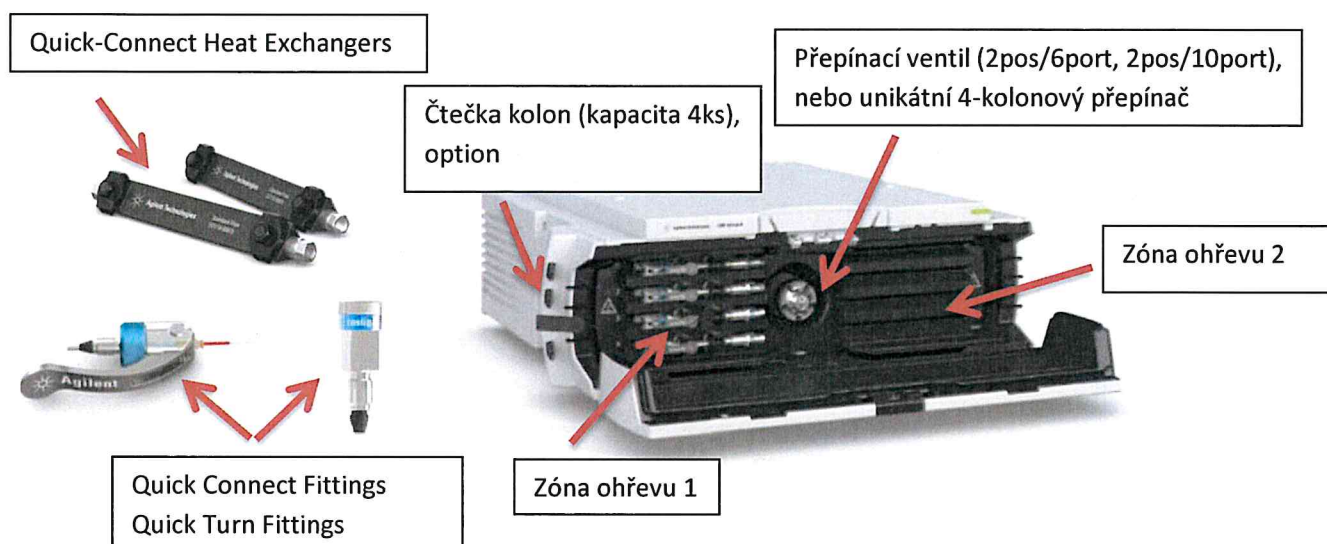



Technická specifikace Multikolonového termostatu kolon :

- teplotní rozsah od 20°C pod okolní teplotu (minimálně 4°C) až 110°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch
- teplotní stabilita $\pm 0,03$ °C
- rychlost ohřevu z pokojové teploty na 40°C během 5 minut
- rychlost chlazení z 40°C na 20°C během 10 minut
- dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná
- kapacita až 4 kusy 30-cm kolon, nebo 8 kusů 10-cm kolon (každá kolona může mít svůj vlastní heat exchanger
- nový design dveří, umožňující odejmutí, otočení o 180° pro zajištění jednoduchého přístupu, nebo otočení o 90° pro využití jako stolku pro odložení kolony
- hmotnost 12,5 kg
- rozměry (výška 160 × šířka 435 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Detektory

G7115A – Detektor diodového pole WR (wide range)

Nová generace detektoru diodového pole s širokým rozsahem vlnových délek až do 950 nm. Detektor používá standardní (konvenční) konstrukci cely s rychlostí sběru dat až 120 Hz. Programovatelná šířka štěrby umožňuje uživatelům maximální flexibilitu při vývoji analytických metod. K dispozici je uživatelům na výběr až 12 analytických, preparativní a SFC průtočných cel.

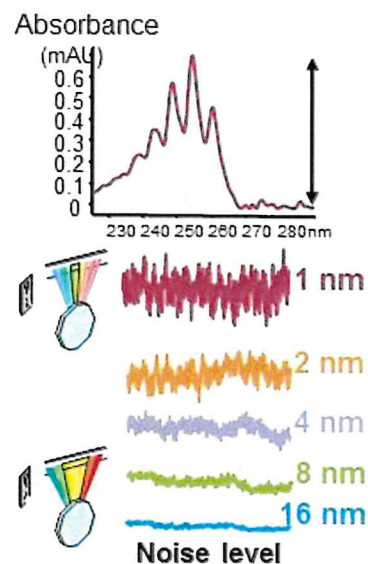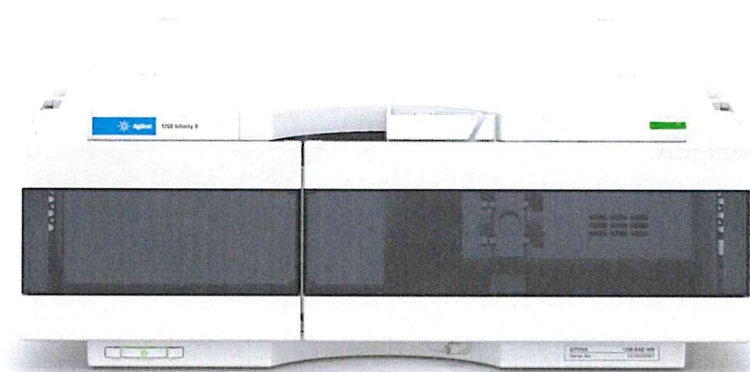

Technická specifikace detektoru diodového pole WR :


- zdroj světla deuteriová a wolframová lampa
- diodové pole s 1024 diodami
- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm
- programovatelná šířka štěrby (1-16 nm)
- přesnost nastavení vlnové délky ± 1 nm
- šum detektoru $< \pm 0.7 \cdot 10^{-5}$ AU při 254 a 750 nm
- drift detektoru $< 0.9 \cdot 10^{-3}$ AU/h při 254 nm
- lineární rozsah > 2 AU (5 %) při 265 nm
- možnosti sběru dat až při 8 vlnových délkách současně, možnost programování
- online sběr spekter a tvorba vlastní knihovny spekter
- rychlost sběru dat 120 Hz
- hmotnost 12 kg
- rozměry (výška 140 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

Průtočná cela:

Standard flow cell délka 10mm a objem 13 μ L G7115A#018

G7162A – Refraktometrický detektor

Nová generace refraktometrického detektoru je ideální volbou pro detekci analytů které ve své struktuře neobsahují žádné chromofory nebo fluorofory. S ohledem na princip měření je možné tento typ detektoru využít pouze při isokratických analýzách. Nová generace detektorů nabízí především větší rychlost sběru dat a splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU - omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

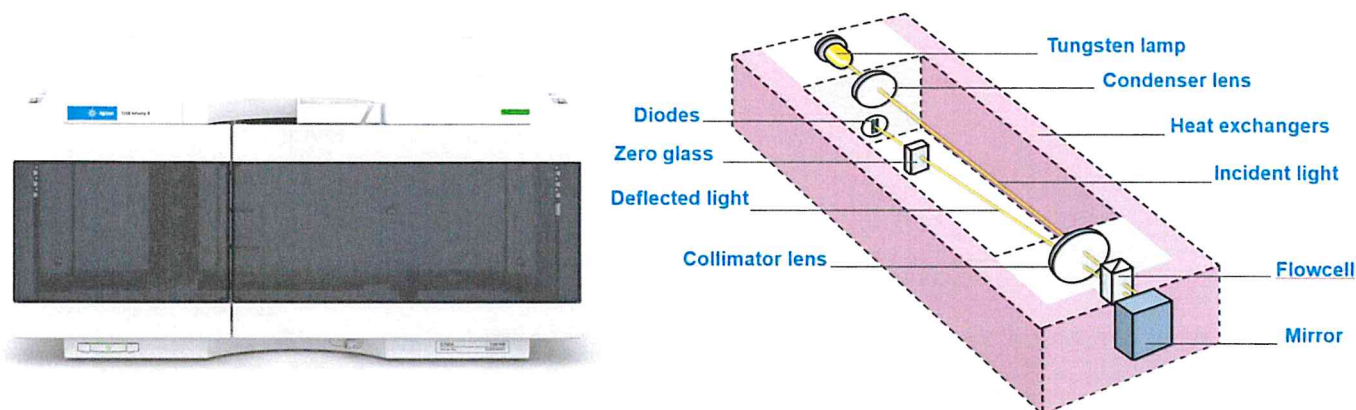


Technická specifikace Refraktometrického detektoru:

- typ detekce – deflekční metoda
- rozsah indexů lomu 1.00–1.75 RIU, kalibrováno
- krátkodobý šum $< \pm 1.25 \times 10^{-9}$ RIU
- rychlost sběru dat až 74 Hz
- měřicí rozsah detektoru $\pm 600 \times 10^{-6}$ RIU
- cela s objemem 8 μ l
- rozsah termostátování optiky od 5 °C nad okolní teplotu do 55 °C
- rozsah pH 2.3-9.5
- časově programovatelná polarita a šířka piku
- integrovaný automatický ventil na proplach a recyklaci mobilní fáze
- hmotnost 15 kg
- rozměry (výška 180 × šířka 396 × hloubka 436) mm
- senzor úniku mobilní fáze

G1390A – 1200 Infinity Universal Interface Box II

- Modul, který umožní integrovat do chromatografického softwaru různé výrobce detektorů pro HPLC systémy
- Modul umožňuje vyhodnocovat data ze současného chromatografického softwaru

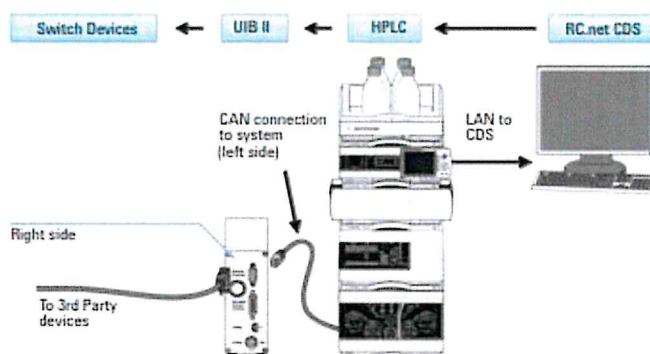

Software

- drivery pro připojení všech sestav do stávající sítě OpenLab CDS 2.4. (2.4.0.628)
- AIC server licence
- SW umožňuje diagnostické testy, údržbu a confirmaci uživatelem sestavy v místě plnění

Školení

- školení pro až 5 uživatelů v každém místě plnění v rozsahu 2 dnů
- pokročilé softwarové školení (OpenLab CDS) pro 3 osoby v rozsahu 4 dny/osobu

Dodavatel:

Altium International s.r.o.
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9
Česká republika

Odběratel:

Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7
14096 Praha 4
Česká republika

IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079
Tel.: +420 244001231
Web: www.hpst.cz
E-mail: info@hpst.cz

IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Dodací adresa:

Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7
14096 Praha 4
Česká republika

Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568.

Datum dokladu: xxx Doprava: xxx
Číslo zásilky:

Číslo	Popis	MJ	Množství
Kupní smlouva č. xyz			
	Agilent 1260 Infinity II ISO UV+RI		
G7110B	1260 Infinity II Isocratic Pump	ks	1
	G7110B#001:1ks:HPLC System Tool Kit 1260 Infinity II		
	G7110B#034:1ks:Integrated Degasser + Solvent Selection		
	G7110B#094:1ks:Poroshell 120 EC-C18 3.0x150mm, 2.7um		
G7129A	1260 Infinity II Vialsampler	ks	1
	G7129A#010:1ks:Standard drawer (6x11 vials)		
	G7129A#060:1ks:Use existing license		
	G7129A#101:1ks:Agilent InfinityLab Sample Thermostat		
G7116B	1290 Infinity II Multicolumn Thermostat	ks	1
	G7116B#058:1ks:Valve drive for 1290 Infinity II MCT		
G4231A	2pos/6port Valve head, 800 bar	ks	1
	G4231A#004:1ks:2/6 cap kit 0.12 mm ID, LDHE double		
G7114A	1260 Infinity II VW Detector	ks	1
	G7114A#018:1ks:Standard flow cell VWD		
G7162A	1260 Infinity II RI detector	ks	1
M8431AA	OpenLab CDS Instrument Connection	ks	1
	M8431AA#001:1ks:LC Instrument Connection		
M8431AA	OpenLab CDS Instrument Connection	ks	1
	M8431AA#001:1ks:LC Instrument Connection		
M8420AA	OpenLab CDS AIC Software	ks	1
H300000_01	Školení obsluhy, ext, OpenLAB, (1 os.)	ks	3
H300000_04	Školení obsluhy, int (1-5 os.)	ks	2



Předávací protokol č. xyz

Číslo PO: xyz

Číslo objednávky: xyz

Dodavatel

Datum

Příjemce

Datum

Dodavatel:

Altium International s.r.o.
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9
Česká republika

IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079
Tel.: +420 244001231
Web: www.hpst.cz
E-mail: info@hpst.cz

Odběratel:

Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7
14096 Praha 4
Česká republika

IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Dodací adresa:

Generální ředitelství cel
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Bohuslava Martinů 1672/8a
50101 Hradec Králové
Česká republika

Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568.

Datum dokladu: xxx Doprava: xxx
Číslo zásilky:

Číslo	Popis	MJ	Množství
Kupní smlouva č. xyz			
	Agilent 1260 Infinity II ISO DAD+RI		
G7110B	1260 Infinity II Isocratic Pump	ks	1
	G7110B#001:1ks:HPLC System Tool Kit 1260 Infinity II		
	G7110B#034:1ks:Integrated Degasser + Solvent Selection		
	G7110B#094:1ks:Poroshell 120 EC-C18 3.0x150mm, 2.7um		
G7129A	1260 Infinity II Vialsampler	ks	1
	G7129A#010:1ks:Standard drawer (6x11 vials)		
	G7129A#060:1ks:Use existing license		
	G7129A#101:1ks:Agilent InfinityLab Sample Thermostat		
G7116B	1290 Infinity II Multicolumn Thermostat	ks	1
G7115A	1260 Infinity II Diode Array Detector WR	ks	1
	G7115A#018:1ks:Standard flow cell 10mm, 13uL, 120bar		
G7162A	1260 Infinity II RI detector	ks	1
G1390B	1200 Infinity Universal Interface Box II	ks	1
M8431AA	OpenLab CDS Instrument Connection	ks	1
	M8431AA#001:1ks:LC Instrument Connection		
	M8431AA#005:1ks:3D UV/DAD Connection		
M8431AA	OpenLab CDS Instrument Connection	ks	1
	M8431AA#001:1ks:LC Instrument Connection		
	M8431AA#005:1ks:3D UV/DAD Connection		
H300000_04	Školení obsluhy, int (1-5 os.)	ks	2



Předávací protokol č. xyz

Číslo PO: xyz

Číslo objednávky: xyz

Dodavatel _____

Datum _____

Příjemce _____

Datum _____

Dodavatel:

Altium International s.r.o.
Na Jetelce 69/2
19000 Praha 9
Česká republika

IČ: 25791079
DIČ: CZ25791079
Tel.: +420 244001231
Web: www.hpst.cz
E-mail: info@hpst.cz

Odběratel:

Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7
14096 Praha 4
Česká republika

IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Dodací adresa:

Generální ředitelství cel
Celní úřad pro Moravskoslez. kraj
Náměstí Svatopluka Čecha 4
70209 Ostrava
Česká republika

Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568.

Datum dokladu:	xxx	Doprava:	xxx
		Číslo zásilky:	
Číslo	Popis	MJ	Množství
Kupní smlouva č. xyz			
	Agilent 1260 Infinity II BIN DAD+RI		
G7112B	1260 Infinity II Binary Pump	ks	1
	G7112B#001:1ks:HPLC System Tool Kit 1260 Infinity II		
	G7112B#030:1ks:Active Seal Wash		
	G7112B#094:1ks:Poroshell 120 EC-C18 3.0x150mm, 2.7um		
G7129A	1260 Infinity II Vialsampler	ks	1
	G7129A#010:1ks:Standard drawer (6x11 vials)		
	G7129A#060:1ks:Use existing license		
	G7129A#101:1ks:Agilent InfinityLab Sample Thermostat		
G7116B	1290 Infinity II Multicolumn Thermostat	ks	1
G7115A	1260 Infinity II Diode Array Detector WR	ks	1
	G7115A#018:1ks:Standard flow cell 10mm, 13uL, 120bar		
G7162A	1260 Infinity II RI detector	ks	1
G1390B	1200 Infinity Universal Interface Box II	ks	1
M8431AA	OpenLab CDS Instrument Connection	ks	1
	M8431AA#001:1ks:LC Instrument Connection		
	M8431AA#005:1ks:3D UV/DAD Connection		
M8431AA	OpenLab CDS Instrument Connection	ks	1
	M8431AA#001:1ks:LC Instrument Connection		
	M8431AA#005:1ks:3D UV/DAD Connection		
H300000_04	Školení obsluhy, int (1-5 os.)	ks	2



Předávací protokol č. xyz

Číslo PO: xyz

Číslo objednávky: xyz

Dodavatel _____

Datum _____

Příjemce _____

Datum _____

Příloha č. 3 ZD - Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Název:	Zajištění dodávky 3 ks sestav kapalinových chromatografů s detekcí DAD/UV-VIS a RID včetně licence pro připojení ke stávajícímu analytickému SW OpenLab	
zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ")		
Zadavatel		
Název:	Česká republika - Generální ředitelství cel	
Sídlo:	Budějovická 7, 140 96 Praha 4	
IČO:	71214011	
Dodavatel		
obchodní firma/název/jméno a příjmení:	Altium International s.r.o.	
sídlo/místo podnikání dodavatele:	Na Jetelce 69/2, Praha 9, 190 00	
korespondenční adresa:	Na Jetelce 69/2, Praha 9, 190 00	
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jedenat jménem či za dodavatele:		
IČO:	25791079	
DIČ:	CZ25791079	
kontaktní osoba:		
telefonní spojení:		
e-mailová adresa:		
bankovní spojení:		
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES	ANO	
Nabídková cena		
Nabídková cena v Kč bez DPH	4 925 430.00 Kč	
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu v %]	21.00%	1 034 340.30 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	5 959 770.30 Kč	
Vybrané technické parametry		
Kolonový termostát - rozsah teplot (v °C)	[DODAVATEL do žlutého pole vyplní konkrétní údaj]	4°C-110°C

Kolonový termostat - teplotní stabilita (v °C)	[DODAVATEL do žlutého pole vyplní konkrétní údaj]	+/- 0,03°C
DA detektor - počet diod diodového pole	[DODAVATEL do žlutého pole vyplní konkrétní údaj]	1024
DA detektor - počet vinových délek pro současný sběr dat	[DODAVATEL do žlutého pole vyplní konkrétní údaj]	8
Čestné prohlášení k vázanosti Záväzným vzorem smlouvy		
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Záväzný vzor smlouvy a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena smlouva v souladu s tímto Záväzným vzorem smlouvy.		
E-mailová adresa pro nahlašování závad dle čl. VII. odst. 3		
Záväzného vzoru smlouvy		
servis@hpst.cz		
Osoba oprávněná jednat za dodavatele		
Podpis oprávněné osoby	Dne	dle el. podpisu
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

pozn: dodavatel vyplní žlutě vyznačená pole

TELEFON: 26133-1111
IČ 72114011

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

