

## Kupní smlouva

**AKC konstrukce, s.r.o.**

se sídlem: Pivovarská 10, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČO: 63322731  
DIČ: CZ63322731  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl , vložka 13470  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: [REDAKCE]  
kontaktní osoba: [REDAKCE]  
(dále jako „**prodávající**“)

a

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13  
IČO: 25488627  
DIČ: CZ25488627  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: [REDAKCE]  
kontaktní údaje: [REDAKCE]

(dále jako „**kupující**“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní  
strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě řejné zakázky názvem:

**Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.**

**Část zakázky 1 - Zásuvkové vozíky a speciální nerezové vybavení**

Účelem této smlouvy je zejména nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné  
provozní schopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v  
záruční době.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: zásuvkové vozíky a speciální nerezové vybavení (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - technická specifikace, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy také je:
  - *doprava zboží do místa plnění,*
  - *montáž zboží,*
  - *instalace zboží,*
  - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
  - *ověření deklarovaných technických parametrů nabízených položek dle technické specifikace,*
  - *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o instruktáži,*
  - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
  - *záruční serv s dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
  - *likvidace obalového materiálu.*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

## Článek II.

### Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 4 764 100,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „ “).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočten DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnut i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
  - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na smlouvu uv dením názvu smlouvy a dodaného zboží,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
  - soupis příloh.

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání softwar aňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software,

- verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
  8. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu fakture jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího, opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
  9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím 0 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Proávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
  10. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znov novou lhůtou splatnosti v délce kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
  11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího příslušný účet prodávajícího.
  12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Pokud kupující nevyzve prodávajícího k plnění do 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy, vznikne prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy do 10 kalendářních dní po marném uplynutí lhůty na učinění výzvy k plnění. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupce kupujícího je: [REDACTED]

2. Za předání zboží se považuje:
  - a.  *dodání zboží na adresu:*  
**Krajská zdravotní, - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov - PAVILON J - Emergency, COS a JIP.**
  - b.  *montáž zboží*
  - c.  *instalace zboží*
  - d.  *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti*
  - e.  *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle §41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o instruktáži*
  - f.  *dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícími požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém*

jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, případě zdravotnického prostředku kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů,

g. likvidace obalového materiálu,

h. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“). Převzít zboží a podepsat Protokol o předání zboží je oprávněn za kupujícího: [redacted] referent Úseku ředitele, [redacted] [redacted] nebo [redacted] technik Oddělení zdravotnické techniky, [redacted]

#### IV.

##### Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

#### V.

##### Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
  - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
  - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně její příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvyklé na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladené) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24 (slovy: dvacet čtyři)** měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § a násl. zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní

- strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDAKCE] email: [REDAKCE]
  8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
  9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než kalendářní ú. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
  10. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9. tohoto článku, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
  11. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
  12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
  13. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10. tohoto článku.
  14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

## VI.

### Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9. smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného náhradního zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádné odstranění vad zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

## VII.

### Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

## VIII.

### Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu, s výjimkou těch ustanovení, které výslovně a zřetelně čí ve smlouvě jako své obchodní tajemství v souladu s právními předpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, zajistí předání elektronického obrazu smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněn prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku . Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
6. Prodávající povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
8. Prodávající má povinnost mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli a třetí osobě s minimální výší maximálního pojistného plnění 1.000.000 Kč.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Není li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.

2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
9. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - Technická specifikace



Příloha č. 2 - Rozklad ceny

V Ústí nad Labem, dne .....

V Rožnově p.R.,

Za kupujícího

Za prodávajícího



**Část 1 - Nemocnice Chomutov: Urgentní příjem**

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů vozíků akceptován toleranční rozsah  $\pm 5\%$ .

Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI304, ČSN17240).


Zadavatel u předmětu plnění požaduje technické provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud účastník nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na technické provedení konstrukce bez děr, záhybů či jiných otvorů vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.

Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.

**Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.**

**Kód  
položky**      **Název**

T-6507	Vozík s galerkou (odběry, převazy)	ANO/NE	Nabízený parametr
	rozměry bez příslušenství: Š90cm x h 58 cm	ANO	90x58 cm
	konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO	dvouplášťová ocel, barva RAL 9002
	prac. deska: nerez ocel AISI304; nosnost: min. 20 kg	ANO	nerezová pracovní deska, nosnost 30 kg
	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit oříčkami: nosnost: min. 20 kg	ANO	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělení příčkami, nosnost 20 kg
	1 x 1/1 zásuvka výšky 15 cm	ANO	1 x zásuvka 90x15cm
	4 x 1/2 zásuvka výšky cca 15 cm	ANO	4 x zásuvka 45x15cm
	2 x 1/2 zásuvka výšky cca 30 cm	ANO	2 x zásuvka 45x30cm
	čela zásuvek v barvě dle vzorníku Ral	ANO	dle vzorníku výrobce
	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
	centrální zamykání	ANO	centrální zamykání
	madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
	boční madlo nerez	ANO	nerezové boční madlo
	4 x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
	celková nosnost: min. 135 kg	ANO	nosnost 135 kg






příslušenství přestavitelné bez použití nářadí	ANO	přestavitelné příslušenství bez použití nářadí
odpadkový koš	ANO	nerezový odpadkový koš
3 x výškově stavitelný nerez držák 200 ks rukavic nad pracovní plochou	ANO	3 x nerezový držák na 200ks rukavic s magnetickým uchycením
1 x drátěný koš nad držákem rukavic 57x28x13	ANO	drátěný košík 57,5x28x13,5 cm

**T-6509 Vozík víceúčelový 2-podlažní, nerez se zásuvkou**

velikost plata cca 65 x 50 cm, výška 93 cm	ANO	rozměr plata 64x49cm, výška vozíku 93cm
konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha	ANO	nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
2x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min.: 40 kg	ANO	2 x plato s prolisem 1,2cm, nosnost 50kg
prachotěsná zásuvka: kompaktní plast, čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovaná ocel, lze rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg	ANO	prachotěsná zásuvka, kompaktní plastové čelo (ABS), lze rozdělit příčkami, nosnost 20kg
zásuvka 1x v 12 cm	ANO	zásuvka 1 x 12 cm
čelo zásuvky výběr z barev dle vzorníku RAL	ANO	výběr barev dle vzorníku výrobce
centrální zamykání	ANO	centrální zamykání
4x kvalitní otočné plastové kolo d min.=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné plastové kolo pr. 12,5 cm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost: min. 100 kg	ANO	nosnost 120kg

**T-6528 Vozík resuscitační**

rozměry bez příslušenství Š60cm x h 58 cm	ANO	60x58 cm
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO	dvouplášťová ocel, barva RAL 9002
prac. deska: nerez ocel AISI304; nosnost: min. 20 kg	ANO	nerezová pracovní deska, nosnost 30kg
prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami; nosnost: min.20 kg	ANO	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělení příčkami, nosnost 20 kg
1 x zásuvka výšky cca 10 cm RAL9010	ANO	1 x zásuvka 60x10 cm, RAL 9010
3 x zásuvka výšky cca 15cm RAL3001	ANO	3 x zásuvka 60x15 cm, RAL 3001
1 x zásuvka výšky cca 20 cm s dělením na 3 části RAL3001	ANO	1 x zásuvka 60x20 cm, s dělením na 3 části, RAL3001

teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
centrální zamykání	ANO	centrální zamykání
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
bez postranního madla	ANO	bez bočního madla
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost: min. 135 kg	ANO	nosnost 135 kg
sklopný/výsuvný stolec z nerez oceli AISI304 min. 30 cm; nosnost min: 8 kg	ANO	nerezový sklopný stolec 50x59,5cm, nosnost 10kg
		
příslušenství přestavitelné bez použití nářadí	ANO	přestavitelné příslušenství bez použití nářadí
držák kontejneru na použité jehly	ANO	držák kontejneru na použité jehly
2x výškově stavitelný nerez držák 200 ks rukavic	ANO	2 x nerezový držák na 200ks rukavic s magnetickým uchycením
galerka s 5 výklopnými boxy	ANO	nástavba s 5 výklopnými boxy

### Část 1 - Nemocnice Chomutov: ARO

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů vozíků akceptován toleranční rozsah  $\pm 5\%$ .

Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI304, ČSN17240).

Zadavatel u předmětu plnění požaduje technické provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud účastník nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na technické provedení konstrukce bez děr, záhybů či jiných otvorů vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.


Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.

**Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.**

**Kód**      **Název**  
**položky**

K-0196	Skříň na podložní mísy a močové lahve	ANO/NE	Nabízený parametr
	Skříň - rozměry: 600x600x2100	ANO	600x570x2100 mm

úchyty na bažanty a podložní mísy

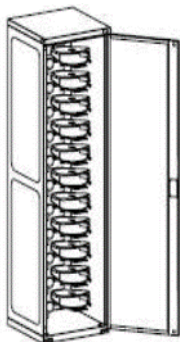

1-dvěřová  
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou  
barvou RAL9002

Dveře musí být opatřené celoobvodovým  
těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260°

Povrch upravený práškovou  
epoxypolyesterovou barvou, barevné  
provedení čelních ploch dle vzorníku  
výrobce, (dveře lakovány i z vnitřní strany).

ANO držáky na podložní mísy  
a močové láhve


ANO jednodvěřová

ANO dvouplášťová ocel s  
práškovou barvou RAL  
9002

ANO celoobvodové těsnění,  
úhel otevření 270°

ANO prášková  
epoxypolyesterová  
barva i z vnitřní strany  
dveří, dle vzorníku  
výrobce

#### T-6504 Vozík nemocniční, asistenční, 4 zásuvky (pacienti)



rozměry bez příslušenství: Š60 cm x h 58 cm  
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou  
barvou RAL9002

prac. deska: nerez ocel AISI304 - s  
třístrannou galerií; nosnost: min. 20 kg

prachotěsné zásuvky: možnost rozdělit  
příčkami; nosnost: min. 20 kg

1 x zásuvka výška cca 15 cm s dělením na 9  
částí, RAL9010

2 x zásuvka výšky cca 15cm, RAL7035

1 x zásuvka výšky cca 30cm, RAL7035

teleskopické kuličkové plnovýsuvy s  
dotahem a dotlumením

centrální zamykání

ANO 60x58 cm

ANO dvouplášťová ocel s  
práškovou barvou  
RAL9002

ANO nerezová pracovní  
deska s třístrannou  
galerií, nosnost 30kg

ANO prachotěsné zásuvky s  
možností rozdělit  
příčkami, nosnost 20kg

ANO 1 x zásuvka 60x15 cm,  
dělení na 9 částí, RAL  
9010

ANO 2 x zásuvka 60x15 cm,  
RAL7035

ANO 1 x zásuvka 60x30 cm,  
RAL7035

ANO teleskopické  
kuličkové plnovýsuvy  
s dotahem a  
dotlumením

ANO centrální zamykání

madla zásuvek kovová  
bez postranního madla  
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x  
brzda; plastové nárazníky

celková nosnost min: 135 kg  
sklopný/výsuvný stolek z nerez oceli AISI304  
min. 30 cm; nosnost min: 8 kg



příslušenství přestavitelné bez použití nářadí

držák kontejneru na použité jehly

9 ks plastových výklopných boxů s aretací,  
konzole pro uchycení na záda vozíku,  
spojovací materiál

1x výškově stavitelný nerez držák 100 ks  
rukavic

2x výškově stavitelný nerez držák 200 ks  
rukavic

odpadkový zavíratelný koš

ANO	kovová madla zásuvek
ANO	bez bočního madla
ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
ANO	nosnost 135 kg
ANO	nerezový sklopný stolek 50x59,5cm, nosnost 10kg
ANO	přestavitelné příslušenství bez použití nářadí
ANO	držák kontejneru na použité jehly
ANO	nástavba pro vozík s 9 ks plastových výklopných boxů s aretací
ANO	1 x nerezový držák na 100ks rukavic s magnetický uchycením
ANO	2 x nerezový držák na 200ks rukavic s magnetický uchycením
ANO	nerezový odpadkový koš s víkem

### T-6510 Vozík zdravotnický, multifunkční (hygiena pacienta)



rozměry bez příslušenství Š60cm x h 58 cm  
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou  
barvou RAL9002


prac. deska: nerez ocel AISI304; nosnost:  
min. 20 kg

prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit  
příčkami; nosnost: min. 20 kg

1 x zásuvka výšky cca 10 cm, RAL9010

ANO	60x58 cm
ANO	dvouplášťová ocel s práškovou barvou RAL9002
ANO	nerezová pracovní deska, nosnost 30 kg
ANO	prachotěsné zásuvky s možností rozdělit příčkami, nosnost 20kg
ANO	1 x zásuvka 60x10 cm, RAL9010

1 x zásuvka výšky cca 15 cm, RAL1018	ANO	1 x zásuvka 60x15 cm, RAL1018
1 x zásuvka výšky cca 20 cm, RAL1018	ANO	1 x zásuvka 60x20 cm, RAL1018
1 x zásuvka výšky cca 30 cm s dělením na 3 části, RAL1018	ANO	1 x zásuvka 60x30 cm, dělení na 3 části, RAL1018
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
nerez postranní tlačné madlo	ANO	boční tlačné madlo
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost min: 135 kg	ANO	nosnost 135 kg
sklopný/výsuvný stolek z nerez oceli AISI304 min. 30 cm; nosnost min: 8 kg	ANO	nerezový sklopný stolek 50x59,5cm, nosnost 10kg
příslušenství přestavitelné bez použití nářadí	ANO	přestavitelné příslušenství bez použití nářadí
držák kontejneru na použité jehly	ANO	držák kontejneru na použité jehly

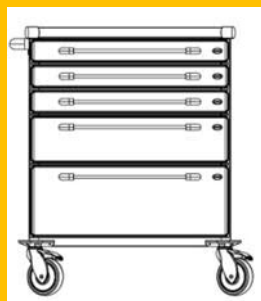**T-6528 Vozík resuscitační**

rozměry bez příslušenství Š60 cm x h 58 cm	ANO	60 x 58 cm
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO	dvouplášťová ocel, barva RAL9002
prac. deska: nerez ocel AISI304; nosnost: min. 20 kg	ANO	nerezová pracovní deska, nosnost 30kg
prachotěsné zásuvky: možnost rozdělit příčkami; nosnost: min.20 kg	ANO	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělení příčkami, nosnost 20 kg
1 x zásuvka výšky cca 10cm RAL9010	ANO	1 x zásuvka 60x10 cm, RAL9010
3 x zásuvka výšky cca 15cm RAL3001	ANO	3 x zásuvka 60x15 cm, RAL3001

1 x zásuvka výšky cca 20cm s dělením na 3 části RAL 3001

teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením

centrální zamykání  
madla zásuvek kovová

bez postranního madla  
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky



celková nosnost min: 135 kg  
sklopný/výsuvný stolek z nerez oceli AISI304 min. 30 cm; nosnost min: 8 kg

příslušenství přestavitelné bez použití nářadí

držák kontejneru na použité jehly

2x výškově stavitelný nerez držák na 200 ks rukavic

galerka s 5 výklopnými boxy

ANO 1 x zásuvka 60x20 cm, s dělením na 3 části, RAL 3001

ANO teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením

ANO centrální zamykání

ANO kovová madla zásuvek

ANO bez bočního madla

ANO 4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky

ANO nosnost 135 kg

ANO nerezový sklopný stolek 50x59,5cm, nosnost 10kg


ANO přestavitelné příslušenství bez použití nářadí

ANO držák kontejneru na použité jehly

ANO 2 x nerezový držák na 200ks rukavic s magnetickým uchycením

ANO nástavba s 5 výklopnými boxy

### T-6529 Vozík na ošetřování ran



rozměry bez příslušenství Š90 cm x h 58 cm  
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002

prac. deska: nerez ocel AISI304; nosnost: min. 20 kg

prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg

ANO 90x58 cm

ANO dvouplášťová ocel, barva RAL9002

ANO nerezová pracovní deska, nosnost 30kg

ANO prachotěsné zásuvky, možnost rozdělení příčkami, nosnost 20 kg

1 x zásuvka výšky cca 15cm s posuvným předělem, RAL 9010	ANO	1 x zásuvka 90x15 cm, s posuvným předělem, RAL 9010
1 x zásuvka výšky cca 15cm s posuvným předělem, RAL 1015	ANO	1 x zásuvka 90x15 cm, s posuvným předělem, RAL 1015
3 x zásuvka výšky cca 15cm, RAL 1015	ANO	3 x zásuvka 90x15 cm, RAL 1015
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
nerez postranní tlačné madlo	ANO	nerezové tlačné madlo
4 x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost min: 135 kg	ANO	nosnost 135 kg

### Část 1 - Nemocnice Chomutov: COS

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů vozíků akceptován toleranční rozsah  $\pm 5\%$ .




Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI304, ČSN17240).

Zadavatel u předmětu plnění požaduje technické provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud účastník nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na technické provedení konstrukce bez děr, záhybů či jiných otvorů vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.

Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.

**Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.**

**Kód**  
**Název**  
**položky**

Kód	Název		ANO/NE Nabízený parametr
T-2001	<b>Skříň na materiál</b>  pojízdná konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002 20 pozic na ISOkoše 60 x 40 cm hloubky 10 cm včetně ISOkošů Uzavíratelná, dveře otevíratelné o 270° s aretací v otevřené poloze, barva viz. příloha Barevné řešení. 4x kvalitní otočné kolo d min.=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		ANO pojízdná ANO dvouplášťová ocel, RAL9002 ANO 20 pozic na ISOkoše hloubky 10cm ANO 20x ISOkoše hloubky 10cm ANO uzavíratelná, dveře otevíratelné o 270° s aretací v otevřené poloze, barva dle vzorníku výrobce ANO 4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, 2 x elektronicky vodivé, plastové nárazníky
T-5415	<b>Držák na rukavice nerez</b>  horizontální držák na libovolné balení libovolných rukavic s magnetickým uchycením  rozměry kompatibilních balení rukavic: 220 x 68 x 105 mm až 285 x 90 x 135 mm  materiál - nerezová ocel		ANO horizontální držák na 3 balení rukavic s magnetickým uchycením ANO pro balení rukavic 220x68x105mm až 285x90x135mm ANO nerezová ocel
T-4559	<b>Vozík dvě zásuvky, spodní prostor otevřený</b>		ANO velikost plata cca 65 x 50 cm, výška 93 cm ANO rozměr plata 64x49cm, výška vozíku 93cm




konstrukce: nerez ocel AISI304,	ANO	nerez ocel
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg	ANO	2 x plato s prolisem 1,2cm, nosnost 50kg
prachotěsná zásuvka: kompaktní plast, čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovaná ocel, lze rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg	ANO	prachotěsná zásuvka, kompaktní plastové čelo (ABS), lze rozdělit příčkami, nosnost 20kg
2 x zásuvka hloubka cca 12 cm	ANO	2 x zásuvka, hloubka 12cm
držák kontejneru na použité jehly	ANO	držák kontejneru na použité jehly
4x otočné kolo d min=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
nosnost min. 110 kg	ANO	nosnost 140kg

#### T-6506 Vozík přístrojový pojízdný, 1 zásuvka, nerez




velikost plata cca 65 x 50 cm, výška 93 cm	ANO	rozměr plata 64x49cm, výška vozíku 93cm
konstrukce: nerez ocel AISI304,	ANO	nerez ocel
2x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min.: 40 kg	ANO	2 x plato s prolisem 1,2cm, nosnost 50kg
prachotěsná zásuvka: kompaktní plast, čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovaná ocel, lze rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg	ANO	prachotěsná zásuvka, kompaktní plastové čelo (ABS), lze rozdělit příčkami, nosnost 20kg
zásuvka 1x v 12 cm	ANO	1 x zásuvka, hloubka 12cm
4x kvalitní otočné plastové kolo d min.=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost min.: 100 kg	ANO	nosnost 120 kg

#### T-6525 Vozík anesteziologický



rozměry bez příslušenství Š60cm x h 58 cm	ANO	60x58 cm
konstrukce: ocel s práškovou barvou RAL 9002	ANO	ocel, barva RAL9002

pracovní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABSbeze svárů a spojů	ANO	pracovní deska ABSbeze svárů a spojů
třístranná galerie	ANO	třístranná galerie
prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami; nosnost: min.20 kg, vnitřek bez šroubů a děr	ANO	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami, nosnost 20kg, vnitřek bez šroubů a děr
1 x zásuvka výšky cca 10cm s dělením na 9 částí, barva viz. příloha barevné řešení	ANO	1 x zásuvka 60x10 cm, dělení na 9 částí, barva dle barevného řešení
3 x zásuvka výšky cca 15cm, barva viz. příloha Barevné řešení	ANO	3 x zásuvka 60x15 cm, barva dle barevného řešení
1 x zásuvka výšky cca 20cm, barva viz. příloha Barevné řešení	ANO	1 x zásuvka 60x20 cm, barva dle barevného řešení
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
centrální zamykání	ANO	centrální zamykání
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
boční madlo	ANO	boční madlo
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost: min. 135 kg	ANO	nosnost 135 kg
magnetický držák kontejneru na použité jehly	ANO	držák kontejneru na použité jehly s magnetickým uchycením
2 x háček magnetický na boku s možností přesunu	ANO	2 x háček s magnetickým uchycením
boční výklopný stolek	ANO	nerezový sklopný stolek 50x59,5cm, nosnost 10kg
9 ks plastových výklopných boxů s aretací, konzole pro uchycení na záda vozíku, spojovací materiál	ANO	nástavba pro vozík s 9 ks plastových výklopných boxů s aretací
koš s magnetickým uchycením 30 1 s víkem, plastový	ANO	plastový odpadkový koš 301, s víkem, s magnetickým uchycením
sada magnetických štítků na popis s možností přesunu	ANO	sada magnetických štítků na popis

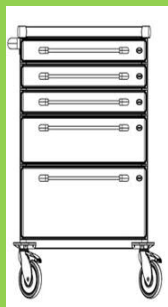
**T-6528 Vozík resuscitační**

rozměry bez příslušenství Š60 cm x h 58 cm	ANO	60 x 58 cm
--	-----	------------

konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO	dvouplášťová ocel, barva RAL 9002
prac. deska: nerez ocel AISI304 ; nosnost: min. 20 kg	ANO	nerezová pracovní deska, nosnost 30kg
prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami; nosnost: min.20 kg	ANO	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělení příčkami, nosnost 20 kg
1 x zásuvka výšky cca 10cm RAL9010	ANO	1 x zásuvka 60x10 cm, RAL9010
3 x zásuvka výšky cca 15cm RAL3001	ANO	3 x zásuvka 60x15 cm, RAL3001
1 x zásuvka výšky cca 20cm s dělením na 3 části RAL3001	ANO	1 x zásuvka 60x20 cm, s dělením na 3 části, RAL3001
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
centrální zamykání	ANO	centrální zamykání
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
bez postranního madla	ANO	bez bočního madla
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm;	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
2x brzda; plastové nárazníky		
celková nosnost min: 135 kg	ANO	nosnost 135 kg
sklopný/výsuvný stolek z nerez oceli AISI304 min. 30 cm; nosnost min: 8 kg	ANO	nerezový sklopný stolek 50x59,5cm, nosnost 10kg
příslušenství přestavitelné bez použití nářadí	ANO	přestavitelné příslušenství bez použití nářadí
držák kontejneru na použité jehly	ANO	držák kontejneru na použité jehly
2x výškově stavitelný nerez držák 200 ks rukavic	ANO	2 x nerezový držák na 200ks rukavic s magnetickým uchycením
galerka s 5 výklopnými boxy	ANO	nástavba s 5 výklopnými boxy



### T-6690 Věšák na RTG zástěry



Nerezový věšák k připevnění na zeď, min 5 ramínek.	ANO	nerezový věšák, přivnění na zeď, 5 ramínek
Každé ramínko je pevně ukotveno na samostatném nosníku, který je možno sklopit ke zdi.	ANO	každé ramínko pevně ukotveno na samostatném nosníku s možností sklopit ke zdi
Konce ramínek jsou vyhnuté nahoru, tím je zabráněno sjiždění zástěry z ramínka.	ANO	konce ramínek vyhnuté nahoru
Délka ramínka cca 60 cm, nosnost jednoho ramínka min. 6 kg.	ANO	ramínko 57cm, nosnost 6 kg

**Část 1 - Nemocnice Chomutov: JIP**

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů vozíků akceptován toleranční rozsah  $\pm 5\%$ .


Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN17240).


Zadavatel u předmětu plnění požaduje technické provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud účastník nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na technické provedení konstrukce bez děr, záhybů či jiných otvorů vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.

Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.

**Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.**

**Kód**      **Název**  
**položky**


K-0196	Skříň na podložní mísy a močové lahve	ANO/NE	Nabízený parametr
			
	Skříň - rozměry: 600 x 600 x 2100 úchyty na bažanty a podložní mísy	ANO ANO	600 x 570 x 2100 mm držáky na podložní mísy a močové láhve
	1-dvéřová konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO ANO	jednodvéřová dvouplášťová ocel s práškovou barvou RAL9002
	Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260°.	ANO	celoobvodové těsnění, úhel otevření 270°
	Povrch upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch dle vzorníku výrobce, (dveře lakovány i z vnitřní strany).	ANO	prášková epoxypolyesterová barva i z vnitřní strany dveří, dle vzorníku výrobce

**T-6504 Vozík nemocniční, asistenční, 4 zásuvky (pacienti)**

rozměry bez příslušenství Š60cm x h 58 cm	ANO	60x58 cm
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO	dvouplášťová ocel s práškovou barvou RAL 9002
prac. deska: nerez ocel AISI304 - s třístrannou galerií; nosnost: min. 20 kg	ANO	nerezová pracovní deska s třístrannou galerií, nosnost 30kg
prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg	ANO	prachotěsné zásuvky s možností rozdělit příčkami, nosnost 20kg
1 x zásuvka výška cca 15 cm s dělením na 9 částí, RAL9010	ANO	1 x zásuvka 60x15 cm, dělení na 9 částí, RAL9010
2 x zásuvka výšky cca 15cm, RAL7035	ANO	2 x zásuvka 60x15 cm, RAL 7035
1 x zásuvka výšky cca 30cm, RAL7035	ANO	1 x zásuvka 60x30 cm, RAL 7035
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotlumením a dotlumením
centrální zamykání	ANO	centrální zamykání
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
bez postranního madla	ANO	bez bočního madla
4x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost: min. 135 kg	ANO	nosnost 135 kg
sklopný/výsuvný stolek z nerez oceli AISI304 min. 30 cm; nosnost min: 8 kg	ANO	nerezový sklopný stolek 50x59,5cm, nosnost 10kg
příslušenství přestavitelné bez použití nářadí	ANO	přestavitelné příslušenství bez použití nářadí
držák kontejneru na použité jehly	ANO	držák kontejneru na použité jehly
9 ks plastových výklopných boxů s aretací, konzole pro uchycení na záda vozíku, spojovací materiál	ANO	nástavba pro vozík s 9 ks plastových výklopných boxů s aretací
1x výškově stavitelný nerez držák na 100 ks rukavic	ANO	1 x nerezový držák na 100ks rukavic s magnetický uchycením



2x výškově stavitelný nerez držák na 200 ks rukavic	ANO	2 x nerezový držák na 200ks rukavic s magnetický uchycením
odpadkový zavíratelný koš	ANO	nerezový odpadkový koš s víkem

**T-6529 Vozík na ošetřování ran**

rozměry bez příslušenství Š90 cm x h 58 cm	ANO	90x58 cm
konstrukce: dvouplášťová, ocel s práškovou barvou RAL9002	ANO	dvouplášťová ocel, barva RAL 9002
prac. deska: nerez ocel AISI304; nosnost: min. 20 kg	ANO	nerezová pracovní deska, nosnost 30kg
prachotěsné zásuvky, možnost rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg	ANO	prachotěsné zásuvky, možnost rozdělení příčkami, nosnost 20 kg
1 x zásuvka výšky cca 15cm s posuvným předělem, RAL 9010	ANO	1 x zásuvka 90x15 cm, s posuvným předělem, RAL 9010
1 x zásuvka výšky cca 15cm s posuvným předělem, RAL1015	ANO	1 x zásuvka 90x15 cm, s posuvným předělem, RAL 1015
3 x zásuvka výšky cca 15cm, RAL1015	ANO	3 x zásuvka 90x15 cm, RAL 1015
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotlumením	ANO	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotlumením a dotlumením
madla zásuvek kovová	ANO	kovová madla zásuvek
nerez postranní tlačné madlo	ANO	nerezové tlačné madlo
4 x otočné antistatické kolo dmin=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	ANO	4 x otočné antistatické kolečko pr. 12,5mm, 2 x s brzdou, plastové nárazníky
celková nosnost min: 135 kg	ANO	nosnost 135 kg

Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnici Chomutov, o.z. - část 1: Zásuvkové vozíky a speciální nerezové vybavení															
Číslo položky	Kód položky*	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ/kupní sml.	Rozložení dle oddělení					Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Nabídková cena celkem bez DPH	Nabídková cena celkem s DPH	Obchodní název nabízeného zboží	Nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele AN/NE
					Urgent	ARO	COS	LD	LD						
1-	T-2001	Skříň na materiál	3F	1											
2	K-0196	Skříň na podložní mísy a motové lahve	1	1											
3	T-4559	Vozík dvě zásuvky, spodní prostor otevřený	ks	1											
4	T-6504	Vozík nemocniční, asistentní, 4 zásuvky (pacienti)	ks	1											
5	T-5415	Držák na rukavice nerez	ks	15											
6	T-6506	Vozík přístrojový pojízdný, 1 zásuvka, nerez	ks	1											
7	T-6507	Vozík víceúčelový 2-podlažní, nerez se zásuvkou	ks	1											
8	T-6509	Vozík zdravotnický, multifunkční (hygiena pacienta)	ks	1											
9	T-6525	Vozík anesteziologický	ks	1											
10	T-6528	Vozík resuscitační	ks	1											
11	T-6529	Vozík na ošetřování ran	ks	1											
12	T-6590	Věšák na RTG záseky	ks	1											
Nabídková cena celkem											4 764 100,00	5 764 561,00			

\* položky se stejným kódem mají pro všechna oddělení jednotnou technickou specifikaci.