



se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provozu, montáž zařízení, instalaci a implementaci a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určených pracovníků kupujícího s obsluhou a údržbou předmětu koupě, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů předmětu koupě, úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít spolu s vlastnickými právy a podle podmínek této smlouvy zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě předá nejpozději do 3 měsíců do nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice.
3. Místo plnění k provedení instalace se kupující zavazuje prodávajícímu předat nejpozději v den zahájení instalace, který prodávající kupujícímu oznámí písemně alespoň tři pracovní dny předem.

III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět koupě, včetně provedení instalace a dalších povinností prodávajícího souvisejících s předáním předmětu koupě kupujícímu specifikovaných v čl. I, odst. 3 této smlouvy byla stranami dohodnuta ve výši 2.695.000,- , Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dní od jeho doručení kupujícímu.
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem budou vystaveny a odesílány v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz.
3. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí

4. částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za splněný.
5. Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, pod názvem „Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do páteční sítě poskytovatelů urgentní péče“ - reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379. Název a reg. č. budou uvedené na daňovém dokladu – faktuře.

V.

Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje při provádění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem.
2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
3. Závazek prodávajícího dodat a předat předmět koupě včetně instalačních a implementačních prací provedených v místě je splněn odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. II. této smlouvy, úplně a bez vad. Předmět koupě musí být plně funkční. Předmět koupě musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
4. O předání předmětu koupě bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
5. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděnými.
6. Kupující dále není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění:
 - návody k obsluze (v papírové a elektronické podobě), užívání a zacházení s předmětem koupě,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o instruktáži (zaškolení) obsluhy.

VI.

Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. II. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo na úrok z prodlení ve výši dle příslušného nařízení vlády.

VII.**Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího předáním, které je potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Oprávněnou osobou k převzetí předmětu koupě a k jednání ve věcech technických za kupujícího je určen [redacted], příp. jiný pracovník oddělení zdravotnické techniky. Pro elektronickou komunikaci je určen e-mail: ozt@nspiv.cz
3. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [redacted]

VIII.**Další ujednání**

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne doručení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své splatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

IX.**Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Po dobu záruky za jakost je prodávajícím poskytováno bezplatné provádění bezpečnostně-technických kontrol (BTK).
3. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu, uvedenou v čl. VII. odst. 3.
5. Proávající je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady.
6. Proávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá, např. při poškození přístroje z důvodu neodborné manipulace ze strany zaměstnance kupujícího. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu prodávající.

7. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě, že Prodávající v průběhu provádění servisu nebo bezpečnostně technické kontroly vyhodnotí, že závada nebo technický stav zařízení může vést (nebo vedl) k nežádoucí události, je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním a předáním předmětu koupě nebo kupujícího s jeho úhradou delší 30 kalendářních dnů;
 - předmět koupě nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
 - výskyt více než dvou různých vad předmětu koupě nebo nedodržení odpovídající jakosti předmětu koupě;
2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XI.

Registr smluv

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že údaje v této smlouvě obsažené nepovažují za obchodní tajemství a uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

XII.

Závěrečná ujednání.

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Přílohu č. 1 vypracoval prodávající.
2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení



takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V Ivančicích dne

V Praze dne 24.11.2023

Za kupujícího:

Ing.
Jaromír
Hrubeš

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Hrubeš
Datum: 2023.11.24
10:21:16 +01'00'

.....
Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel

Za prodávajícího:

Ing.
Tomáš
Köhler

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Köhler
Datum:
2023.11.24
10:16:39 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Köhler
jednatel

příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě

Elektrické lůžko pro nemocniční péči, 55 ks		I.
Obchodní název a typ nabízeného plnění: U0099 – 4 motorové nemocniční lůžko		
zadání	splňuje	účastník nabízí
1. vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 100 cm	ANO	222x100 cm
2. ložná plocha minimálně 200 x 87 cm	ANO	200x90
3. elektrický zdvih v rozmezí maximálně od 38 – minimálně 82 cm	ANO	38-83 cm
4. minimální rozsah nastavení výšky zdvihu minimálně 44 cm (nejnižší výška lůžka pro matraci při variantě 150 mm koleček maximálně 38 cm)	ANO	45 cm
5. čela plastová vyjímatelná s pojistkami proti nechtěnému vyjmutí, omyvatelná, dezinfikovatelná s ochrannými prvky proti kolizi a poškození lůžek (nárazový kužel (kolečko) z obou spodních hran čela), možnost výběru barvy výplně plastů, nebo jejich částí	ANO	ANO
6. mechanické nouzové odblokování zádové části (CPR), zádová část a stehenní ovládaná pomocí elektromotoru, lýtková část dopolohování mechanicky	ANO	ANO
7. ¾ sklopné plastové dvojdílné s možností doplnění lehce odnímatelného kovového protektoru při potřebě personálu zabránit svévolnému opuštění lůžka pacientem, nebo postranice na celou délku lůžka	ANO	Postranice na celou délku lůžka s integrovaným ovládáním
8. kolečka o průměru 150 mm s centrální brzdou s nášlapným pedálem v nožní části z obou stran lůžka	ANO	ANO
9. váha lůžka maximálně do 130 kg	ANO	125 kg
10. elektrické nastavení polohy trendelenburg/antitrendelenburg minimálně 10°	ANO	14°
11. autoregrese zádové části od pánevní části (střížné síly) minimálně 4 cm	ANO	Dvojitá 11+6 cm
12. patientský a sesterský intuitivní ovladač s přednastavenými funkcemi, integrovaný v hlavové části postranice pro velmi snadnou manipulaci funkcí jak pacientem, tak obsluhujícím personálem s možností zablokování či odblokování jednotlivých funkcí lůžka personálem pomocí kombinací tlačítek na sesterském vnějším panelu (u varianty s ¾ postranic nebo s postranicí na celou délku lůžka musí být samostatný sesterský panel s držákem na čelo postranice či bočnici)	ANO	ANO



13.	samostatný patientský ovladač s přednastavenými funkcemi totožný s ovládacím panelem s ochrannými bezpečnostními prvky	ANO	ANO
14.	lišta na drobné příslušenství - držák močových lahví atd.	ANO	ANO na obou stranách lůžka s pohyblivými háčky
15.	otvor pro možné doplnění infuzního stojanu	ANO	ANO v každém rohu lůžka
16.	lůžko musí mít hrazdu (se zatížením min. 90kg) a hrazdičku, držák infúzí na hrazdu a infúzní stojan teleskopický s kovovými háčky	ANO	Hrazda s nosností 100kg s držákem infúzí na hrazdu a teleskopický infuzní stojan
17.	lůžko musí mít pod nožní části čela integrované lišty pro doplňky – lůžkoviny atd.	ANO	Polička na lůžkoviny
18.	lůžko musí mít snadnou možnost integrovaného prodloužení lůžka minimálně o 15 cm	ANO	+30 cm
19.	bezpečnostní pracovní zatížení bez pomoci záložní baterie musí být minimálně 200 kg a maximální hmotnost pacienta musí být minimálně 180 kg	ANO	230 kg
20.	lůžko se záložní baterií	ANO	ANO
21.	lůžko s nožním pedálem pro možnost výškového nastavení	ANO	ANO
22.	barva kovových částí konstrukce – bílá RAL, plastové segmenty lůžka dle výběru zadavatele	ANO	ANO – rám RAL 9002, plastové segmenty z 200 dekorů
23.	prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745	ANO	ANO
24.	certifikát o vytrvalostním testování parametrů lůžka – min. 3.000 cyklů	ANO	ANO

Příslušenství		II.	
Matrace 200 x 90 x 14 cm, 55 ks			
25.	matrace je určena pro vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů, třída (IV.), Norton 20 -14	ANO	ANO – IV. stupeň
26.	matrace je zónovaná - 5-zónové jádro matrace	ANO	5 zón
27.	materiálové složení - vylévaná (viskoelastická) pěna, studená HR pěna	ANO	Kombinace VISCO pěny a PUR pěny o různých tuhostech
28.	matrace je perforovaná v nejvíce exponovaných místech	ANO	Příčně perforovaná v celé délce
29.	výška jádra matrace: min. 14 cm	ANO	14 cm
30.	zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka	ANO	ANO
31.	nosnost matrace: do 200 kg	ANO	200 kg
32.	potah SAFR (nebo jiné, rovnocenné řešení) – prací na 95°C, antialergický,	ANO	ANO

pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip do tvaru L (180°), zip krytý okapnicí proti zatékání nečistot do jádra matrace, lepené hrany potahu – 100% ochrana proti zatečení nečistot do jádra matrace. (55 ks + 10 ks rezerva)		
--	--	--

Noční stolek, 55 ks			
33.	kovový oboustranný noční stolek s výplněmi z HPL (nebo jiné, rovnocenné řešení) s plynule nastavitelnou jídelní deskou s aretačními možnostmi	ANO	Kovový nemocniční stolek s HPL výplněmi a plynule nastavitelnou jídelní deskou s polohováním a aretací
34.	perfektní dezinfikovatelnost, omyvatelnost a hygiena stolku standardními dezinfekčními prostředky	ANO	ANO
35.	rozměry stolku minimálně 85 x 55 x 45 cm	ANO	85x55x45 cm
36.	jídelní deska i vrch stolku s bezpečnostními prvky proti pádu předmětů ze stolku	ANO	Zvýšený okraj
37.	rozměr jídelního stolku minimálně 55 x 40 cm (+/- 10cm)	ANO	60x33 cm
38.	možnost náklonu jídelní desky 30°-60°	ANO	Oboustranný náklon 60-60 v 5ti krocích
39.	plynulá nastavitelnost jídelní desky musí být v rozmezí 75 – 110 cm (+/- 10%)	ANO	75-110 cm
40.	4 x kolečka z toho 2 ks s brzdou o průměru minimálně 75 mm	ANO	4x75mm, 2 brzditelná
41.	držák ručníku a zámek horní zásuvky	ANO	ANO
42.	držák PET lahví uvnitř dvířek	ANO	ANO
43.	prostorná zásuvka na osobní věci a spodní část stolku	ANO	ANO
44.	váha stolku maximálně 42 kg	ANO	25 kg
45.	barva nástřiku RAL i dekoru HPL (nebo jiné, rovnocenné řešení) dle výběru a přiloženého vzorníku	ANO	30 dekorů

Další příslušenství			
46.	držák močových láhví, 45 ks	ANO	ANO
47.	držák francouzských holí, 35 ks	ANO	ANO
48.	koš na Redonovy lahve (nerez), 15 ks	ANO	ANO
49.	v případě nabídky ¾ plastové postranice s tlumeným doběhem sklápění - 26 párů kovového retractoru pro připevnění z obou stran lůžka	ANO	Plné postranice

Produktový list: U0099




U0099 – 4-motorové lůžko s dělenými plastovými postranicemi

- Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů, s dvojitou autoregresí pro snadné čištění, RTG plně kompatibilní
- Plastové postranice po celé délce lůžka, pro maximální bezpečí, sklopné, s chráněným ovládním, dělené s tlumením
- Centrálně brzděná kolečka pro snadnou manipulaci se směrovým vedením, ovládané z nožní části dvouramennou pákou
- Postranice i čela vyrobená bezspárovou technologií, přívodní kabel kroucený a svod elektrického potenciálu

Parametr	Hodnota
Rozebrané ložné plochy	90 x 200 cm
Uniční rozměry	99 x 222 cm
Výška min.	38 cm elektricky
Výška max.	83 cm elektricky
Nosnost / celá lůžka	230 / 125 kg
TR + ATR	0-14° elektricky
Kolečka	4*150 mm centrálně brzděná se směrovou aretací, dvojrámenné páky oboustranné, jedno antistatické zádové (0-75°) + stehenní (0-25°) díl elektricky, lýtkový (0-15°) ve 4 krocích manuálně
Polohování	
Ložná plocha	4-dílná, z odnímatelného plastu
Rozebraná	plastové dělené po celé délce lůžka, s ovládním pro pacienta i sestru
Čela	odnímatelná, plastová s madlem a aretací a nárazovými kolečky
Prodloužení lůžka	ANO + 30 cm
Autoregrese	dvojitá - 11+6 cm (zádový + stehenní díl)
Výbavní standard	CPR funkce, univerzální držáky příslušenství po obou stranách, hrazda s hrazdičkou (nosnost 100kg) a úchytem pro infuze, infuzní stojan výškově stavitelný, baterie, polička na lůžkoviny, koš na bažanta a držák berlí a močových lahví, nožní ovladač výšky
Sestřičkový ovladač	přednastavené polohy TR+ATR, Fowler, CPR, vyšetřovací poloha, kardiacké křeslo a další, blokovatelné funkce
Detail	volitelný z 200 vzorů
Pacientský ovladač	pacientský ovladač se zámkem



Lůžko U099 ve vzorovém pokoji

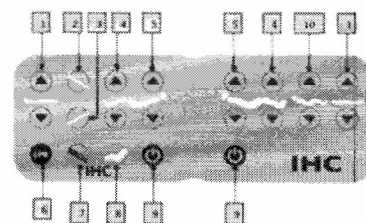


Ovládní v postranici


- vlevo vnější strana – sestra
- Vpravo vnitřní strana - pacient



Možné dekory lůžka

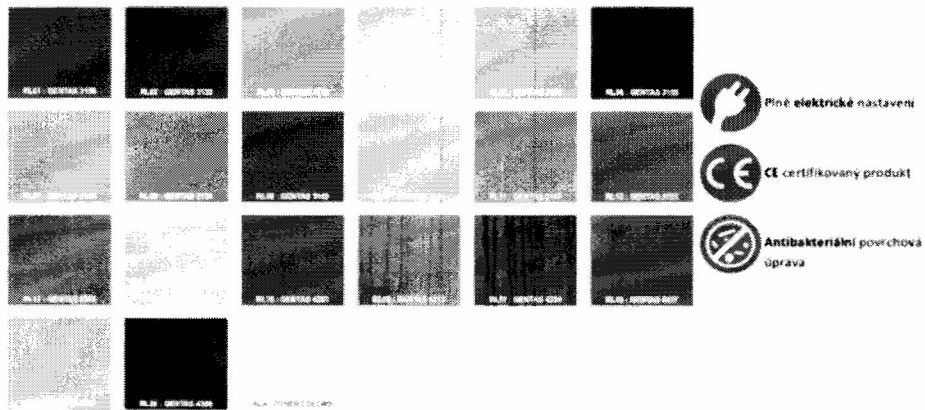

Standardní výbava lůžka

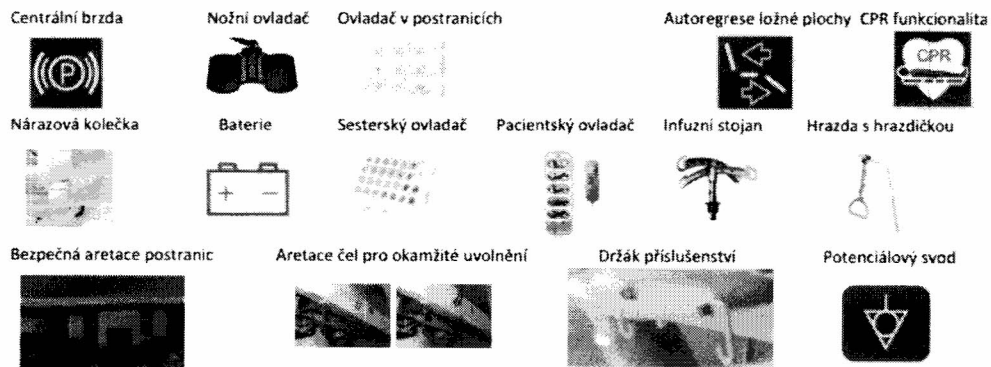

Všechny fotografie v produktovém listu mají pouze informativní charakter. Přesná specifikace, jakož i barevné provedení lůžka, provedení brzdového systému, ložné plochy, motorizace, rozměrů a ovladačů jsou předmětem úpravy dle přání každého klienta. Lůžko v tomto produktovém listu je plně přizpůsobeno potřebám a požadavkům zadavatele. Výrobce deklaruje, že výše uvedené specifikace lůžka je schopen splnit, garantovat a vyrobit plně v souladu se všemi platnými a požadovanými normami zejména EN 60601-2-52:2010 a EU/2017/745 bez výhrad.

INDUBIA s.r.o.
Mládež Horká č. 42/127, Praha 6
IČ: 28111290, DIČ: C228111290
info@indubia.cz, www.indubia.cz




U0019

Pasivní antidekubitní matrace s vylévanou VISCO pěnou

Technické parametry


rozměry 90 x 200 x 14 cm
lité VISCO pěna s perforací v celé délce matrace
výška 14 cm
hustota HR pěny 50 kg/m ³ , hustota VISCO pěny 75 kg/m ³ , zesílené boky matrace z PUR pěny o hustotě 55 kg/m ³
5 anatomických zón
stupnice Norton riziko vzniku dekubitu IV. stupeň
nosnost matrace 200 kg
voděodolnost potahu 200 cm/Hg
paropropustnost potahu 800 g/m ² /24 h
nehořlavost potahu CRIB 5
jádro se sníženou hořlavostí CRIB 5
zips potahu krytý krycí chlopní pro odolnost proti zatečení ze tří stran
potah antimikrobiální, nehořlavý, omyvatelný, pružný, dezinfikovatelný činidly v koncentracích pro zdravotnictví, odolný vůči účinkům krve, moče
Pratelný na 95 stupňů, sušitelný na 125 stupňů
Potah matrace FLORA T70 - certifikovaný

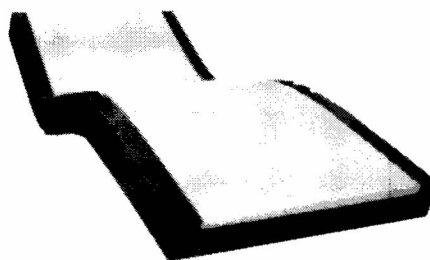

U0026 – oboustranný nemocniční patientský stolek k lůžku s jídelní deskou

- Nemocniční stolek s výklopnou jídelní deskou z ABS plastu pro snadné čištění se zvýšenými okraji - oboustranný
- Kovové provedení s barevnými HPL dvířky skříňky a zásuvky pro maximální životnost
- Plně kompatibilní se všemi lůžky standardní a intenzivní péče s garantovanou životností min. 20 let

MĚSÚŇ	Novosůo
Typ	Nemocniční stolek s jídelní deskou
Kolůvka	ø 75 mm, dvě bržděná, dvojitá
Rozměry v šířce	45x55x85 cm, váha 25kg
Provedení	Oboustranné provedení s jídelní deskou, vrch z ABS plastu
Jídelní deska	Výškově stavitelná pomocí plynové pružiny 75-110 cm, nosnost 10kg Nastavitelná v 5ti polohách
Polohování jídelní desky	ABS plast se zvýšeným okrajem, rozměr 60*33 cm a integrovaným mechanismem proti převržení a aretaci
Provedení jídelní desky	
Možnosti ovládnutí	Zásuvka (s plastovou vyjímátnou vložkou), stolek (s prostorem a držákem na PET lahev)
Ochrana	Nárazové hrany na obvodu stolku
Skříňka	Zásuvky a skříňky bezpečností + držák ručníku a příslušenství
Mechanismus zámek	Přino-výsuv s pojistkou, zásuvka uzamykátná
Dezinfekce	Snadná omyvatelnost a dezinfikovatelnost jídelní desky a stolku běžnými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví

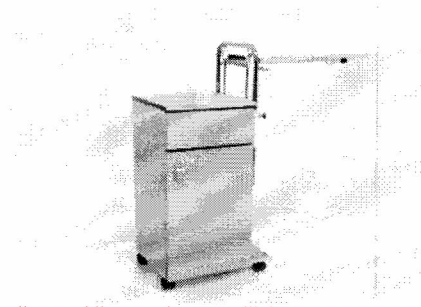

Dodáno bude provedení s plastovou jídelní deskou a plastovým topem stolku a zámek zásuvky.