

Nemocnice Břeclav  
příspěvková organizace  
U nemocnice 3066/1  
690 02 Břeclav  
tel: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]

IČO: 00390780  
DIČ: CZ 00390780  
Bank.spoj.: [REDACTED]

**OBJEDNÁVKA č.: 355/2024-6**

Značka: 355/2024-6  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

**Medicton Group, s.r.o.**  
Jiráskova 609  
Polička  
572 01  
[REDACTED]

Datum: 23.01.2024


Objednáváme u Vás:

Na základě cenové nabídky č. CN24011501


Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. dodávka	Název zařízení: Typ zařízení:	Ozařovací systém OCTAderm	1 Ks
	Nákl.středisko: Umístění:	01290201 Kožní ambulance	

Předpokládaná cena: 210 000,-



**Cenová nabídka CN24011501**  
**Ozařovací systém systém OCTAderm**  
**Výrobce MEDlight GmbH**

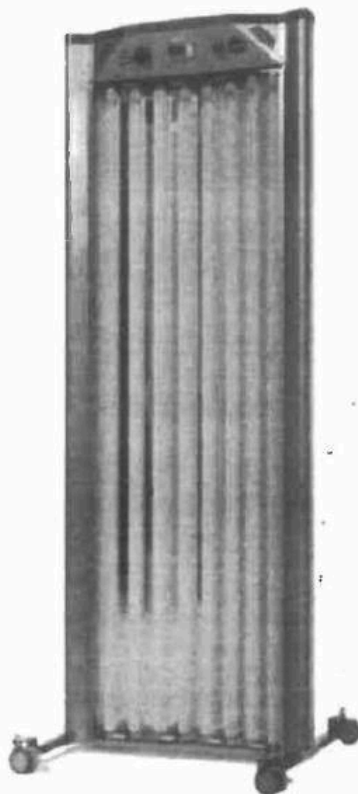

**Obecné informace**

<b>Typ</b>	<b>Octaderm</b>
<b>Výrobce</b>	<b>Výrobce MEDlight GmbH</b>
<b>Dodací doba</b>	<b>4-6 týdnů</b>
<b>Záruční doba (měsíce)</b>	<b>24 na přístr. , o : UV trubice</b>
<b>Třída ZP</b>	<b>Ila</b>

## Technická specifikace:

### Ozařovací systém OCTAderm = paravánový fototerapeutický systém pro celotělové ozařování

**MEDlight OCTAderm** je UV-fototerapeutické zařízení pro léčbu lidské pokožky, zejména psoriatických kožních projevů a jiných dermatóz. Absorbovaná energie ultrafialového záření má přímý léčebný efekt na psoriatické kožní projevy a další dermatózy, a to bez nutného použití dalších senzibilizátorů. Díky OCTAderm lze provést celotělovou terapii.

#### Vlastnosti:

- Fototerapeutický panel osazený zářiči UVB 311 nm úzké pásmo
- 8 trubic o délky 175 cm, chráněných bezpečnostním akrylovým sklem s magnetickým úchytem pro snadné čištění
- Mobilní přístroj na kolečkách pro snadnou manipulaci
- Distanční zářička pro vymezení optimální vzdálenosti pacienta od zářičů (bezpečnost pacienta / optimalizace dávky)
- Real time dozimetrie pro výpočet reálné dávky, která je pacientovi během terapie aplikována
- Optimalizace dávky prostřednictvím odrazového panelu společného pro všechny zářiče
- Program pro celotělovou terapii možnost nastavení 1-4 strany těla, přístroj naviguje pacienta ke změně polohy bez přerušení terapie
- Nízko umístěný začátek ozařovací plochy (7 cm) pro terapeutický účinek léčby v oblasti holení a nártů.
- Zabezpečení ochrany proti neoprávněné manipulaci klíčkem
- Přístroj je vybaven schránkami na uskladnění ochranných brýlí a dalšího příslušenství

#### Technické informace:

- počet trubic: 8
  - výkon UV trubice: 100 W
  - rozměry zářič: 195 (v) x 69(š) x 69 (h) cm
  - napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
  - příkon: 1550 W
- **Příslušenství:** ochranné brýle pro personál a ochranné brýle pro pacienta.
  - Výrobek je **certifikovaný** v souladu s MDD.
  - **Servisní kontakt:** záruční i pozáruční servis v ČR zajišťuje společnost Medicton Group s.r.o., dodavatel provede odbornou instalaci a zaškolení personálu.

## Cenová nabídka:

Sc

### 2. Cena:

- OCTAderm – UVB (311nm) (kód 1005)

Cena bez DPH:

172 000,- Kč

DPH 21 %:

36 120,- Kč

Celková cena s DPH:


209 120,- Kč

### 3. Platební podmínky:

- dohodou

Platnost nabídky do 30.6.2024.

V Praze 15.1.2024



----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: objednávka 355/2024-6

**Datum:** Mon, 29 Jan 2024 14:09:43 +0000




Dobrý den,  
děkuji za Vaši objednávku a tímto potvrzuji její přijetí.

**S pozdravem**



*specialista pro obchod a backoffice*

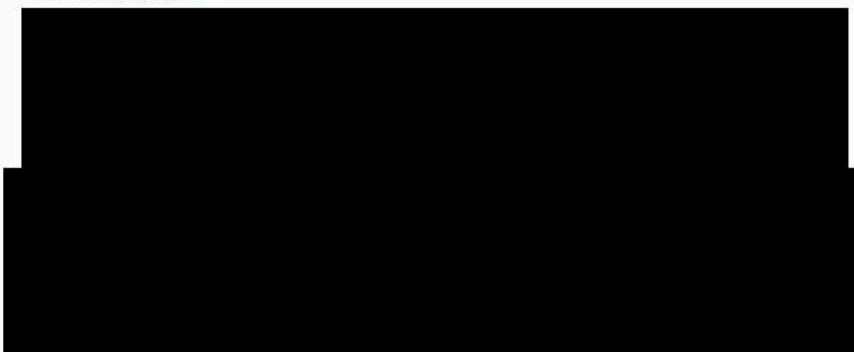

**Metrologie** **Servis** **Prodej**



**From:** [Redacted]

**Sent:** Thursday, January 25, 2024 10:06 AM

**To:** [Redacted]

**Subject:** objednávka 355/2024-6


Dobrý den,


30.1.2024

v příloze Vám posílám objednávku na ozařovací systém.

**Prosím o potvrzení přijetí.**

S pozdravem

  
Oddělení zdravotnické techniky  
Nemocnice Břeclav, p.o.  
U Nemocnice 3066/1  
690 02 Břeclav



30.1.2024