

DODATEK č. 1 SMLOUVY

„Provádění oprav, servisu a kalibrace přístrojů Dräger Alcotest a Drugtest pro Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025“

k uzavřené inominátní smlouvě v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 751 51 472

DIČ: CZ75151472

zastoupený: náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m

adresa: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
P. O. BOX 1151, 110 00 Praha 1

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

fax:

e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

Poskytovatel:

Dräger Safety s.r.o.

se sídlem: Obchodní 124, 251 01 Čestlice

zapsán: v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C vložka 88292

IČO: 26700778

DIČ: CZ26700778

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.

e-mail:

(dále jen jako „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají

tento dodatek smlouvy č. 1 o změně článku IV, Cena díla, na základě cenové nabídky dle platného aktuálního ceníku poskytovatele. Aktuální ceník poskytovatele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. IV Cena díla

- 4.1. Cena za službu je v souladu s cenovou nabídkou poskytovatele, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4.2. Ceny použitých náhradních dílů budou účtovány dle platného aktuálního ceníku zaslaného na základě písemné žádosti objednatele poskytovatelem.
- 4.3. Finanční částka limitovaná pro dané období činí 2 420 000,00 Kč včetně DPH a je nepřekročitelná.
- 4.4. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.5. Cena se odvíjí od počtu kusů přístrojů předaných najednou k provedení kalibrace a zajištění metrologického ověření.
- 4.6. Rozsah požadovaných prací bude přesně specifikován v dílčích objednávkách vyhotovených ke každému jednotlivému plnění. Tyto objednávky budou obsahovat výrobní čísla předávaných Alcotestů a specifikací ke každému alcotestu zvlášť. Potvrzené objednávky budou sloužit jako doklady o předání přístrojů poskytovateli. Obsah objednávek musí být shodný s fakturací. Případné změny rozsahu prací zjištěné poskytovatelem, které je nutné provést z hlediska řádné funkčnosti zařízení, musí být nahlášeny objednateli, který je musí odsouhlasit (např. telefonicky, e-mailem).
- 4.7. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze na základě zvýšení oprávněných nákladů poskytovatele způsobených změnou příslušných právních norem, kterými je poskytovatel povinen se řídit v souvislosti se svou činností. Tuto změnu poskytovatel oznámí objednateli, a to formou písemného návrhu dodatku k této smlouvě a objednatel je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit, a to ve lhůtě 30 dní od jeho doručení.
- 4.8. Poskytovatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení


Ostatní články smlouvy č. j. KRPA-28956-10/ČJ-2023-0000VZ-HV zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti elektronickým podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek smlouvy č. 1 přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Praze dne
Za objednatele:




V Čestlicích
Poskytovatele:

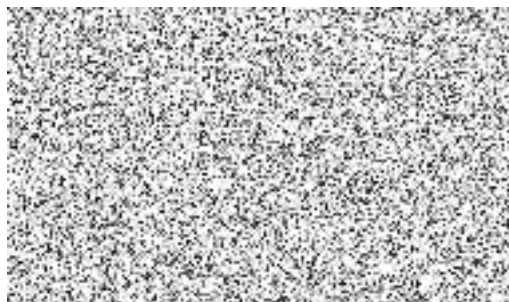


Cenová nabídka jednotlivých úkonů platná od 1.3.2024

Název firmy: Dräger Safety s.r.o.
Adresa: Obchodní 124, 25101 Čestlice

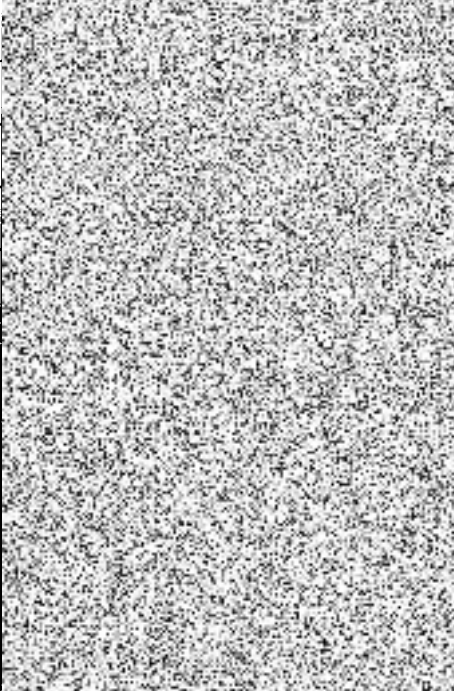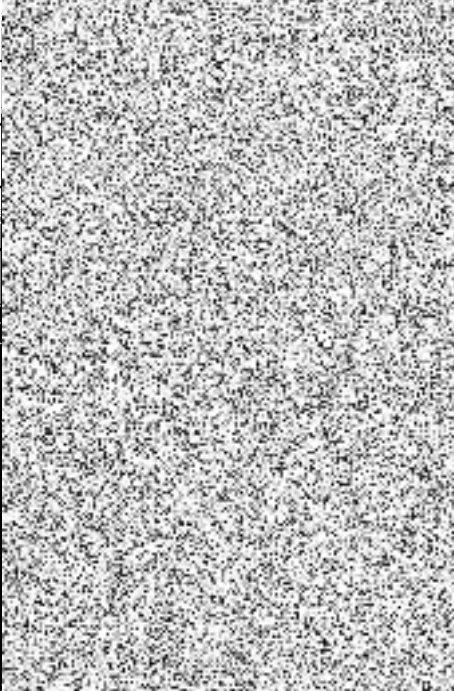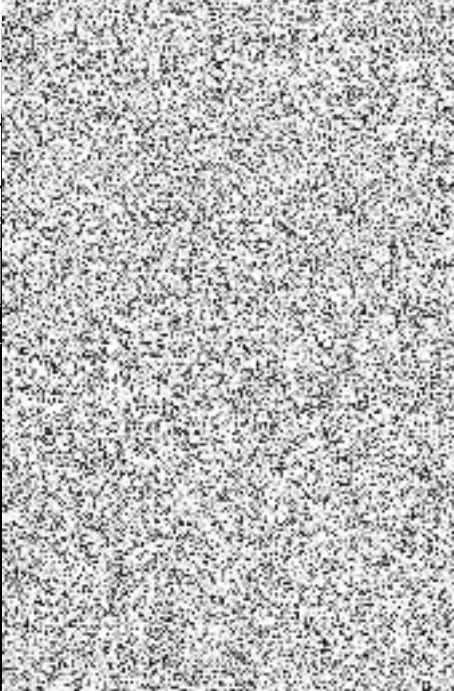

Položka	ÚKON	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
1	Kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest - 1 ks		
2	Kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest - 2 až 4 ks		
3	Kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest - 5 až 9 ks		
4	Kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest - 10 a více ks		
5	Ověření ČMI Alcotest - 1 až 3 ks		
6	Ověření ČMI Alcotest - 4 a více ks		
7	Oprava Alcotestu nebo příslušenství - 1 hodina práce		
8	Inspekce/kalibrace Drug Test 5000		
9	Aktualizace firmware Alcotest do ČJ		
10	Aktualizace firmware Alcotest pro ČMI		
11	Inspekce a diagnostika přístroje Alcotest		
Celková nabídková cena v Kč bez DPH			
DPH 21%			
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH			

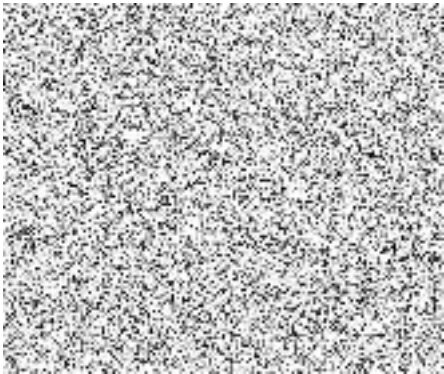

PLNÁ MOC

Dräger Safety s.r.o.
se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 267 00 778,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu C, vložce 88292,
zastoupená jednatelem společnosti 

(dále jen „Společnost“)

tímto uděluje plnou moc



(dále jen „Zmocněnec“)


k tomu, aby za Společnost činil jakákoliv právní jednání a vykonával jakékoliv činnosti související s podnikáním Společnosti, s výjimkou zcizování nemovitostí.

Zmocněnec je oprávněn zejména, nikoli však výlučně, jednat za Společnost při uzavírání, změnách či ukončování smluv podle občanského zákoníku, při vystavování a podepisování faktur, při zastupování v právních jednáních spojených s účastí na výběrových řízeních (včetně veřejných zakázek), při přebírání dokumentů adresovaných Společnosti a při dalších právních jednáních a činnostech souvisejících s podnikáním Společnosti.

Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou a zaniká dnem odvolání Společností.

v Čestlicích dne 8. 12. 2020

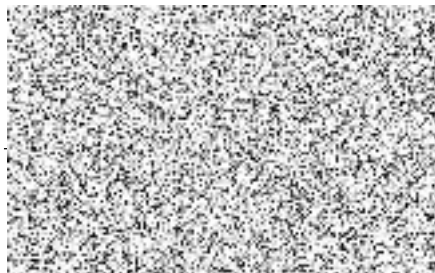

Tuto plnou moc přijímám v celém rozsahu.

v Čestlicích dne 8. 12. 2020




Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Čestlice
Vlastnoručně podepsal:

Poř.č.: 25247-0304-0048

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz

Čestlice dne 08.12.2020
Ježková Dana

Podpis, úřední razítko




Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Čestlice
Vlastnoručně podepsal:

Poř.č.: 25247-0304-0055

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz

Čestlice dne 08.12.2020
Ježková Dana

Podpis, úřední razítko



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **130384_002624**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Čestlice**

Česká pošta, s.p. dne **19.01.2021**



135141945-220297-210119083954