



Odběratel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav Tel: [REDACTED] IČ 00390780; DIC CZ00390780 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odd.: Oddělení laboratorní mikrobiologie Středisko: 0330.0401 Vyřizuje: [REDACTED]	Poř. č. objednávky: 7-2024-21-30
ŽÁDANKA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY OBJEDNÁVKA		
Dodavatel: DiaSorin s.r.o., K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5 [REDACTED]		
Na fakturu uveďte konečného příjemce: Oddělení laboratorní mikrobiologie, [REDACTED]		

	<i>Množství (balení, kusy)</i>
MOL2750 Simplexa Bordetella Direct Kit	[REDACTED]
MOL1455 DAD direkt amplification disk Kit (3 ks v krabici)	

Předpokládaná cena bez DPH:

75 000,- Kč

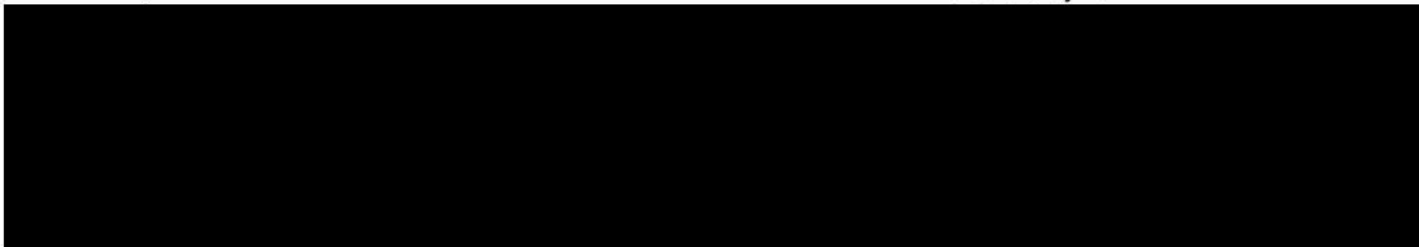



Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Odesláno: 22.3.2024 10:22
Předmět: [EXTERNÍ ZPRÁVA] FW: SO 2000034607 Fwd: Message from KM_C300i

Dobrý den,

Vaši objednávku č. 7-2024-21-30 ze dne 20.03.2024 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 61.788,00 Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: 22.03.2024. Předpokládaný termín dodání je příští týden.

S pozdravem,


[REDACTED]
Customer Service Representative



GOGREEN – Climate Protection with DHL



BEFORE PRINTING THIS E-MAIL
please consider the environment

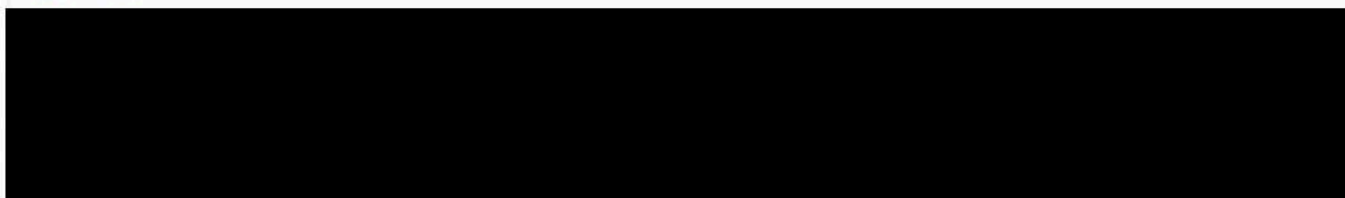

From: [REDACTED]
Sent: Friday, March 22, 2024 8:55 AM
To: [REDACTED]
Subject: SO 2000034607 Fwd: Message from KM_C300i

Dobrý den,
posílám objednávku a prosím o její potvrzení

Děkuji

S pozdravem

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]