

---

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

**Název:** Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
**Sídlo:** MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
**Zastoupena:** MUDr. Miroslavem Kavkou, FICS, MBA,  
ředitelem  
**IČ:** 00092584  
**DIČ:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Osoba oprávněná k jednáním  
ve věcech technických:** [REDACTED]  
**Osoba oprávněná k jednáním  
ve věcech radiční ochrany:** [REDACTED]  
**Telefonické a e-mailové spojení:** [REDACTED]  
**Adresa pro doručování  
korespondence:** MUDr. Jana Janského 11  
669 02 Znojmo  
**Dohlížející osoby k pracovištím:** viz příloha č. 3 této Smlouvy  
(dále jen „objednatel“)

a

**Název** **NUVIA Dosimetry, s.r.o.**  
**Sídlo:** Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8  
**Zastoupena:** Zdeňkem Zelenkou, jednatelem  
**IČ:** 45240043  
**DIČ:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Osoba oprávněná k jednáním  
ve věcech technických:** [REDACTED]  
**Telefonické a e-mailové spojení:** [REDACTED]  
**Adresa pro doručování  
korespondence:** K Mlýnu 892/34  
181 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.

(1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatel provede dílo, spočívající v provádění služeb osobní dozimetrie pro pracovníky objednavatele v riziku ionizujícího záření na jeho pracovištích v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění, (dále jen „atomový zákon“) a jeho prováděcích předpisů spočívajících v:

- a) distribuci osobních celotělových filmových, případně osobních celotělových termoluminiscenčních a prstových termoluminiscenčních dozimetrů,

- b) stanovení efektivní dávky E ze zevního ozáření výpočtem na základě měření příslušných veličin osobním celotělovým, dozimetrem,
- c) stanovení osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) ze zevního ozáření měřeného v polích záření fotonů a elektronů osobním celotělovým dozimetrem,
- d) stanovení osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 0,07 mm Hp(0,07) ze zevního ozáření měřeného v polích záření fotonů a elektronů osobním celotělovým dozimetrem,
- e) stanovení osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 0,07 mm Hp(0,07) ze zevního ozáření měřeného v polích záření fotonů prstovým termoluminiscenčním dozimetrem,
- f) stanovení roční ekvivalentní dávky na kůži ze zevního ozáření,
- g) stanovení roční ekvivalentní dávky na ruce ze zevního ozáření,
- h) poradenství v oboru osobní dozimetrie,
- i) přístupu k online aplikaci pro správu evidence monitorovaných radiačních pracovníků a jejich naměřených dávek,
- j) přenosu osobních údajů radiačních pracovníků Objednatele a vyhodnocených dávek z jejich dozimetrů i ročního součtu těchto dávek do Centrálního registru profesních ozáření (dále jen „CRPO“) podle požadavků § 33 odst. 6 a odst. 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 422/2016“),

(2) Služba osobní dozimetrie je podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 1 atomového zákona činností v rámci expozičních situací, ke které je nutné povolení SÚJB k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany. Rozhodnutí SÚJB o povolení služby osobní dozimetrie je uvedeno v příloze č. 5 této Smlouvy. Poskytovatel je pro službu osobní dozimetrie akreditovaným subjektem podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, viz příloha č. 4 této Smlouvy.

(3) Součástí plnění zhotovitele dle odst. 1 je vybavení pracovišť objednatel všemi prostředky v takovém rozsahu, aby mohl objednatel zabezpečit pravidelné monitorování na svých pracovištích ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pracoviště objednatel jsou uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy.

(4) Splněním závazku zhotovitele dle odst. 1 se rozumí zejména:

- a) poskytnutí základních instrukcí pro uživatele služby osobní dozimetrie zhotovitelem; tyto základní instrukce tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- b) pravidelném měsíčním dodávání dozimetrů na pro jednotlivá pracoviště objednatel dle přílohy č. 4 k této smlouvě,
- c) provádění změn v evidenci dozimetrů a dodání nově vyžádaných dozimetrů na základě objednatel dodané informace,
- d) plnění povinností podle požadavků § 33 odst. 6 vyhlášky č. 422/2016 Sb. oznamování těchto údajů do CRPO podle požadavků § 33 odst. 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb. jménem objednavatele po celou dobu platnosti této smlouvy,
- e) plněním povinností podle požadavků § 33 odst. 8 písm. a) vyhlášky č. 422/2016 Sb. jménem objednavatele,
- f) pravidelném vyhodnocování veškerých objednatel zpět zaslaných dozimetrů a pravidelném vyhotovování a předávání „Zkušebních protokolů“ z vyhodnocení dozimetrů vrácených objednatel,
- g) vyhodnocení dozimetru případě podezření neplánovaného jednorázového ozáření radiačního pracovníka, které by mohlo vést k překročení limitů pro radiačního pracovníka;

v tomto případě je objednatel povinen zhotovitele neprodleně informovat a předat zhotoviteli dozimetr neprodleně k vyhodnocení.

h) dodání náhradních odpovídajících náhradních dílů v případě vzniku vady osobního dozimetru, jedná-li se o vadu odstranitelnou výměnou náhradního dílu objednatelem.

## 2.

(1) Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek podle:

čl. 1 odst. 4 písm. b) v pravidelných měsíčních intervalech, nejpozději vždy 15. den příslušného kalendářního měsíce,

čl. 1 odst. 4 písm. c) neprodleně, nejpozději spolu se zasláním dozimetrů dle čl. 1. odst. 4 písm. b), tedy nejpozději vždy 20. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl požadavek objednatele vůči zhotoviteli uplatněn, není-li mezi zhotovitelem a pověřenou osobou objednatele dle přílohy č.3 této smlouvy v tomto dílčím případě sjednáno jinak,

čl. 1 odst. 4 písm. d) a e) ve lhůtách a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy,

čl. 1 odst. 4 písm. f) nejpozději 15. den v měsíc i následujícím po měsíci, v němž zhotovitel obdržel od objednatele příslušné dozimetry k jejich vyhodnocení,

čl. 1 odst. 4 písm. g) do 24 hodin od obdržení dozimetru.

čl. 1 odst. 4 písm. h) nejpozději do 10 dnů od oznámení vady objednatelem.

(2) Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla se rozumí pracoviště objednatele dle přílohy č. 3 k této smlouvě. Lhůty pro plnění závazku jsou závazné, nebylo-li stranami v dílčím případě ujednáno jinak.

## 3.

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy s náležitou odbornou péčí, a dle příslušných právních předpisů, technických norem, a dle průběžných pokynu objednatele. Provádění díla bude ze strany zhotovitele zajištěno prostřednictvím osob k této činnosti způsobilých dle obecně závazných právních předpisů.

(2) Při provádění tohoto díla je pak zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele, umístěného v místě plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy.

## 4.

(1) Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 odst. 4 písm. b) c) a i) této smlouvy se považuje za splněný dodáním příslušných dozimetrů nebo náhradních dílů objednateli na jeho pracoviště dle přílohy č. 3 k této smlouvě.

(2) Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 písm. f) této smlouvy se považuje za splněný prokazatelným doručením příslušných „Zkušebních protokolů“ z vyhodnocení dozimetrů.

(3) Objednatel přitom není povinen potvrdit splnění jeho dílčího závazku ke zhotovení díla podle tohoto článku této smlouvy, zjistí-li se na předávaném díle vada.

## 5.

(1) Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 odst. 4 písm. b), c) a f) této smlouvy ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

(2) Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 odst. 4 písm. g) této smlouvy ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu tohoto prodlení.

(3) Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

## 6.

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 odst. 4 této smlouvy cenu díla ve výši dle odpovídající součiny jednotkových cen osobních dozimetrů, a náhradních dílů dodaných zhotovitelem. Jednotková cena dozimetrů a náhradních dílů je uvedena v příloze č. 2 k této smlouvě, k níž bude připočtena DPH v sazbě podle zákona.

(2) Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. 1 odst. 4 této smlouvy v místě splnění závazku zhotovitele podle čl. 2 této smlouvy, včetně případných cestovních nákladů.

## 7.

(1) Poskytovatel oprávněn zvýšit cenu stanovenou v čl. 6 této smlouvy o částku odpovídající průměrné míře inflace (vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v ČR za uplynulý kalendářní rok) a vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to v případě, že celkový úhrn této inflace přesáhne 15 %.

(2) Cenu díla zvýšenou podle odstavce 1 oznámí zhotovitel písemně objednateli, přičemž právo účtovat takto zvýšenou cenu objednateli vzniká zhotoviteli od prvního dne čtvrtletí následujícího po doručení tohoto oznámení objednateli.

## 8.

(1) Cena díla podle čl. 6 této smlouvy je splatná vždy po splnění jednotlivých závazků zhotovitele v příslušném kalendářním čtvrtletí ve lhůtě do 30 dnu od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury – daňového dokladu) objednateli. Na faktuře/daňovém dokladu musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura/daňový doklad vztahuje: **2400001200**.

(2) Na faktuře/daňovém dokladu zhotovitel je povinen rozúčtovat cenu díla dle jednotlivých oddělení uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě.

## 9.

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v sazbě dle zákona.

## 10.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do 24 měsíců ode dne splnění závazku podle čl. 4 této smlouvy.

## 11.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamách objednatelů v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamaci, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

## 12.

Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

## 13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 až 2622 občanského zákoníku.

#### 14.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran. Tuto smlouvu lze také ze strany vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi s tím, že zhotovitel tak může učinit pouze z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany objednatele, nebo po uplynutí 3 let od účinnosti této smlouvy.

#### 15.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu, jak je obsažen v jejích člancích 1 až 20. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

#### 16.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

#### 17.

Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

#### 18.

(1) Při plnění závazků z této smlouvy je zhotovitel oprávněn jménem objednatele zpracovávat osobní údaje získané od objednatele ve smyslu přímo aplikovatelných právních předpisů EU, a to v souladu s pokyny objednavatele jakožto správce osobních údajů a s obecně závaznými právními předpisy. Za tímto účelem je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout odpovídající součinnost spočívající zejména v poskytnutí podkladů pro zpracování těchto osobních údajů.

(2) Zhotovitel jakožto zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pro objednatele jakožto správce osobních údajů výhradně za účelem v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě výslovných pokynů objednavatele

(3) Při zpracování osobních údajů není zhotovitel oprávněn:

- a) zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele.
- b) předávat od objednatele obdržené osobní údaje do třetích zemí.

#### 19.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 16, nejdříve však dne 1. 6. 2024, a uzavírá se na dobu neurčitou.

#### 20.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Základní instrukce pro uživatele služby osobní dozimetrie poskytovatele,

Příloha č. 2 – Ceník služeb osobní dozimetrie a ceník náhradních dílů,

Příloha č. 3 – Seznam pracovišť Objednatele,

Příloha č. 4 – Osvědčení o akreditaci poskytovatele podle ČSN EN ISO\_IEC  
17025\_2018,

Příloha č. 5 – Rozhodnutí SÚJB k povolení služby osobní dozimetrie pro poskytovatele

**Za Objednatele:**

**Za Poskytovatele:**

Ve Znojmě

V Praze


**MUDr.  
Miroslav  
Kavka, MBA** Digitálně podepsal  
MUDr. Miroslav  
Kavka, MBA  
Datum: 2024.05.21  
07:22:10 +02'00'

MUDr. Miroslav Kavka, FICS, MBA  
ředitel Nemocnice Znojmo, p. o.

**Zdeněk  
Zelenka** Digitálně podepsal  
Zdeněk Zelenka  
Datum: 2024.05.20  
08:40:43 +02'00'


Zdeněk Zelenka  
jednatel NUVIA Dosimetry, s.r.o.


Příloha č.1 – Základní instrukce pro uživatele služby osobní dozimetrie










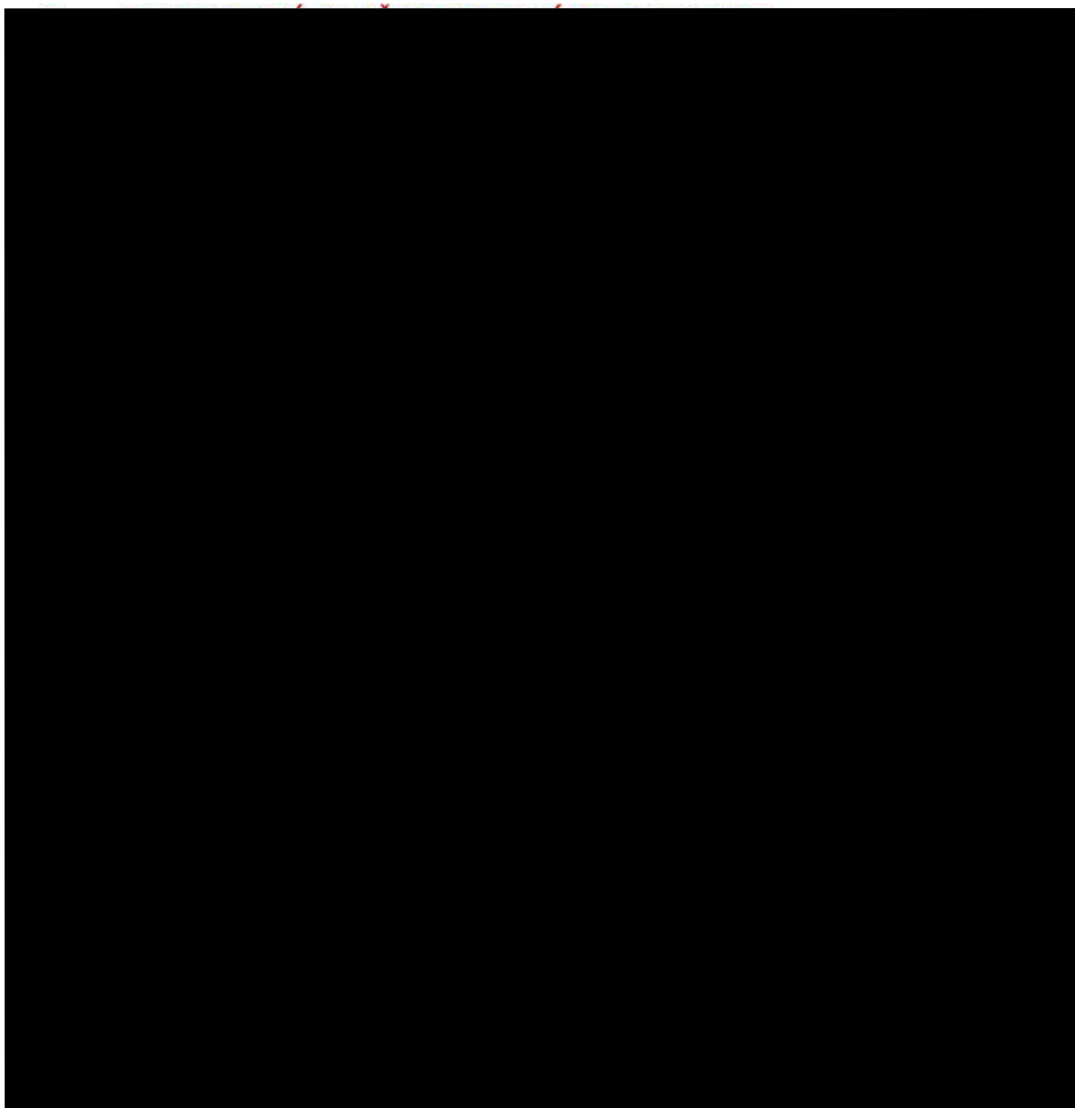





















**Příloha č. 2 – Ceník za vyhodnocení 1 ks dozimetru**

Druh dozimetru	Jednotková cena bez DPH – vyhodnocování 1x měsíčně
Dozimetr celotělový typ filmový dozimetr celotělový	129,00 Kč
Dozimetr prstový typ prstový termoluminiscenční dozimetr	200,00 Kč

Informativní ceník náhradních dílů (v případě ztráty/poškození)

Náhradní díl	Jednotková cena bez DPH
Dozimetrická kazeta (FDCT)	300,00 Kč
Prstový dozimetr (PTLD)	200,00 Kč

**Příloha č. 3 – Seznam pracovišť Objednatele**

Název oddělení	Typ dozimetru	perioda	počet ks	Dohlízející osoba	tel.	e-mail
RDG oddělení	celotělový	1 měsíc	153			
ONM	celotělový	1 měsíc	14			
ORKO	celotělový	1 měsíc	13			
ONM	prstový	1 měsíc	12			



Signatář EA MLA  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.  
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

# OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 711/2020

NUVIA Dosimetry, s.r.o.  
se sídlem Na Truhlářce 39/64, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 45240043

pro zkušební laboratoř č. 1721  
Laboratoř osobní dozimetrie

Rozsah udělené akreditace:

Zkoušení v oblasti osobní dozimetrie pro zevní ozáření vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 712/2017 ze dne 4. 12. 2017, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **24. 11. 2025**

V Praze dne 24. 11. 2020



Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.  
ředitel  
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 711/2020 ze dne: 24. 11. 2020**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:**

**NUVIA Dosimetry, s.r.o.**  
Laboratoř osobní dozimetrie  
Na Truhlářce 39/64, Libeň, 180 00 Praha 8

*Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.*

**Zkoušky:**

Pořadové číslo <sup>1</sup>	Přesný název zkušební postupu/metody	Identifikace zkušební postupu/metody <sup>2</sup>	Předmět zkoušky
1.	Stanovení osobních dávkových ekvivalentů $H_p(10)$ , $H_p(0,07)$ metodou filmové dozimetrie v polích fotonového a elektronového záření a stanovení efektivní dávky E výpočtem.	SVP-1	Osobní filmový dozimetr NUVIA

<sup>1</sup> v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

<sup>2</sup> u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

**Vysvětlivky:**

SVP standární vyhodnocovací postup  
 $H_p$  osobní dávkový ekvivalent  
E efektivní dávka



## Příloha č. 5 – Rozhodnutí SÚJB k povolení služby osobní dozimetrie



### STÁTNI ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne: 16.09.2022  
č.j.: SÚJB/OEHO/23768/2022  
Spis. značka: SÚJB/POD/21291/2022/1  
Vyřizuje útvar: Oddělení evidencí a hodnocení ozáření  
110 00 Praha, Senovážné náměstí 1585/9  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miluše Budayová  
Tel.: +420 221 624 340

### Rozhodnutí

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“), ve správním řízení ve věci nového rozhodnutí o vydání povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to provádění osobní dozimetrie včetně jejího provádění pro vlastní potřebu podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 1 atomového zákona, zahájeném podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“), na základě žádosti, kterou podala

osoba NUVIA Dosimetry, s.r.o.,  
sídlem 180 00 PRAHA, Na Truhlářce 39/64,  
identifikační číslo 45240043,  
evidenční číslo SÚJB 108405,

účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) spr. ř. (dále jen „účastník řízení“), ze dne 11.08.2022, značka NUDos/2022007, kterou SÚJB obdržel dne 11.08.2022, a kterou eviduje pod č.j. SÚJB/POD/21291/2022, rozhodl takto:

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř., podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 1 a § 22 odst. 1 písm. a) atomového zákona účastníkovi řízení

#### **povoluje**


**vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany  
konkrétně provádění osobní dozimetrie včetně jejího provádění pro vlastní potřebu,**


a to pro **zevní ozáření:**


- a) vyhodnocování **osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10)** měřeného v polích záření fotonů a elektronů prostřednictvím filmového dozimetru,

- b) vyhodnocování **osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm** Hp(10) měřeného v polích záření fotonů prostřednictvím termoluminiscenčního dozimetru,
- c) vyhodnocování **osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm** Hp(10) měřeného v polích záření rychlých, intermediálních i tepelných neutronů měřeného stopovým dozimetrem,
- d) vyhodnocování **osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 0,07 mm** Hp(0,07) měřeného v polích záření fotonů a elektronů prostřednictvím filmového dozimetru,
- e) vyhodnocování **osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 3 mm** Hp(3) měřeného v polích záření fotonů a elektronů prostřednictvím očního filmového dozimetru,
- f) stanovení **ekvivalentní dávky na ruce** s použitím prstového termoluminiscenčního dozimetru,
- g) stanovení **ekvivalentní dávky na oční čočku** s použitím očního filmového dozimetru,
- h) stanovení **ekvivalentní dávky na kůži** s použitím filmového dozimetru,
- i) stanovení **efektivní dávky E** výpočtem na základě měření příslušných veličin dle předložených metodik.

#### Odůvodnění









**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Oddělení evidencí a hodnocení ozáření, 110 00 Praha, Senovážné náměstí 1585/9 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:  
Ing. Karla Petrová  
ředitelka sekce radiační ochrany

Rozdělovník:

1. NUVIA Dosimetry,s.r.o.
2. SÚJB