



*Dodávka kloubních náhrad pro nemocnice Středočeského kraje*


**ČÁST 1 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka**




**ČÁST 2 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s rovným leštěným dříkem s centralizérem + PE jamka**




**ČÁST 3 - Náhrada kyčelního kloubu hybridní s modulární press-fit jamkou a cementovaným dříkem klasického typu**




**ČÁST 4 - Náhrada kyčelního kloubu hybridní s modulární press-fit jamkou a cementovaným  
leštěným dříkem s centralizérem**




**ČÁST 5 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, standard PE vložka acetabulární komponenty**




**ČÁST 6 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, pro pacienty s vyššími pohybovými nároky, cross-link E plast vložky acetabulární komponenty**




**ČÁST 7 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, pro mladé pacienty s nejvyššími pohybovými nároky, kombinace keramika-keramika**



**ČÁST 9 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vysokými pohybovými nároky**

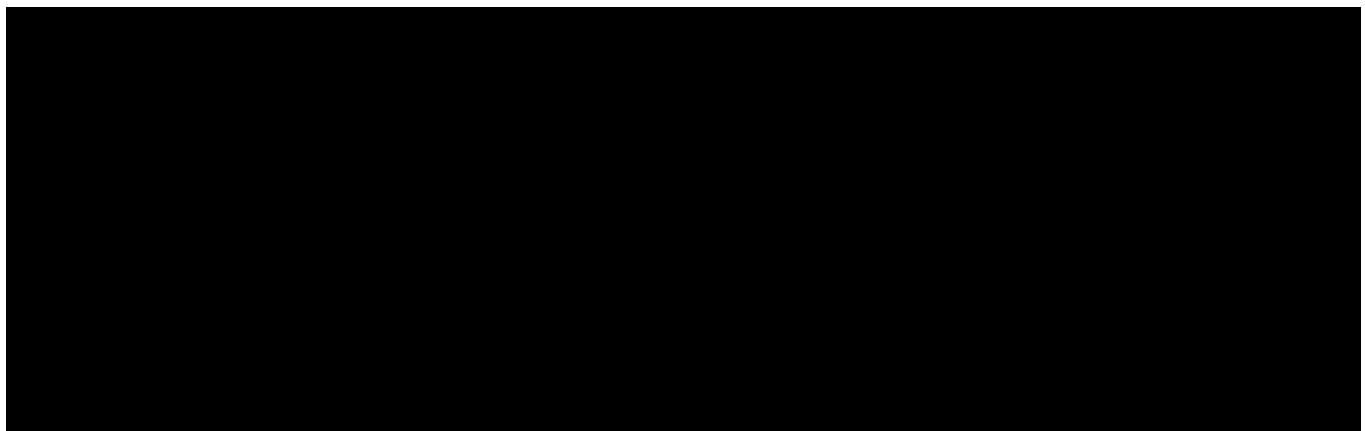

**ČÁST 10 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s alergiemi na běžné kovové materiály**



*Dodávka kloubních náhrad pro nemocnice Středočeského kraje*

---

**ČÁST 13 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně kotveným dříkem, pro pacienty s vyššími pohybovými nároky, cross-link E plast vložky acetabulární komponenty, keramická hlavice**

