

KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2024/3/05-KS

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: „ZZS Zlínského kraje – sanitka pro novorozence – 2024“

I. Smluvní strany

Prodávající:

SICAR, spol. s r.o.

jejímž jménem jedná Lenka Olmrová, jednatelka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25396.
Sídlo: Masojedy 59, 282 01 – Český Brod
IČ: 47541547
DIČ: CZ47541547
Bankovní spojení: 2108068516/2700 , Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

a

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: CZ62182137
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo k jednomu kusu speciálního sanitního vozidla pro zajištění přepravy novorozenců v kritickém stavu a také pro převoz při krizových situacích s možným ohrožením funkčnosti novorozenecké jednotky intenzivní péče nemocnic Zlínského kraje:

Výrobce: VOLKSWAGEN/SICAR,
Obchodní označení: CRAFTER/RASIC,

přičemž podrobná specifikace tohoto speciálního vozidla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je totožná s technickou specifikací podle zadávací dokumentace zadávacího řízení (*dále též jen „zboží“*).

2. Součástí zboží je dále:

- dodávka veškerých dokladů k vozidlu s řádně vepsanými údaji, nezbytných k provozování vozidla,
- dodávka veškerých návodů k obsluze v českém jazyce,
- dodávka odpovídající technické dokumentace,
- dodávka seznamu pravidelných záručních prohlídek prováděných prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem.

Předmětem této smlouvy je dále:

- doprava zboží do místa dodání;
- individuální a komplexní vyzkoušení dodaného zboží, zaškolení osob podle přílohy č. 1 této smlouvy a uvedení vozidla do plného provozu.

3. Prodávající se zavazuje, že dodané vozidlo včetně zástavby a příslušenství, jakož i všechny další součásti předmětu smlouvy, budou odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a budou homologovány pro provoz v ČR. Prodávající se dále zavazuje, že dodané zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této smlouvy budou v souladu se všemi zadávacími podmínkami v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „**ZZS Zlínského kraje – sanitka pro novorozence – 2024**“ provedeném kupujícím jako zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2024/3/05) a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím v tomto zadávacím řízení.

4. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů v průběhu výroby zboží podle specifikace uvedené v této smlouvě, a to za účelem efektivního naplnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě včetně přílohy č. 1. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost potřebnou ke konání kontrolních dnů a umožnit kupujícímu sledování průběhu výroby zboží.

5. Kupující se zavazuje zboží v době stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí

- 3 779 900,- Kč bez DPH (slovy třimiliónysedmsetsedmdesátdevěttisícdevětset korun českých bez DPH).

V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.

2. Kupní cena uvedená v tomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a konečná pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, jiné přírážky a další náklady prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně dodávky zboží. Kopie předávacího protokolu musí být přiložena k faktuře prodávajícího.
4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dní od data jejího doručení kupujícímu.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti ve sjednané délce běží znovu ode dne doručení opravené faktury.
6. Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

IV. Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Peroutkovo nábr. 434, 760 01 Zlín.
2. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do dne 15.12.2024. Prodávající oznámí termín dodání vozidla kupujícímu nejméně 7 dní předem.
3. Veškeré doklady k vozidlu s řádně vepsanými údaji, nezbytné k provozování vozidla, budou dodány k termínu dodání. Při dodržení této podmínky bude za den skutečného dodání zboží považován den fyzického předání vozidla, v opačném případě se jedná o nesplnění termínu dodání. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem fyzického předání a převzetí vozidla.
4. Kupující není povinen zboží převzít, pokud dodávané zboží vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného zboží bude sepsán a smluvními stranami podepsán předávací protokol.
5. Za nesplnění termínu dodání zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, kterou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 14 dnů ode dne, kdy byl k zaplacení smluvní pokuty kupujícím vyzván.

V. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v trvání 48 měsíců s omezením do najetí 200 000 kilometrů, a to na celý rozsah dodávky. Prodávající dále poskytuje kupujícímu pětiletou záruku proti prorezavění karoserie a nástavby dodaného vozidla. Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy. V této době zodpovídá prodávající za to, že předmět smlouvy (nebo jeho část) bude mít vlastností stanovené smlouvou, případně vlastností obvyklé. Po celou dobu záruční

doby prodávající odpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

2. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady do doby, kdy je předmět smlouvy (nebo jeho část) po odstranění vady převzat nebo mělo být převzat kupujícím, se nezapočítává do záruční doby předmětu smlouvy (nebo jeho části).
4. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů na zboží nejméně po dobu 10 let ode dne předání a převzetí zboží.
5. Pro odpovědnost za vady zboží platí, není-li sjednáno jinak, ustanovení §2099 a násl. občanského zákoníku.

VI. Ostatní ujednání

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy okamžikem předání a převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zboží.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení povinností prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího s uskutečněním dodávky zboží přesahující 15 kalendářních dnů.
3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti smlouvy.

Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností kupujícího.

4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha číslo 1 - Specifikace zboží

V Masojedech dne

Ve Zlíně dne

.....
prodávající
SICAR, spol. s r.o.
Lenka Olmrová
Jednatelka

.....
kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvk. Organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2024/3/05-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

SICAR, spol. s r.o.

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Pokud se v této příloze hovoří o zadavateli, rozumí se jím kupující. Pokud se v této příloze hovoří o dodavateli, rozumí se jím prodávající.

Specifikace zboží:

Položková specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B (2. stupeň výroby) dle ČSN EN 1789+A2 a v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení v neonatální úpravě.

Specifikace vozidla (podvozku a kabiny posádky v 1. stupni výroby)

Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby, například zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídicí jednotky motoru.

- Nové vozidlo rok výroby 2023 nebo 2024.
- Najeto max. 1300 km.
- Motor přeplňovaný vznětový min. objem 1900 ccm.
- Maximální výkon motoru min. 130 kW, maximální krouticí moment min. 400 Nm.
- Motor emisní norma min. Euro 6.
- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost max. 5000 kg.
- Kabina řidiče v konfiguraci sedadel 1+1, obě sedadla min. s 1 ks loketní opěrkou vnitřní, bederní opěrkou, výškově nastavitelná, obě sedadla vyhřívaná s odděleným nastavením stupně vyhřívání.
- Pohon všech kol s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.
- ABS, elektronický stabilizační systém, protipokluzový systém zajišťující přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky, asistent proti bočnímu větru.
- Asistent pro jízdu z kopce.
- Kotoučové brzdy na všech kolech.
- Otáčkoměr.
- Multifunkční ukazatel palubní počítač (ukazatel min. vnější teploty, spotřeby paliva a dojezdu).

- Tempomat.
- Airbag řidiče a spolujezdce včetně předpínačů bezpečnostních pásů, boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce.
- Automatická převodovka minimálně šestistupňová ve směru vpřed a se zpátečkou.
- Dělicí přepážka s posuvnými dveřmi pro průchod personálu mezi kabinou a ambulantní částí.
- Boční posuvné dveře vpravo s posuvným oknem.
- Boční posuvné dveře vlevo bez okna.
- Tónovaná skla v kabině řidiče pouze boční u řidiče a spolujezdce, tónování dle platné legislativy - vyhlášky. V ambulantní části tónování u bočních posuvných dveří vpravo s otvíracím oknem a u zadních dvou křídlových dveří s okny. Propustnost tónování v ambulantní části maximálně 20%.
- Dvoukřídlé prosklené vysoké dveře na celou výšku ambulantního prostoru, které umožní nastoupení/naložení do vozidla zezadu.
- Barva karoserie sírově žlutá RAL 1016, lakování od výrobce vozidla.
- Přední mlhové reflektory integrované v nárazníku s přisvěcováním do zatáčky.
- Zadní mlhová světla.
- LED hlavní světlomety, LED denní svícení.
- Druhý akumulátor 12 V / min. 90Ah / 420 A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230 V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10 V, v ambulantním prostoru zvuková signalizace při poklesu pod 10,5 V.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 ks funkční klíč, možnost uzamčení a odemčení vozidla zevnitř z místa řidiče.
- Alternátor, nabíjecí proud min. 200A.
- Systém umožňující nechat motor uzamčeného vozidla v chodu, se zataženou ruční brzdou, bez klíče v zapalování, včetně uzamčení vozu dálkovým ovladačem v klíčku od vozidla.
- Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhříváná.
- Elektricky ovládaná okna vpředu.
- Parkovací senzory vpředu a vzadu dodané výrobcem vozidla, akustické a optické upozornění řidiče na překážku.
- Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným displejem v kabině řidiče.
- Klimatizace kabiny řidiče automatická.
- Mapová svítidla v LED technologii u spolujezdce s vypínačem.
- Tlumiče pérování, odpovídající celkové hmotnosti a zátěži vozidla.
- Osazení vozidla typem pneumatik odpovídajícím zatížení na jednotlivé nápravy po instalaci zástavby, včetně plné posádky a pacientů.
- Středové kryty kol, kola min. 16" nebo elektronová kola min.16".
- Plnohodnotné rezervní kolo včetně heveru a klíče na kola.
- Sada 4 ks zimních kol schváleného typu, kola a pneumatiky odpovídající zatížení jednotlivých náprav po instalaci zástavby včetně posádky a pacienta.
- Autorádio, USB vstup, bluetooth telefonování.
- Kontrola opotřebení brzdového obložení.
- Délka vozidla max. 6200 mm.
- Rozhraní pro připojení externích zařízení dodavatele zdravotnické zástavby.

- Tažné oko vpředu a vzadu.
- Výbava: 2 ks výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek, tažné lano s háky min. nosnost lana 4 t, výstražná vesta oranžová, gumové koberce řidiče a spolujezdce, 2 ks základací klínů včetně držáků a montáže držáků klínů, 2 páry pracovních rukavic.

Sanitní zástavba - specifikace (2. stupeň výroby sanitního vozidla)

- Minimální počet přepravovaných osob na sedadlech a lůžku včetně řidiče je 5, každé sedadlo vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem.
- Délka nákladového prostoru od přepážky mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem až po zadní dveře ambulantního prostoru min. 3 000 mm.
- Klimatizace ambulantního prostoru napojená na klimatizaci v kabině řidiče. Ovládání mechanické integrované do ovládacího panelu v ambulantním prostoru, případně ovládání automatické nastavením teploty ambulantního prostoru z kabiny řidiče (automaticky regulovaná teplota). V případě použití neoriginálního výparníku a rozvodu klimatizace k němu zadavatel požaduje dodání písemného vyjádření výrobce vozidla v 1. stupni výroby o schválení montáže tohoto zařízení do vozidla s uvedením, že tato montáž nemá vliv na podmínky záruky vozidla v 1. stupni výroby.
- Nezávislé naftové topení pro ambulantní prostor o minimálním výkonu 3,5 kW s digitálním ovladačem integrovaným do ovládacího panelu v ambulantním prostoru.
- Teplovodní topení s min. dvourychlostním ventilátorem (nebo automaticky ovládaným ventilátorem) v ambulantním prostoru napojené na chladicí systém motoru vozidla.
- Teplovzdušné topení 230V o minimálním výkonu 2 kW v ambulantním prostoru uchyceno na nehořlavé podložce, s termostatickým spínačem, zapojené do zásuvky 230V barevně rozlišené.
- Zadní náprava pneumaticky odpružená. Kompatibilita s ESP vozidla v 1. stupni výroby.
- Dodávka a montáž antény 1+1 pro vysílačky (1 ks 160 MHz, 1 ks 400 MHz Matra), umístěné na střeše vozidla, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla zadavatel během výroby vozidla určí přesné umístění antén. Všechny kabelové spoje musí být přístupné.
- Dodávka a montáž kabeláže pro vysílačku Matra (400 MHz) se samostatným jištěním.
- Dodávka a montáž napájecího kabelu pro radiostanici Motorola (160 MHz) vč. konektoru se samostatným jištěním.
- Osvětlení ambulantního prostoru min. 2 ks LED pásu se stmívačem a s vypínači u zadních dveří, bočních dveří, kabině řidiče a v ovládacím panelu u bočního sedadla. Osvětlení musí umožnit noční modrý svit s možností regulace intenzity světla. Provedení osvětlení odsouhlasí zadavatel před instalací do vozidla.
- Pomocné nouzové osvětlení ambulantního prostoru a schodu bočních dveří.
- Lékařské LED bodové světlo zapuštěné do stropu nad nosítky 2 ks. Barva svitu teplá bílá.
- Optická signalizace otevřených dveří pro řidiče.
- Kamerový systém s monitorem v patientském prostoru s možností přepínání kamer a připojení externích zařízení. Přesné umístění odsouhlasí před montáží zadavatel.
- Stropní ventilátor obousměrný.

- Chladnička včetně držáku, s minimálním objemem 7 litrů, v chodu při spuštěném motoru a při napojení na 230V, možno kombinované zařízení umožňující chlazení na 5 °C nebo ohřev na 37 °C.
- Nabíječka obou akumulátorů 12/230V min. 30A a automatickou ochranou proti přebíjení pro oba akumulátory.
- Vstup a rozvod 230V s 15m připojovacím kabelem s koncovkami, automatický mžikový (samovyhazovací) systém odpojení přípojky 230V, v kovovém nerezovém provedení venkovní zásuvka Rettbox (kompatibilita se stávajícími rozvody 230V), přesné umístění připojovací zásuvky pro vstup 230V do vozidla určí zadavatel dle nabídnutého typu podvozku. Rozvod 230V s jističi za sedadlem řidiče nebo v prostoru levých posuvných dveří, s kontrolkou připojení 230V na přístrojové desce, podrobné schéma zapojení s revizní zprávou.
- 3 ks zásuvka 230V jednoduchá v ambulantním prostoru, zásuvky funkční při napojení vozidla na dobíjecí kabel 230V, přesné umístění zásuvek určí zadavatel.
- 2 x barevně odlišená zásuvka 230V AC napájená samostatným měničem min. 600W (zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a musí být funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování), přesné umístění určí zadavatel.
- 3 ks zapalovačová zásuvka 12V , každá zásuvka samostatně jištěná s optickou kontrolou funkčnosti, přesné rozmístění všech zásuvek určí zadavatel.
- 2 ks zásuvka 12V s USB výstupem 5V min. 2,1A a optickou signalizací.
- 1 ks zásuvka rohová 12V .
- Panel pro vypínače a ovládače v ambulantním prostoru.
- Dodávka a montáž sinusového měniče 230V AC, min. 1000W vhodného pro napájení tiskárny s externím ovládáním a nastavitelným časovým doběhem, zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla zadavatel během výroby vozidla určí přesné umístění a nastavení měniče. Měnič běží v každém režimu po nastavenou dobu.
- 4 ks zásuvka 12V přístrojová na levé stěně ambulantního prostoru a 1 ks zásuvka pro inkubátor Dartin DC 12V-100/500 s led-diodou a 1 ks zásuvka SPEAKON 2x2, obě umístěné v zadní levé části zástavby, každá zásuvka samostatně jištěná s optickou kontrolou funkčnosti, přesné rozmístění všech zásuvek určí zadavatel.
- 2 ks zásuvka USB (propoj) umožňující propojení tabletu a tiskárny. 1 zásuvka umístěna 1x v blízkosti držáku tiskárny a 2 v kabině řidiče v dosahu spolujezdce. Přesné umístění zásuvek odsouhlasí zadavatel před montáží.
- Germicidní lampa napájená z 230 V - 1ks.
- Výztuhy karoserie plechem pro uchycení přístrojů a nábytku a vybavení.
- Protiskluzová vodovzdorná podlaha, zatmelení spár, s navazujícím olištováním u vstupů.
- Tepelná a hluková izolace (odhlučnění) ambulantního (sanitního) prostoru z pěněných samozhášejících materiálů.
- Sestava úložných prostor, skříněk pro uložení zdravotnického materiálu a rozmístění jednotlivých komponentů v zástavbě viz ilustrativní nákresy.
- Držák tiskárny HP LJ nebo Brother PJ, přesný typ a model určí zadavatel. Certifikovaný dle ČSN EN 1789+A2, umístěný na horní desce kombinované skřínky. Poblíž tohoto držáku 2x USB zásuvka, propoj s dokovací stanicí tabletu a kabinou řidiče. Pro napájení tiskárny bude instalována 12V auto zásuvka (cigareťák) s optickou signalizací a zásuvka

230V (sinusový měnič). Obě zásuvky budou samostatně jištěny. Přesné umístění zásuvek a držáku odsouhlasí zadavatel před montáží.

- Ovládací panel integrovaný do odkládacího pultíku obsahující ovladače pro osvětlení, regulaci intenzity světla, bodové osvětlení strop, osvětlení pultíku, ovladač teplovodního topení a klimatizace s nastavením teploty (pokud není topení a klimatizace ambulantního prostoru ovládána automaticky nastavením teploty tohoto prostoru na ovladači v kabině řidiče), reproduktory strop, redukční ventil kyslíku, ventilátor strop, nezávislé topení, zvuková signalizace k řidiči, rohová zapalovačová zásuvka 12V s krytkou, samostatně jištěná s optickou kontrolou funkčnosti vše v dosahu sedící osoby na otočném sedadle umístěné na pravém boku ambulantního prostoru.
- V dosahu otočného sedadla na pravém boku držák tabletu Panasonic FZ-G2, certifikovaný dle ČSN EN 1789+A2, umožňující vyjmutí tabletu osobou sedící na tomto sedadle. Dokovací stanice umožňuje nabíjení tabletu a tisk na instalované tiskárně přes USB kabel. Přesné umístění odsouhlasí zadavatel.
- 2 ks sklopné a otočné sedadlo M1 s odklopným sedákem, nastavitelnou opěrkou hlavy a 2 ks loketními opěrami a polohovatelnou zádivou opěrou ve směru jízdy vpravo. Přesné umístění sedadel určí zadavatel. Ve vozidle bude provedena příprava na případnou montáž třetího sklopného sedadla v ambulantním prostoru, na straně průchodu mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče.
Sedadla vybavena senzorem přítomnosti sedící osoby a senzorem zapnutého bezpečnostního pásu. V případě sedící osoby na těchto sedadlech bez zapnutého bezpečnostního pásu, se v zorném poli řidiče rozsvítí kontrolka. V případě rozjetí vozidla vyšší rychlostí doplní světelnou signalizaci zvuková signalizace upozorňující řidiče na sedící osobu s nezapnutým bezpečnostním pásem.
- Podstropní skříňky na levé straně v celé délce ambulantního prostoru s posuvnými nebo výklopnými průhlednými dvířky nebo roletkou v nehluchém vedení. V případě zakrytí roletkou, zadavatel požaduje podsvícení tohoto prostoru LED páskem. LED osvětlení se sepne otevřením roletky. (Rozmístění skříněk blíže viz grafické schéma níže).
- Podstropní skříňky na pravé straně v celé délce od bočních dveří dozadu, s výklopnými posuvnými nebo průhlednými dvířky. (Rozmístění skříněk blíže viz grafické schéma níže).
- Uzamykatelná skříňka na opiáty integrovaná do podstropní skříňky na pravém boku. (Rozmístění skříněk blíže viz grafické schéma níže).
- V prostoru mezi podstropními skříňkami a skříňkou nad levým zadním podběhem certifikovaný kolejnicový systém pro montáž držáků přístrojů (monitor s defibrilátorem, plicním ventilátorem a odsávačkou Accuvac Lite).
- 1 ks držák injekčního dávkovače včetně madla. Držák musí být schopen pojmout min. dva dávkovače společně. Umístění držáku odsouhlasí zadavatel.
- Posuvný držák infuzních lahví (PE vaků) v nerezovém provedení 2x se stropním madlem, 1 ks tyč u stropu, 3 ks jednoduchý háček.
- Centrální rozvod kyslíku s min. pěti rychlospojkami dle platné ČSN. 3 rychlospojky na panelu a 2 rychlospojky u láhví. Redukční kyslíkový ventil integrovaný v ovládacím panelu odkládacího pultíku u bočního sedadla, s vývodem pro připojení hadičky s polomaskou ve stropě nad nosítky. Ve stropě úložný prostor pro polomasku s hadičkou zakrytý posuvnou roletkou. Vše dle ilustrativního nákresu níže. 2 ks propojovací hadice

s koncovkami pro propojení kyslíkové lahve a rychlospojkou. Rozmístění komponentů kyslíkového rozvodu odsouhlasí před výrobou a vlastní montáží zadavatel.

- Centrální rozvod vzduchu - s min. pěti rychlospojkami dle platné ČSN. 3 rychlospojky na panelu a 2 rychlospojky u láhví.
- 4 ks držáku pro desetilitrové tlakové láhve (kyslíkové nebo vzduchové) na levé straně, přístupné z boku pomocí levých posuvných dveří, certifikovaný dle ČSN EN 1789+A2.
- 1 ks držák pro jednu 2 litrovou kyslíkovou láhev (pravý), certifikovaný dle ČSN EN 1789+A2, umístění v levém bočním odděleném prostoru dole. (Přesné umístění viz grafická schémata níže).
- V levém bočním prostoru přístupném zvenku bude dále prostor pro uchycení Trauma batohu, vakuových dlah, krčních límců, extenzní dlahy a vyprošťovací vesty. Přesné umístění určí zadavatel před zahájením výroby dle konkrétního typu vozidla.
- 1 ks držák na NO láhve. Láhev musí být umístěna v ambulantním prostoru co nejbližší hlavy pacienta. Držák NO láhve může být ve variabilním provedení, tzn. že může být snadno demontovatelný a do vozidla instalován řidičem až v případě potřeby.
- 1 ks hasicí přístroj 2 kg, hasicí schopnost min. 34B. Přesné umístění odsouhlasí před montáží zadavatel.
- 2 ks držák ochranné přilby. Držák musí zajistit bezpečné uchycení přileb, musí být rychloupínací a musí zajistit nehlučnost připevněných ochranných přileb. Přesné umístění odsouhlasí před montáží zadavatel.
- Ruční dobíjecí LED svítidla včetně držáku s dobíjením. Přesné umístění odsouhlasí před montáží zadavatel.
- Otvor s posuvnými dveřmi pro průchod personálu v přepážce z ambulantního prostoru k řidiči. Podrobné řešení dveří bude odsouhlaseno před vlastní výrobou.
- 1 ks držák dávkovače desinfekce z nádoby, držák z nerezové oceli, držák musí umožnit použití několika různých typů nádob desinfekčních přípravků.
- 4 ks držák krabice s jednorázovými rukavicemi. Držák musí zamezit pohybu krabic za jízdy. Přesné umístění určí zadavatel.
- 1 ks nádoba na infekční - kontaminovaný odpad, přičemž přesnou specifikaci a umístění určí zadavatel v průběhu výroby za účelem dodržení kompatibility v závislosti na typu nabízeného vozidla.
- Digitální hodiny umístěné v ambulantním prostoru.
- Montáž dalších výše neuvedených držáků na zdravotnické přístroje dle upřesnění zadavatele. Další výše neuvedené držáky zdravotnických přístrojů dodá zadavatel.
- Nástupní nerez madla po obou stranách bočních dveří. Nástupní kovové nerez madlo na pravém boku u pravých zadních dveří.
- Samostatné autorádio pro ambulantní - patientský prostor, USB vstup, včetně vypínatelných reproduktorů.
- Dodávka a montáž kabeláže včetně duální antény na střeše vozidla pro systém **GPS NAM NCL se samostatným jištěním. Kabeláž bude ukončena a přístupná v kabině řidiče.
- Zástavba umožňující nastoupení ze zadní i pravé boční strany.
- Instalace a zapojení tabletu VT7 na palubní desce v kabině řidiče. Zařízení a schéma zapojení dodá zadavatel. Přesné umístění odsouhlasí před montáží zadavatel.
- Minimální výška v ambulantním prostoru po instalaci čisté podlahy a stropu v nejvyšším bodě oblastí I, II, III, dle ČSN EN 1789+A2 stanovuje zadavatel na 1800 mm.

- Veškeré výše popsané komponenty zástavby musí být dodavatelem dodány a namontovány jako součást zástavby vozidla a s vozidlem v prvním stupni výroby musí tvořit jeden celek za splnění podmínek homologace sanitního vozidla ambulance typu B.

Grafické značení karoserie vozidla

- Grafické značení vozidla v retroreflexním mikropismatickém provedení ve formě žlutých a zelených obdélníků, odpovídající značení vozidla rychlé zdravotnické pomoci dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. Žluté obdélníky musí být limetkového odstínu s fluorescentním provedením. Dva pruhy obdélníků na bocích vytvářející vzhled šachovnice, dle ilustrativních fotografií níže. Velikost některých obdélníků a krajních obdélníků dle tvaru a možností karoserie vozidla.
- Veškeré grafické značení vozidla dle ilustrativních fotografií níže.
- Polep spodní poloviny vnitřní strany oken k zamezení průhledu do ambulantního prostoru fólií „pískované sklo“.
- Na obou bocích logo zadavatele a nápis "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje", na obou bocích a vzadu označení vozidla "Transport novorozence" ve formě výrazného nápisu a grafického symbolu Čápa nesoucího novorozence, z přední strany nápis "Transport novorozence". Podklady dodá zadavatel.
- Veškeré grafické značení dodavatel předloží ve formě grafického návrhu zadavateli k odsouhlasení, před započítáním výroby.
- Veškeré výše popsané grafické značení musí dodavatel dodat a nainstalovat na vozidlo. Instalace musí být v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb.

Výstražné světelné a zvukové zařízení, vnější osvětlení

Veškeré použité díly musí být dodány a namontovány do vozidla v souladu s platnou legislativou, především s předpisy EHK 65 R a 10.04 (a vyšší) R.

- Zvukové výstražné zařízení o výkonu 200 W + 2 ploché reproduktory 100 W umístěné v přední části za maskou vozidla s možností ovládání na volantu. Ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ovládací prvky v přístrojové desce, přičemž v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla zadavatel během výroby vozidla určí přesné umístění ovládacích prvků. Ovládání zvukového výstražného signálu „horn“ tlačítkem na přístrojové desce a tlačítkem na opěře levé nohy. Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče.
- Světelná rampa v LED provedení s modrým a červeným svitem, nízko profilová max. 80 mm výšky a min. 1 300 mm délky. Číré provedení krytů, nebo v kombinaci s barvou. Plně osazené rohy a boky světelné rampy. Světelná rampa doplněna v přední části minimálně čtyřmi páry modrých/červených modulů (celkem 8 ks modulů), min. tři páry těchto modulů s možností vypnutí současně s přídavnými předními světly v nárazníku

a na bocích vpředu. Jeden světelný modul v rampě musí obsahovat min. tři světelné body, může být nabídnuta světelná rampa s větším celkovým počtem světelných bodů.

- Přídavná dálková LED světla umístěná v majákové rampě dva páry světelných modulů, napojená na dálková světla vozidla s možností samostatného vypnutí.
- Světelná zadní majáková rampa v LED provedení s modrým a červeným svitem umístěna vzadu, nízko profilová max. 80 mm výšky a 610 mm délky. Číré provedení krytů, nebo v kombinaci s barvou. Plně osazené rohy světelné rampy. Minimální počet světelných bodů je 54 ks. Z důvodu dobré viditelnosti může být rampa namontována na zvýšené podložce.
- Doplnkový pár zvláštních výstražných světel modré/červené barvy v LED provedení instalován v přední části vozidla (maska vozidla), vyzařující světlo vpřed s minimálně 6 světelnými body v jednom světle. Nízko profilové provedení maximálně do 10 mm hloubky. Tato světla svítí společně se světelnou rampou s možností samostatného vypnutí.
- Přídavný pár zvláštních výstražných světel modré/červené barvy v LED provedení instalován na boku v přední části vozidla (přední blatník), vyzařující světlo do boku s minimálně 6 světelnými body v jednom světle. Nízko profilové provedení maximálně do 10 mm hloubky. Tato světla svítí společně se světelnou rampou s možností samostatného vypnutí současně s párem světel v přední části vozidla.
- Přídavný pár zvláštních výstražných světel modré/červené barvy v LED provedení instalován pod zpětná zrcátka. Tato světla svítí společně se světelnou rampou s možností samostatného vypnutí současně s párem světel v přední části vozidla.
- Přídavný pár zvláštních výstražných světel modré/červené barvy v LED provedení instalován na boku v zadní části vozidla (zadní blatník), vyzařující světlo do boku s minimálně 6 světelnými body v jednom světle. Nízko profilové provedení maximálně do 10 mm hloubky. Tato světla svítí společně se světelnou rampou s možností samostatného vypnutí současně s párem světel v přední části vozidla.
- LED modré/červené světlo s min. 8 světelnými body připevněno na čelním skle zevnitř pomocí přísavek, umístění nad přístrojovou deskou. Světlo musí být schváleného typu, zapojeno do zapalovačové zásuvky integrované do přístrojové desky poblíž tohoto světla. Zásuvka napojená na přídavná modrá a červená světla v nárazníku. Přesné umístění světla a zásuvky určí zadavatel v závislosti na typu nabízeného vozidla. Zásuvka bez optické kontroly.
- Na levém a pravém boku u hrany střechy celkem 4 ks bílé LED pracovní světlo s min. 36 ks světelnými body v každém LED světle, ve žlutém krytu na osvětlení okolí vozidla, ovládané z místa řidiče vypínači, samostatně zapínatelné strany.
- Přídavná zpětná pracovní LED světla 2 ks na zadní hraně střechy vozidla osvětlující prostor za vozidlem, napojené na zpátečku, s možností zapnutí u zadních dveří, s optickou kontrolou v zorném poli řidiče. Světlo musí osvětlit dostatečně prostor za vozidlem.
- Zvuková signalizace pro chodce při couvání (Couvací zvukové znamení). Odpojitelná z místa řidiče.
- LED střešní směrová světla vzadu vpravo a vlevo svítící dozadu krytá žlutým kovovým krytem, min. 12 ks LED světelných bodů v každém světle.
- Modrá a červená barva u veškerých výstražných světel v poměru 1 : 1, červená barva u všech výstražných světel orientována na levé straně vozidla.

- Veškeré spínače a kontrolky zástavby osazeny LED kontrolkou. Veškeré instalace výstražných světelných a zvukových zařízení odsouhlasí před montáží zadavatel.

Zadavatel požaduje dodat s vozidlem následující dokumentaci a technickou podporu

- Návod k obsluze a údržbě vozidla a zástavby v českém jazyce.
- Podrobné schéma rozvodu 230V zástavby s popisem v českém jazyce.
- Podrobné schéma rozvodu 12V zástavby s popisem v českém jazyce.
- Výchozí revizní zprávu rozvodu 230V v českém jazyce.
- Podrobný přehled osazení pojistek a relé 12V pro zástavbu v českém jazyce.
- Záruční listy, nebo certifikáty od dodaných samostatných komponentů zástavby.
- Návod pro odstranění základních závad zástavby v českém jazyce.
- Proškolení pověřených zástupců zadavatele (max. 7 osob) v ovládání a údržbě dodaného vozidla. Proškolení se uskuteční v sídle zadavatele.
- V případě dodání zástavby ovládané elektronicky či softwarem, zadavatel požaduje, dodání diagnostického systému či programu, který umožní zadavateli zajištění běžných oprav a nastavení softwarového systému zástavby vozidla.


Transportní technika

- Výsuvný systém pro automatické nakládání a vykládání nosítek s podvozkem jednočlennou obsluhou, certifikovaný dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější s aretací nosítek dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější. Stůl nosítek s bočním posuvem v šíři min. 400 mm. Nakládací poloha při najíždění nosítek do vozidla je vodorovná, bez šikmých nájezdových ramp nebo naklápění stolu.
- Samonakládací nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější, s plynulým polohováním zádové opěry a možností nastavení nohou do protišokové polohy, sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem a podhlavníkem, s reflexním polepením bočních profilů, se sklopným držákem na infuze. Pro usnadnění manipulace s pacientem je požadován podvozek s plynulým elektro – hydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení pohonu, nabíjení baterií je zajištěno při zasunutí podvozku do systému pro nakládání a uchycení nosítek ve vozidle zcela automaticky, systém umožňuje rozšíření nosítek pro přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací sadu však zadavatel nepožaduje, tzn. že není součástí dodávky). Součástí dodávky nosítek musí být i modul pro externí ovládání kabelem z vozidlové baterie včetně kabelu.
- Nosítka musí být kompatibilní se systémem použitým u zadavatele a s transportním inkubátorem novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
- Držák schodolezu Evac Chair. Umístění určí zadavatel.
- Držák Scooprámu v prostoru po otevření bočních levých dveří. Přesné umístění určí zadavatel.


Rozmístění zastavovacích prvků je uvedeno níže v „Grafické části specifikace“

Grafická část specifikace


Půdorysné schéma:

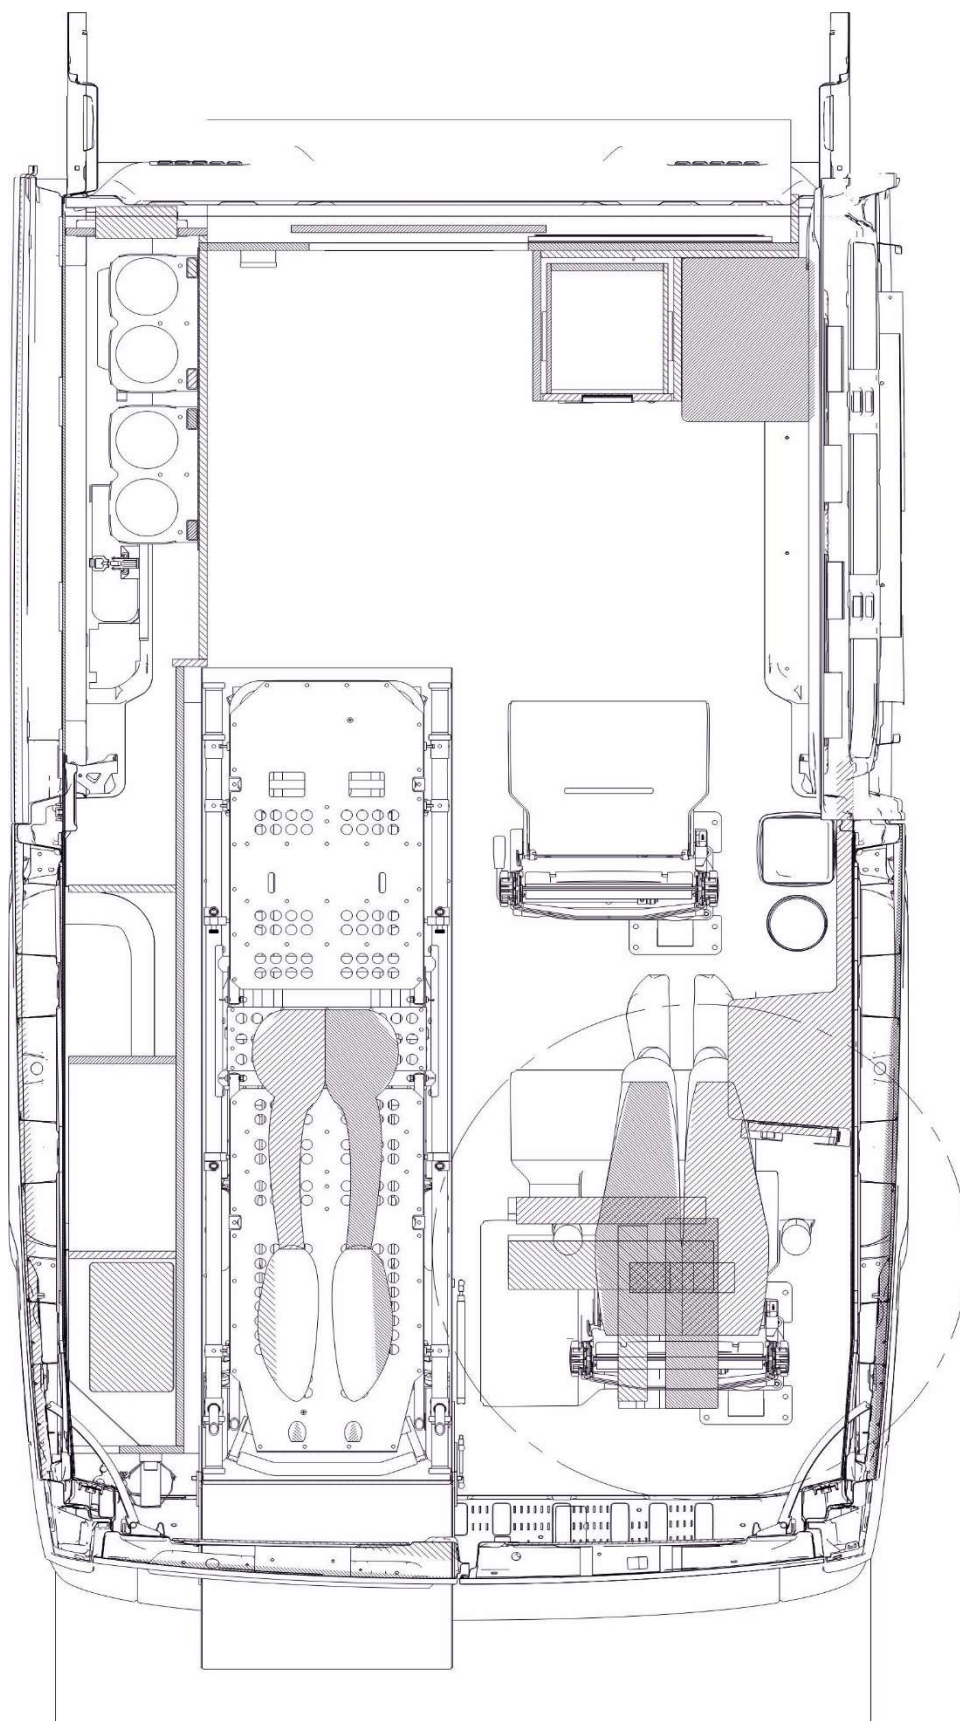


Levý bok pohled - schéma:

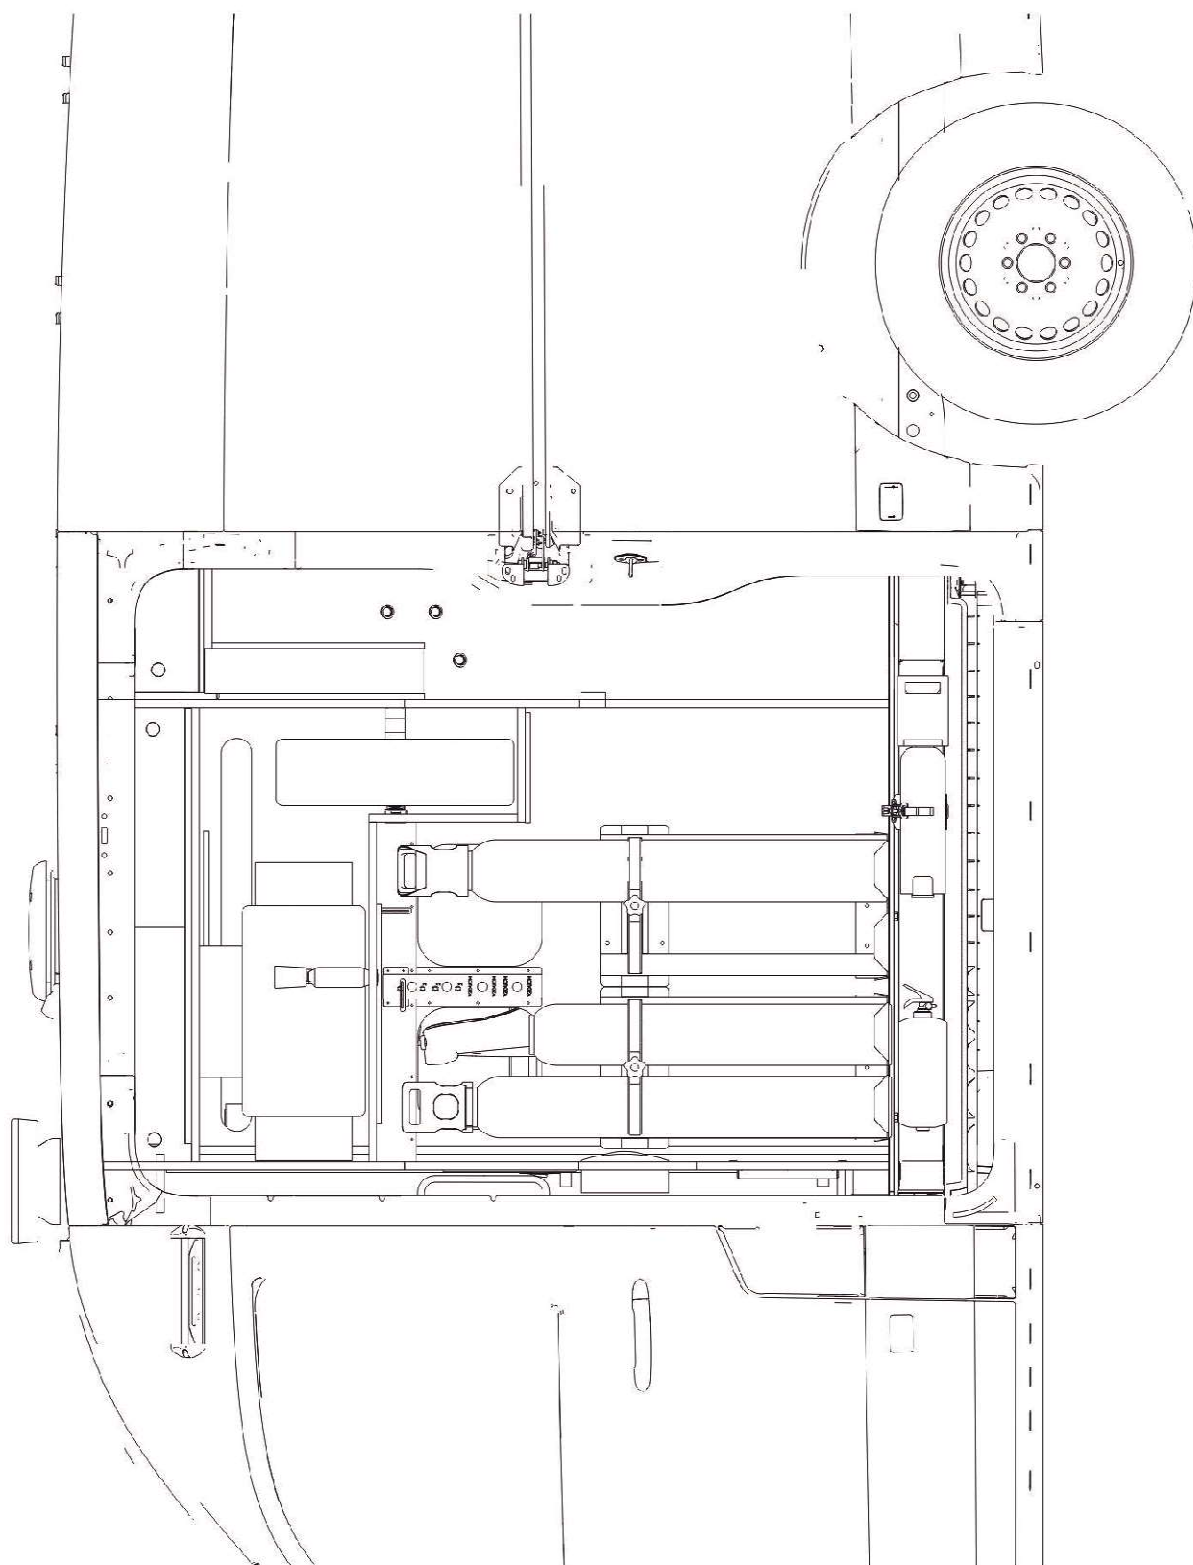


Zadní pohled in schéma:

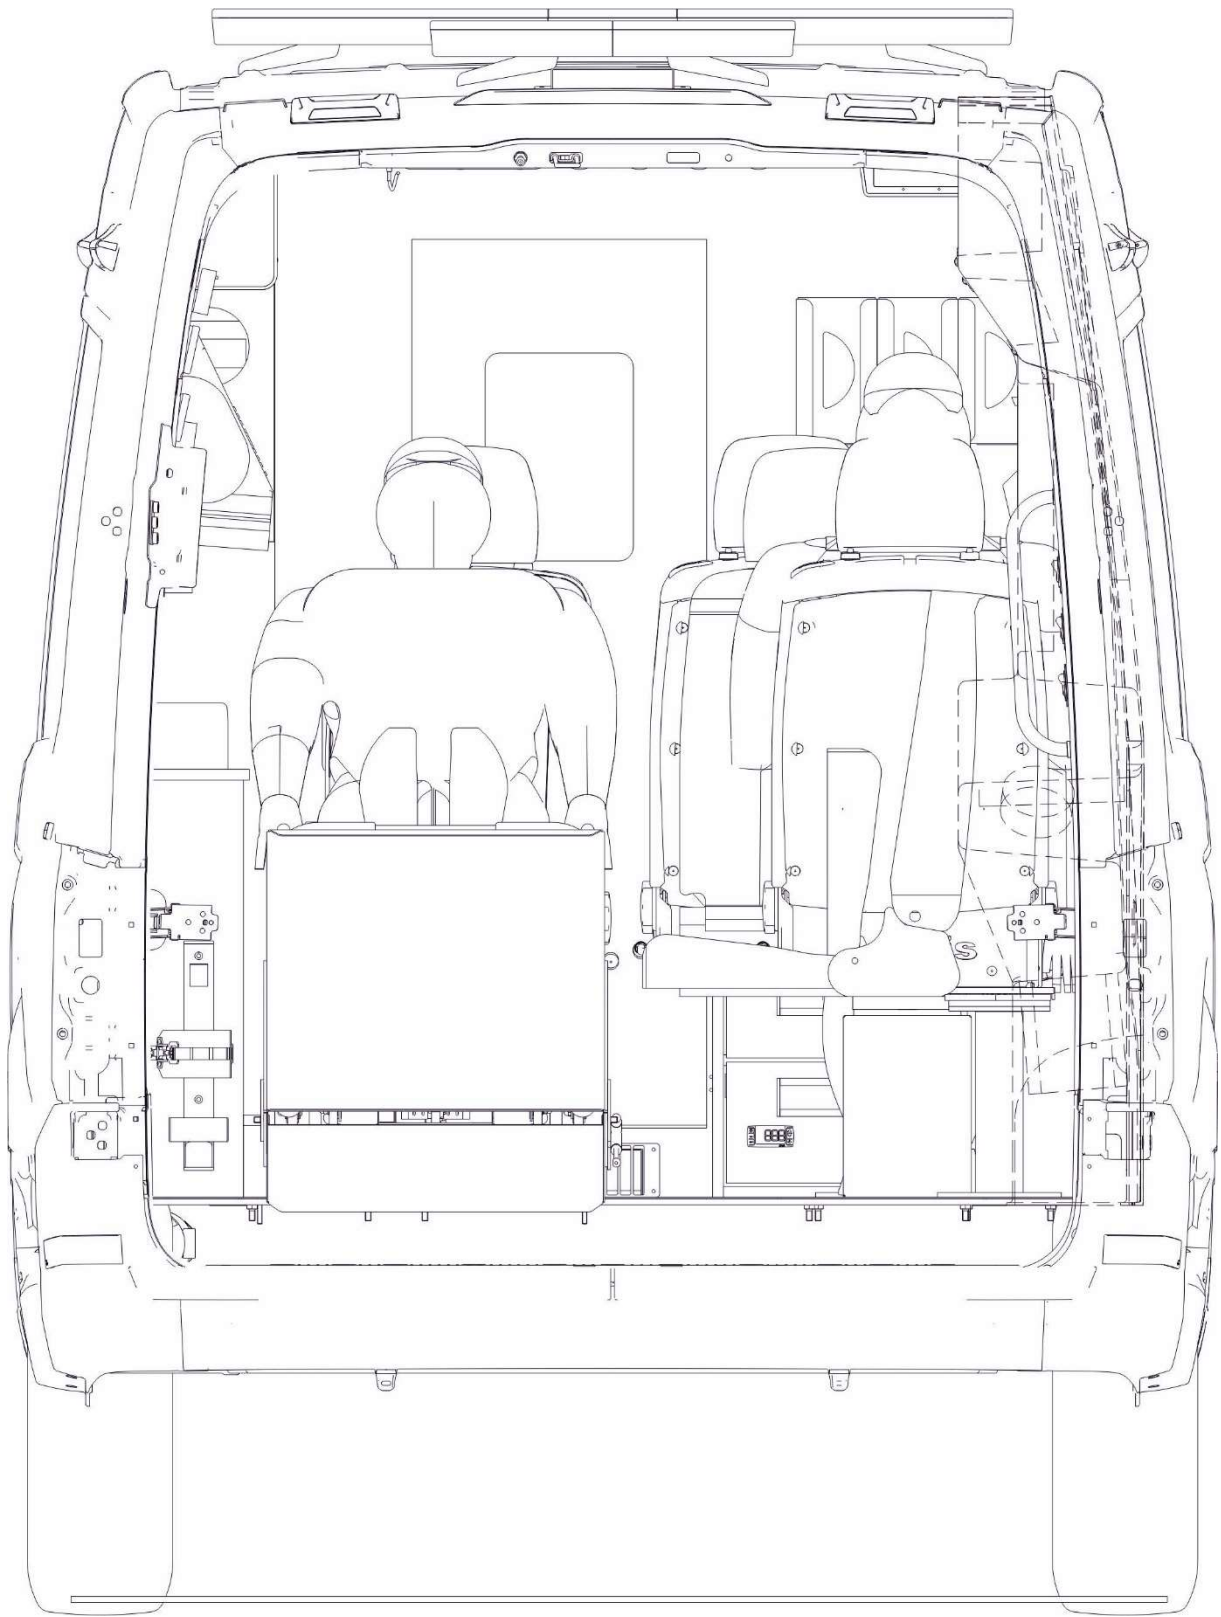

Ambulantní prostor - podélný řez schéma:

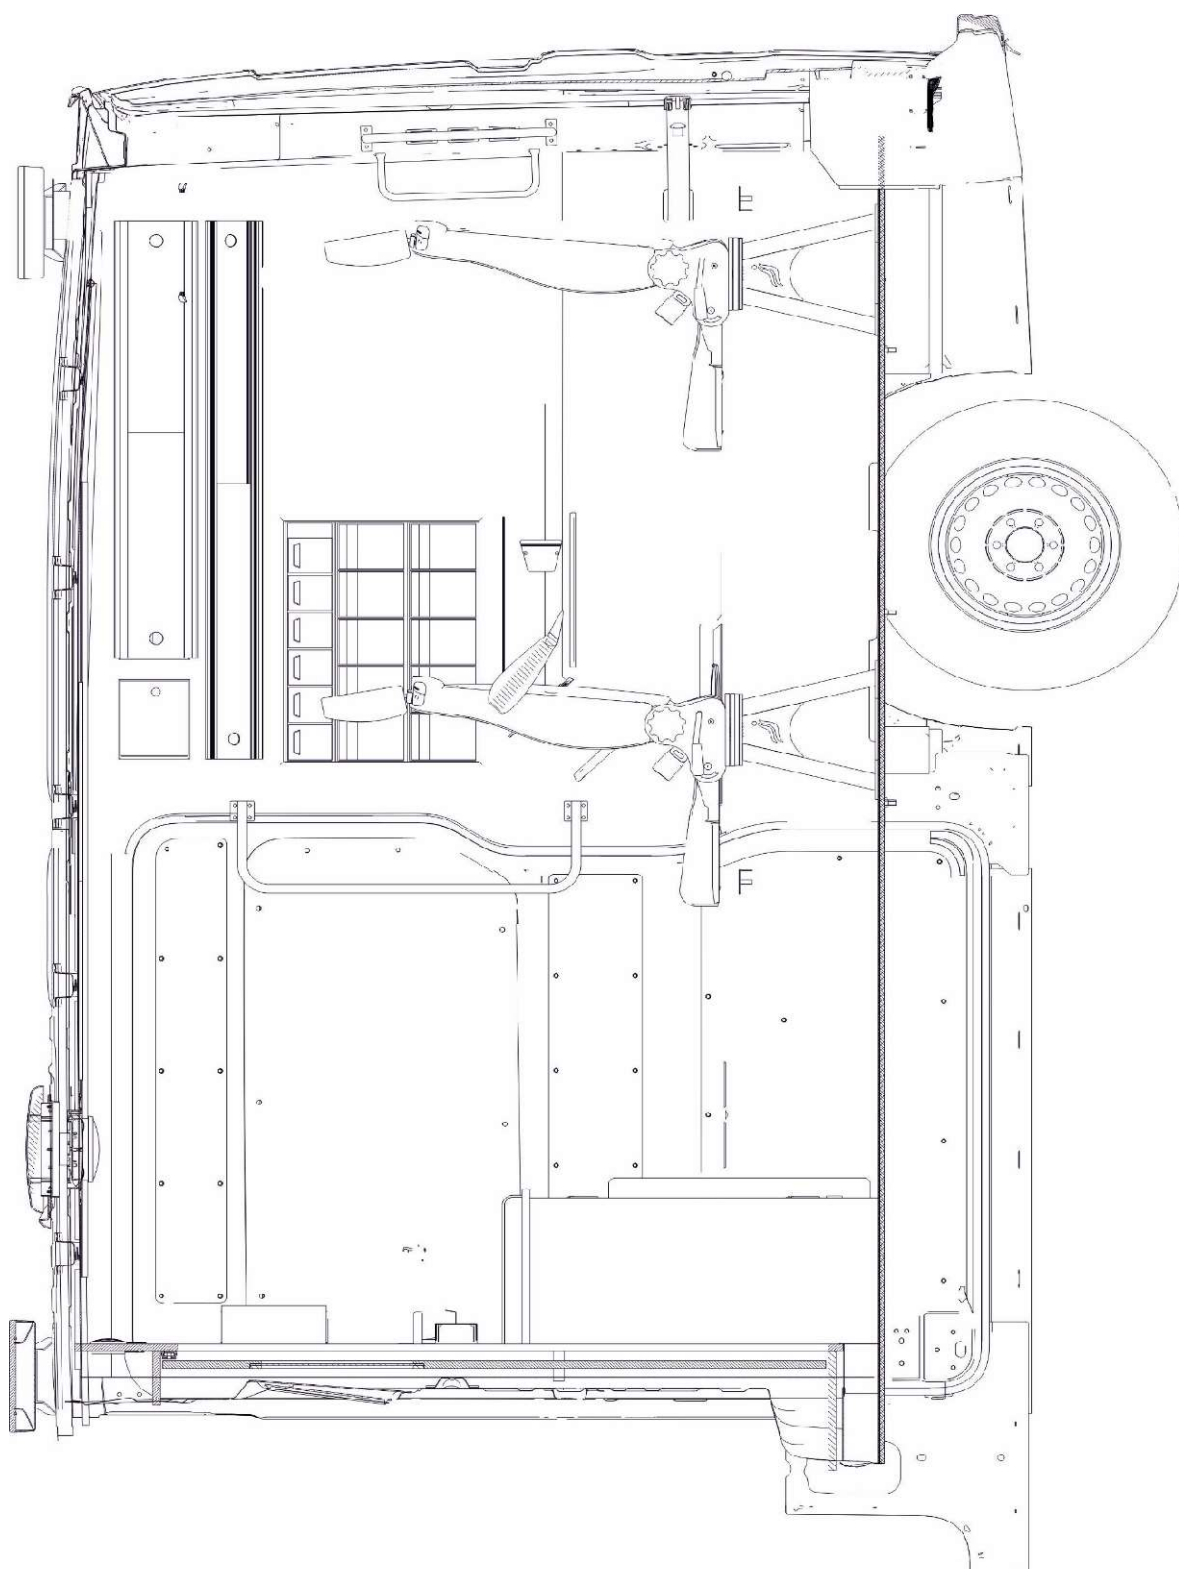

Přepážka mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče - schéma:

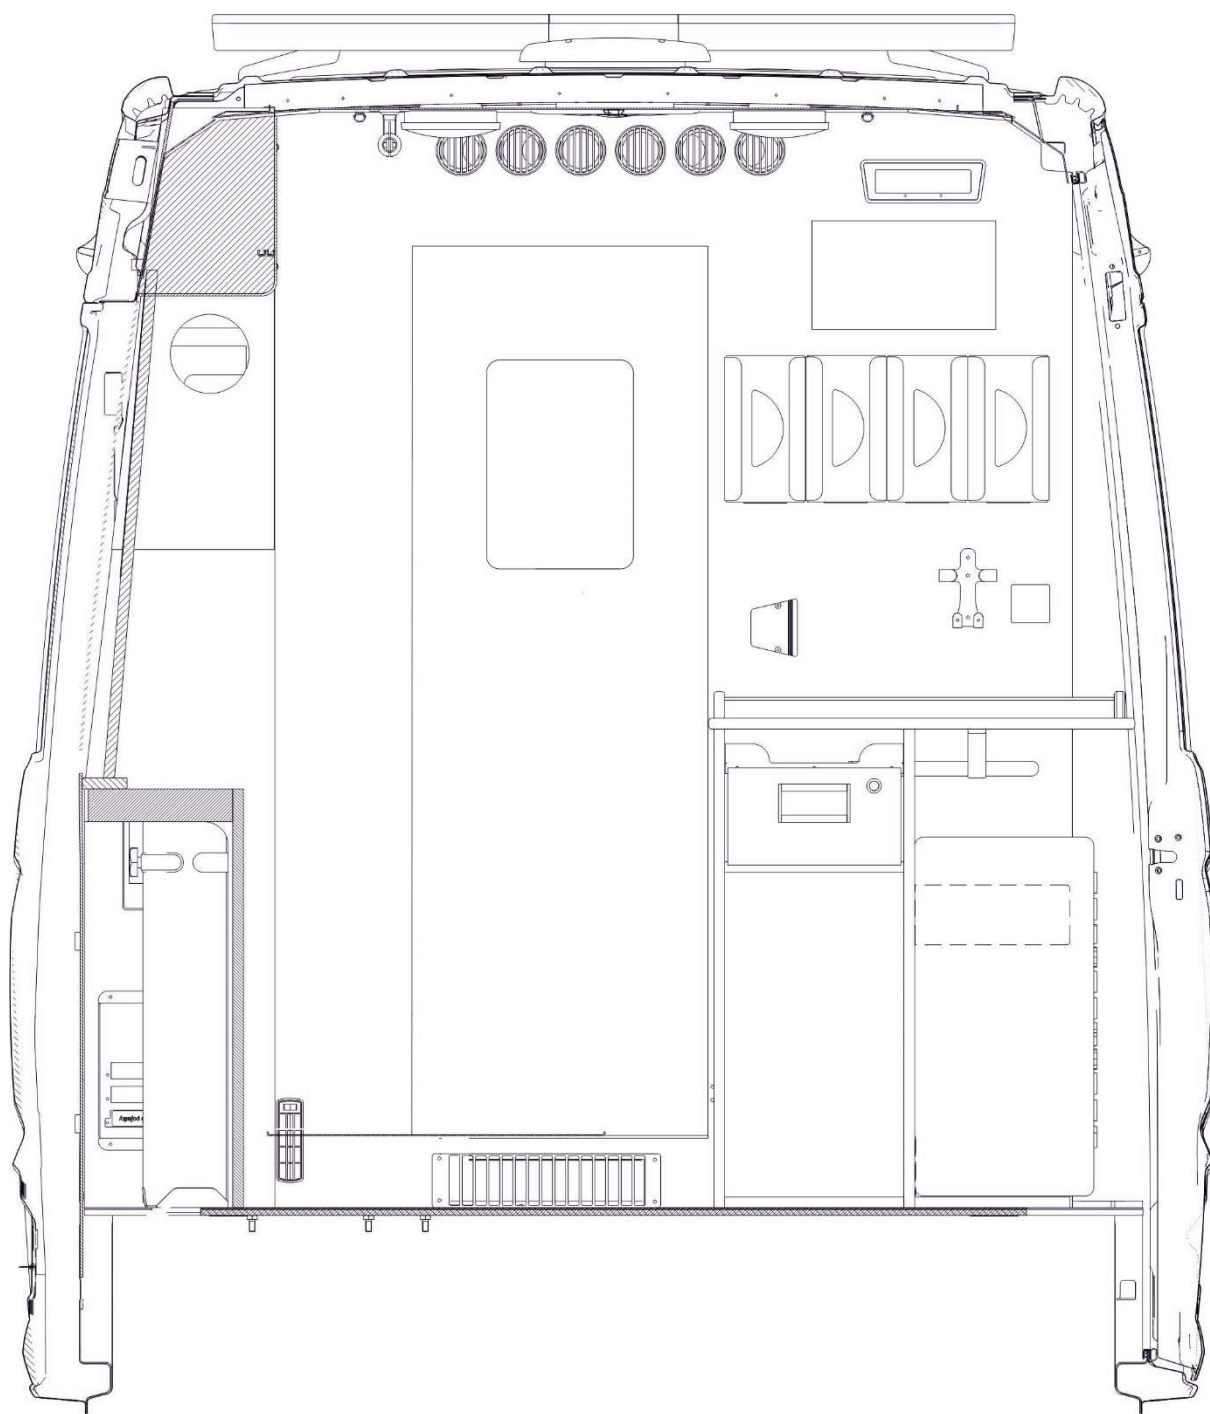

Grafické provedení vozidel zadavatele



V Masojedech dne

Ve Zlíně dne

.....
prodávající
SICAR, spol. s r.o.
Lenka Olmrová
Jednatelka

.....
kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvk. Organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel