

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „kupující“

a

BULLETIN.CZ s.r.o.

se sídlem: Lipová 724/9, 250 88 Čelákovice

IČ: 26191334

DIČ: CZ26191334

zastoupená: Ing. Jiřím Kořínkem – jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78396

na straně druhé jako „prodávající“

tento

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 19.07.2024

(SMLN-2024-617-100361)

I.

Úvodní ustanovení

Na základě výsledků veřejné zakázky soutěžené v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Operační stoly II**“, interní evidenční číslo VZ-2024-000333, smluvní strany uzavřely Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **2 ks operačního stolu Brumaba CL Genius Eye (Y1.01.12) vč. příslušenství**, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dodatečného požadavku zadávacího pracoviště **bude prodávajícím dodáno jako součást předmětu plnění i 2 ks nožního spínače**. Z uvedeného důvodu se příloha č. 1 smlouvy s názvem „Položkový seznam včetně cen a technické specifikace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku rozšíření předmětu plnění o 2 ks nožních spínačů se navyšuje kupní cena uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy takto:

Původní cena 2 ks operačních stolů:

860.000,- Kč bez DPH

180.600,- Kč DPH

1.040.600,- Kč včetně DPH

Nová cena 2 ks operačních stolů, vč. 2 ks nožních spínačů:

930.000,- Kč bez DPH

195.300,- Kč DPH

1.125.300,- Kč včetně DPH

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technické specifikace

V Olomouci dne

V Čelákovících dne

.....

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....

Ing. Jiří Kořínek, jednatel

BULLETIN.CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technické specifikace

Název: Brumaba CL Genius Eye (Y1.01.12) včetně příslušenství

Počet ks: 2

Cena za 1 ks v Kč bez DPH: 475.000,- Kč / s 21% DPH: 574.750,- Kč

Cena za 2ks v Kč bez DPH: 930.000,- Kč / s 21% DPH: 1.125.300,- Kč

Tabulka splnění minimálních technických podmínek**VZ-2024-000333 - Operační stoly II****Brumaba CL Genius Eye (Y1.01.12)****Předmět veřejné zakázky**

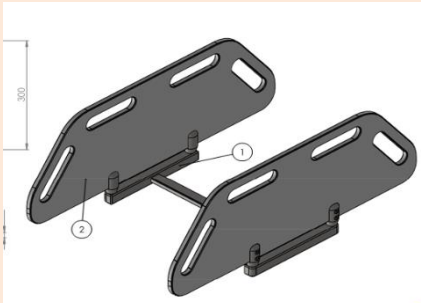
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů operačních stolů, včetně příslušenství (viz vyobrazení) pro Oční kliniku, včetně provedení zaškolení personálu.

Technická specifikace	SPLNĚNO ANO / NE	* poznámky	Vyobrazení
Operační stůl musí být mobilní, elektromechanický s pevnou operační deskou, elektrickým polohováním a bez motorizovaného pojezdu.	ANO	strany 10-11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	

Operační stůl musí mít elektricky nastavitelnou minimálně výšku, Trendelenburg – reverzní Trendelenburg, laterální náklony, zádoová sekce, nožní segmenty, podélný posun desky.	ANO	strany 10-11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	4 samostatně nastavitelné segmenty, posun výšky stolu, Trendelenburg i reverzní Trendelenburg jde nastavit do paměti stolu
Operační stůl musí mít minimálně 4-segmentovou operační desku.	ANO	strany 10-11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít 3D ovladatelný hlavový díl.	ANO	strana 10 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít ruční ovládání s plně programovatelnými paměťmi.	ANO	strana 14 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí být ovladatelný pomocí ručního ovladače (drátový/bezdrátový).	ANO	strana 14 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nosnost minimálně 250 kg.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	

Operační stůl musí mít čtyři, brzditelná, antistatická, plně otočná, plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu, které jsou chráněna krytím proti znečištění.	ANO	strany 10-11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nastavitelnou polohu Trendelenburg/reverzní Trendelenburg v rozsahu min. - 26°/+ 6°.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nastavitelný náklon hlavového dílu v rozsahu min. -31°/+22°.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nastavitelný náklon zádové sekce v rozsahu min. 0°/+75°.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nastavitelný náklon sedací sekce v rozsahu min. - 6°/+26°.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nastavitelný náklon nožní sekce v rozsahu min. 0° / + 78°.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	
Operační stůl musí mít nastavitelnou výšku v rozmezí minimálně 640 až 870 mm.	ANO	strana 11 / Katalog Brumaba Oftalmologie	

Operační stůl musí mít hliníkovou podstavu s 4 plně otáčivými dvojkoly.	ANO	variantní řešení – nerez	
Barevné provedení polstrování operačního stolu musí být dodáno dodavatelem ve variantě, kterou si musí předem písemně odsouhlasit uživatel, a to ze standardního vzorníku minimálně 9 barev.	ANO	37 barev	
<u>Součástí dodávky ke každému operačnímu stolu</u>			
Součástí dodávky je 1 ks polstrované područky s univerzálním kloubem s pásy pro upevnění předloktí.	ANO		 
Součástí dodávky je 1 ks připojitelného nožního dílu, vč. normované kolejnice – příklad provedení – viz vyobrazení. Popř. varinta řešení – prodloužení zádové části – příklad provedení – viz vyobrazení.	ANO		  

Součástí dodávky je levý a pravý boční díl. Díly musí být sklopné s rychloupínacím šroubem. Rozměry dílů jsou max. 580x220 mm – příklad provedení – viz vyobrazení	ANO		
Součástí dodávky je 1 ks ohebného držáku chirurgického krytí s přívodem kyslíku (příklad provedení – viz vyobrazení "vlevo"), včetně 1 ks držáku pro upevnění o průměru 25/18 mm (příklad provedení – viz vyobrazení "vpravo").	ANO		
Součástí dodávky je 1 ks držáku na dálkové ovládání k upevnění na infuzní stojan – příklad provedení – viz vyobrazení.	ANO		

Součástí dodávky je 1 ks opěrky pro zápěstí chirurga, včetně upínací desky – příklad provedení – viz vyobrazení.	ANO		
Součástí dodávky je 1 pár pásů pro zajištění zápěstí – příklad provedení – viz vyobrazení.	ANO		
Součástí dodávky je 1 ks dlouhého tělového pásu – příklad provedení – viz vyobrazení.	ANO		

Součástí dodávky je půlválcový, opěrný, dobře omyvatelný a dezinfenci odolný polštář s max rozměry 60 x 28 x 14 cm – příklad provedení – viz vyobrazení.	ANO		
Součástí dodávky musí být infuzní stojan vč. upevnění.	ANO		
Součást dodávky je 1 ks nožního spínače.			

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž			
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek – po dobu záruky zdarma	ANO		
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek	ANO		
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	ANO		

Obecné požadavky		
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší	ANO	
Životnost přístroje minimálně 8 let	ANO	
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě, kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek		