

Dodatek č. 2 k servisní smlouvě


Evidenční číslo poskytovatele:	28112019KRA01
Evidenční číslo objednatele:	

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 servisní smlouvy 28112019KRA01 je změna Přílohy č. 1 – Seznam zařízení.

Závěrečná ustanovení

1. Servisní smlouva č. 28112019KRA01 v částech nedotčených tímto dodatkem č. 3 zůstává v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv a jeho platnost je do 31.12.2025.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je nová Příloha č. 1 – Seznam zařízení – dodatek č. 3.

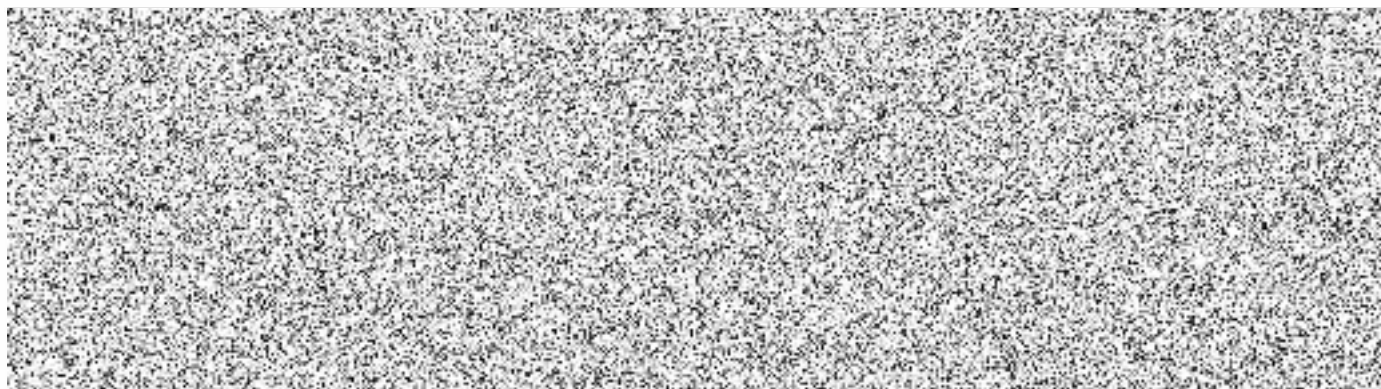

PŘÍLOHA 1 - SEZNAM ZAŘÍZENÍ pro rok 2025 - Dodatek č. 3 s platností od 1.1.2025 do 31.12.2025
Servisní smlouva číslo: 28112019KRA01

Položka	Typ zařízení	Sériové číslo	Číslo systému	Umístění	Začátek smlouvy	Typ měřidla	DKD	Typ plnění	Měsíc	Interval	Začátek prohlídek	Datum příští prohlídky	Datum změn od	Kontaktní osoba pro domlouvání termínů prohlídek s MT dispečinkem	Telefon / E-mail	Roční poplatek pro rok 2025
1	AE163															
2	AT261DR/A															
3	PB602-S/A															
4	PB3001-S/A															
5	PM300															
6	PB403-S/A															
7	pH Delta 350															
9	SevenCompact S220															
10	S220-Basic, pH/ion metr															
11	PL602-S/M 13															
12	XS205-DU/M															
13	pH metr SevenEasy															
14	pH metr SevenEasy S20															
15	pH metr SevenEasy S20															
16	pH metr SevenEasy S20															
17	pH metr SevenEasy S20															
18	XP205DR/M															
19	Titrátor T50															
20	Byreta DV1010															
21	Byreta DV1010															
22	SevenCompact S230															
23	pH metr SevenExcellence															
24	DensitoPro															
25	V30S Compact Titrátor															
26	DV1010 Byreta 10 m															
27	BYRETA DV 1005 5mL															

Začátek smlouvy - doplňte měsíc a rok, od kterého se má smlouva na dané zařízení vztahovat (např. srpen 2000 doplnit "0800").

Typ měřidla - stanovené nebo pracovní měřidlo (S = stanovené, P = pracovní).

Typ plnění - zvolený Předmět plnění pro dané zařízení (CAL = Calibration Care, BC = Basic Care, SC = Standard Care, CC = Comprehensive Care).

Měsíc - dvojčíslí měsíce, ve kterém má být prováděna servisní prohlídka, kalibrace nebo příprava na úřední ověření, lze uvést i více měsíců.

Interval - interval provádění servisní prohlídky, kalibrace nebo úředního ověřování v měsících (12M = jeden rok, 6M = 6 měsíců,...), max. 24M.

Odpovědná osoba - zástupce objednatele, který má být kontaktován při sjednávání termínu provedení servisní prohlídky, kalibrace, přípravy na úřední ověření.

Telefon / E-mail - telefonní číslo a e-mailová adresa na Odpovědnou osobu.

Poplatek Kč - roční poplatek za dané zařízení v Kč bez DPH.

* Množstevní sleva platí pouze za předpokladu, že je pravidelná servisní prohlídka prováděna v jednom dni minimálně na čtyřech zařízeních

Celkem bez DPH	72 680 Kč
Množstevní sleva * v %	20%
Množstevní sleva * v Kč	14 536 Kč
Celkem po slevě bez DPH	58 144 Kč

V Brně dne 30.12.2024

podpis zástupce objedn.

Dodatek č. 3 k servisní smlouvě

Evidenční číslo poskytovatele:	28112019KRA01
Evidenční číslo objednatele:	

A. Smluvní strany

POSKYTOVATEL			OBJEDNATEL		
Název:	Mettler – Toledo, s.r.o.		Název:	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	
IČO:	604 63 031		IČO:	000 19 453	
DIČ:	CZ 604 63 031		DIČ:	CZ 000 19 453	
Sídlo:	Ulice	Třebohostická 2283	Sídlo:	Ulice	Hudcova 232/56A
Město	Praha 10		Město	Brno 21	
PSČ	100 00		PSČ	621 00	

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C.26404. Datum zápisu: 2. 2. 1994.

Objednatel je právnickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku.

B. Odpovědné osoby

Odpovědné osoby poskytovatele		Odpovědné osoby objednatele	
Ve věcech smluvních		Ve věcech smluvních	
Jméno a příjmení			
Funkce			
Telefon			
Fax			
Mobil			
E-mail			
Ve věcech technických		Ve věcech technických	
Jméno a příjmení			
funkce			
telefon			
fax			
mobil			
e-mail			

uzavírají tento dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 28112019KRA01: