


Odběratel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav 		Odd.: Oddělení laboratorní mikrobiologie Středisko: 0330.0401 Vyřizuje: 	Poř. č. objednávky: 3-2025-21-30
ŽÁDANKA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY OBJEDNÁVKA			
Dodavatel: DiaSorin s.r.o., K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5 			
Na fakturu uveďte konečného příjemce: Oddělení laboratorní mikrobiologie, 			

	Množství (balení, kusy)
MOL2655 Simplexa Flu A/B a RSV Direct Gen II Kit	
MOL1455 DAD direkt amplification disk	
MOL4150 Simplexa COVID-19 Direct Kit	

Předpokládaná cena bez DPH:

65 000,- Kč

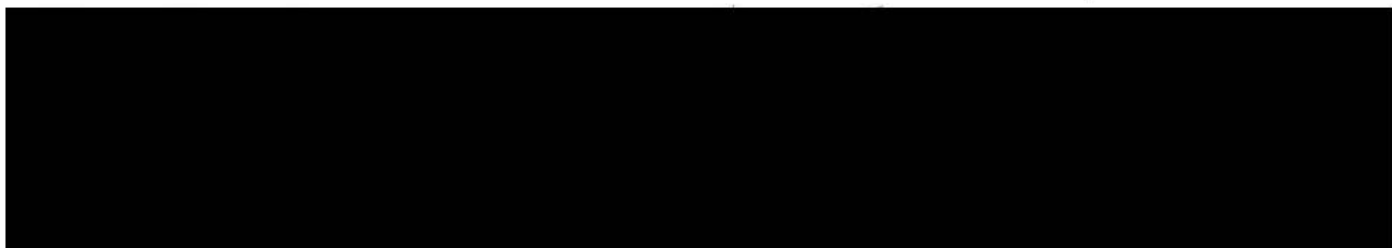

Dodací adresa

NEMOCNICE BŘECLAV, LAB. MIKROBIOLOG

PAVILON C - 1.PATRO

U NEMOCNICE 3066/1

690 74 BŘECLAV-CZE

Odběratel

NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.

U NEMOCNICE 3066/1

690 74 BŘECLAV-CZE

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník Dodací adresa

CZ00139000 CZ00139001

Objednávka.

2000036957

Datum

23/01/2025

Číslo objednávky

3-2025-21-30

Datum Objednávky


23/01/2025

Podmínky doručení

Free on departure

Způsob doručení

Číslo produktu	Sériové číslo/Šarže	Popis	Objednané množství	Cena MJ	Cena celkem
MOL2655		SIMPLEXA FLU AB & RSV Direct Gen			
MOL1455		DIRECT AMPLIFICATION DISC KIT			
MOL4150		Simplexa COVID-19 Direct			



Odesláno: 23.1.2025 16:08

Předmět: [EXTERNÍ ZPRÁVA] FW: SO 2000036957 Fwd:

Dobrý den,



Vaši objednávku č. 3-2025-21-30 ze dne 23.01.2025 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 55.200,00,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: 23.01.2025. Předpokládaný termín dodání je příští týden.

S pozdravem,



Customer Service Representative
Diasorin Order Entry Center

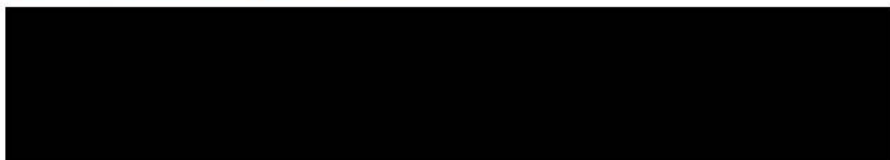

associated attachments is strictly prohibited."

[REDACTED]
Sent: Thursday, January 23, 2025 3:50 PM

[REDACTED]
Subject: SO 2000036957 Fwd:

Dobrý den,
posílám objednávku a prosím o její potvrzení

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí oddělení
Oddělení laboratorní mikrobiologie

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

[REDACTED]