


# FAKTURA - Daňový doklad

<b>1. Dodavatel</b> CHROMSPEC spol. s r.o. Jindřicha Plachty 28 150 00 Praha 5  IČ [redacted] DIČ [redacted]	<b>2. Doklad číslo</b> Smlouva Objednávka 17/04/342  EMAIL	17/04/342  EMAIL
IČ [redacted] DIČ [redacted]	<b>4. Odběratel</b> Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 IČ 68378050      DIČ CZ68378050	

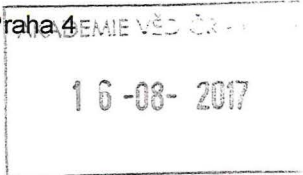

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Flemingovo nám. 2 166 10 Praha 6  IČ [redacted]      DIČ [redacted]	Datum splatnosti 30/08/2017 Forma úhrady PP Datum uskut. zdaň. plnění 03/08/2017 Datum vystavení 09/08/2017 Konstantní symbol 0308 <b>Variabilní symbol 1704342</b> Číslo dodacího listu
--	--


Označení(SKP)	Text	Počet MJ	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem
	Fakturuje Vám za provedení opravy podle SZ č. 29/7-079					
29ZT16	Zásah technika (hod)	9,00	1 320,00	11 880,00	2 494,80	14 374,80
29CNI	Doprava zóna I	1,00	1 000,00	1 000,00	210,00	1 210,00
	Fluorescence cell RX2000	1,00	23 450,00	23 450,00	4 924,50	28 374,50
	Umbilical cord	1,00	33 050,00	33 050,00	6 940,50	39 990,50

Číslo žádanky: 17153913

Rekapitulace		Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba	21%	69 380,00	14 569,80	0,00	83 949,80
<b>Celkem</b>		<b>69 380,00</b>	<b>14 569,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83 949,80</b>

**Celkem k úhradě Kč 83 949,80**

CHROMSPEC spol. s r.o. - Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5418

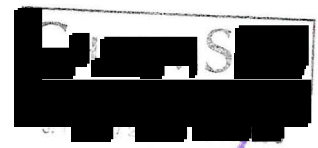

Zákazník	HOCHB UMG	Kód	PM 16	Přístroj		Výrobní číslo	
Adresa	FLEMINGOVA PAM. 2 PRAHA 6			RX 2000		RX 45089	
Oddělení	31		PSČ				
Pracovník	[REDACTED]			Kupní smlouva		Datum instalace	
Telefon			Fax			E-mail	
Objednávka				Stav	<input type="checkbox"/> Vyřízeno	<input type="checkbox"/> Rozpracováno	


<p>Příznaky závady</p> <p>CHYBNÁ FUNKCE ZARÍZENÍ</p>	<p>Činnost technika</p> <p>IDENTIFIKACE ZÁVADY - VZOREK SE DOSTAVA DO OKRUHU CHLAZENÍ          VYČISTĚNÍ ZARÍZENÍ, KONTROLA TĚSNĚNÍ, TEST TĚSNOSTI OKRUHU VZORKU - VADY UMBILICAL CORD          VYMĚNA VADNĚHO DÍLU, VYMĚNA VESKÉRYCH TĚSNĚNÍ          TEST SPRÁVNÉ FUNKCE MĚŘICÍHO OKRUHU          TEST SPRÁVNÉ FUNKCE OBVODU CHLAZENÍ          ODDOZ ZARÍZENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ          INSTALACE A TEST SPRÁVNÉ FUNKCE ZARÍZENÍ U ZÁKAZNÍKA</p>
--	---

Zbývá dokončit / dodat

Použitý materiál - objednáč. číslo	Popis	jedn.	Kč./jedm.	Celkem
	FLUORESCENCE CELL RX 2000	1	23.450,-	23.450,-
	UMBILICAL CORD	1	33.050,-	33.050,-

Datum	Od	Do	Technik	Práce	Cesta	km	Vyúčtování
20.7.2017			29	4			Čas technika 9 1.320,- 11.880,-
2.8.2017			29	4			Ostatní výdaje CESTOVNÉ 1.000,-
3.8.2017			29	1	1.5		Materiál
A B C G H I M (N) P W 9							Celkem (bez DPH) 69.380,-

Poznámka



**Martin Petrak**

---

**Od:**

**Odesláno:**

**Komu:**

**Předmět:**

Dobrý den,

objednáváme u vás opravu Stop-Flow zařízení RX 2000. Na faktuře prosím uvádějte "Číslo žádanky 17153913".

Děkuji za spolupráci,

Jiří Brynda