

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SLS-2025-0015-0612

VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:



DATUM: 22. 5. 2025

NUVIA a.s.
Modřínová 1094
Třebíč
674 01

OBJEDNÁVKA - na základě smlouvy SLS-2024-0001-0612 ze dne 24. 1. 2024

číslo objednatele: SLS-2025-0015-0612

Český metrologický institut, IČ: 00177016, (dále také „ČMI“) - jako navrhovatel smlouvy a objednatel - tímto předkládá společnosti NUVIA a.s. (IČ: 25506331) – jako dodavateli – návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou:

Úpravy SW Zakázky 2

podle §1731 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž konkrétní obsahová stránka smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi nebo o díle v závislosti na charakteru níže uvedeného předmětu plnění.

V případě, že charakter předmětu plnění neodpovídá ani koupi ani dílu, pak se v souladu s § 1746/2 obč. zákoníku řídí obsahová stránka smlouvy všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se závazkových vztahů.

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění jsou následující úpravy SW Zakázky 2 avizované v systému Helpdesk:

ID záznamu	Název záznamu (požadavku)	
SCMIZ-121	Vyhledávání MP	
SCMIZ-122	Poslední kalibrace měřidla	
SCMIZ-131	Příjem/výdej měřidel	
SCMIZ-132	Kopírovat z v zakázce	
SCMIZ-133	Číselné řady propojit s typem výst. dok.	
SCMIZ-134	Úprava plnění dat do excelu	
SCMIZ-135	Vkládání příloh v realizaci	
SCMIZ-136	Úprava funkce NAHRADIT	
	Celkem:	

Detailní popis specifikace je uveden v dokumentu Požadavky na rozvoj SW Zakázky 2 k 28.3.2025, který je přílohou č. 1 této objednávky.

K uzavření smlouvy za ČMI je oprávněn: Ondřej Kebrle, odborný ředitel pro ekonomiku

Lhůta stanovená pro přijetí návrhu: písemně **do 1 měsíce** od data vystavení, jinak návrh pozbývá platnosti

Lhůta plnění – termín dodání: nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Předmět plnění dodejte na adresu (místo plnění): instalace na servery ČMI

Cena:

Předpokládaná cena:  **109 200 Kč bez DPH**

Cena v Kč bez DPH je sjednaná jako předpokládaná. Pro účely fakturace Ad-hoc služeb se podle servisní smlouvy započítává každá dokončená hodina práce pracovníka Poskytovatele příslušné kategorie činností, resp. role. DPH bude připočítána v zákonné výši platné k datu zdanitelného plnění.

Způsob platby:

Převodním příkazem ve lhůtě 30 dnů po obdržení faktury, kterou lze vystavit po dodání a převzetí plnění.

Fakturu (daňový doklad) zaslat na adresu:

Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00, Brno nebo na email:

Požadovaný obsah daňového dokladu:

Údaje na faktuře budou odpovídat ustanovení § 435 obč. zákoníku a § 7 zákona o obchodních korporacích v platném znění, jakož i přísl. úst. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, který stanoví povinný obsah daňového dokladu, pokud smluvní strana jako plátce DPH je povinna a oprávněna daňový doklad vystavit.

Smluvní pokuta:

V případě porušení smluvní povinnosti ze strany dodavatele (např. nedodržení termínu dodání) má odběratel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny sjednaného plnění za každý den porušení smluvní povinnosti (za každý den prodlení). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Úroky z prodlení:

Při včasné neuhrazení faktury objednatelem má dodavatel právo účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

Předání a převzetí předmětu plnění:

předávací protokol po nasazení do produkční instance

Odpovědnost za vady:

Dodavatel odpovídá za právní i faktické vady (zjevné i skryté) podle příslušného ustanovení občanského zákoníku.

Záruky za jakost:

Dodavatel ručí za sjednanou jakost realizovaného předmětu plnění (zboží, dílo) po dobu **24 měsíců**.

Poučení o zpracování osobních údajů:

Český metrologický institut tímto informuje, že jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou uvedeny v Zásadách na webové stránce <https://www.cmi.cz/gdpr>.

Závěrečná ustanovení:

K platnému uzavření smlouvy dojde bezvýhradnou písemnou akceptací návrhu smlouvy dodavatelem (viz níže) a jejím doručením navrhovatel. V případě akceptace návrhu smlouvy s připomínkami ze strany dodavatele vznikne smlouva až po následném písemném odsouhlasení (akceptaci) těchto připomínek ze strany objednatele. Bez následného schválení případných připomínek k návrhu smlouvy smlouva nevznikne.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy (potvrzené objednávky) v Registru smluv ČR kromě uveřejnění dílčích cen.



Ondřej Kebrle
odborný ředitel pro ekonomiku

Jedno potvrzené vyhotovení našeho návrhu smlouvy-obdobnávky s vašim vyjádřením zašlete laskavě zpět na adresu zadavatele nebo na email: 

Vyjádření příjemce návrhu smlouvy (dodavatele):

Návrh smlouvy akceptujeme bez výhrad^{*)} / s následujícími připomínkami^{*)}



^{*)} nehodící se škrtněte

.....
Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele


Požadavky na rozvoj SW Zakázky 2 k 28.3.2025




SCMIZ-121 Vyhledávání MP

Prosím o úpravu položky  ve filtru v přehledu zakázek.

Přidejte sem prosím podmínku, že když je





tak se má prohledávat



a ne




Příklad z produkční verze (na testu to bude předpokládám stejné): zakázka 1011-PM-C0006-19 se má správně nabídnout pro 111-MP-C001 nebo 111-MP-C005 (ale pro 611-MP-C030 nebo 131-MP-C005 se nabízet nemá).



SCMIZ-122 Poslední kalibrace měřidla


Prosím o opravu položky "Poslední kalibrace" (= "Realizace poslední" v přehledu měřidel).

Položka je v detailu měřidla po zatržení "Zobrazit přílohy KL":

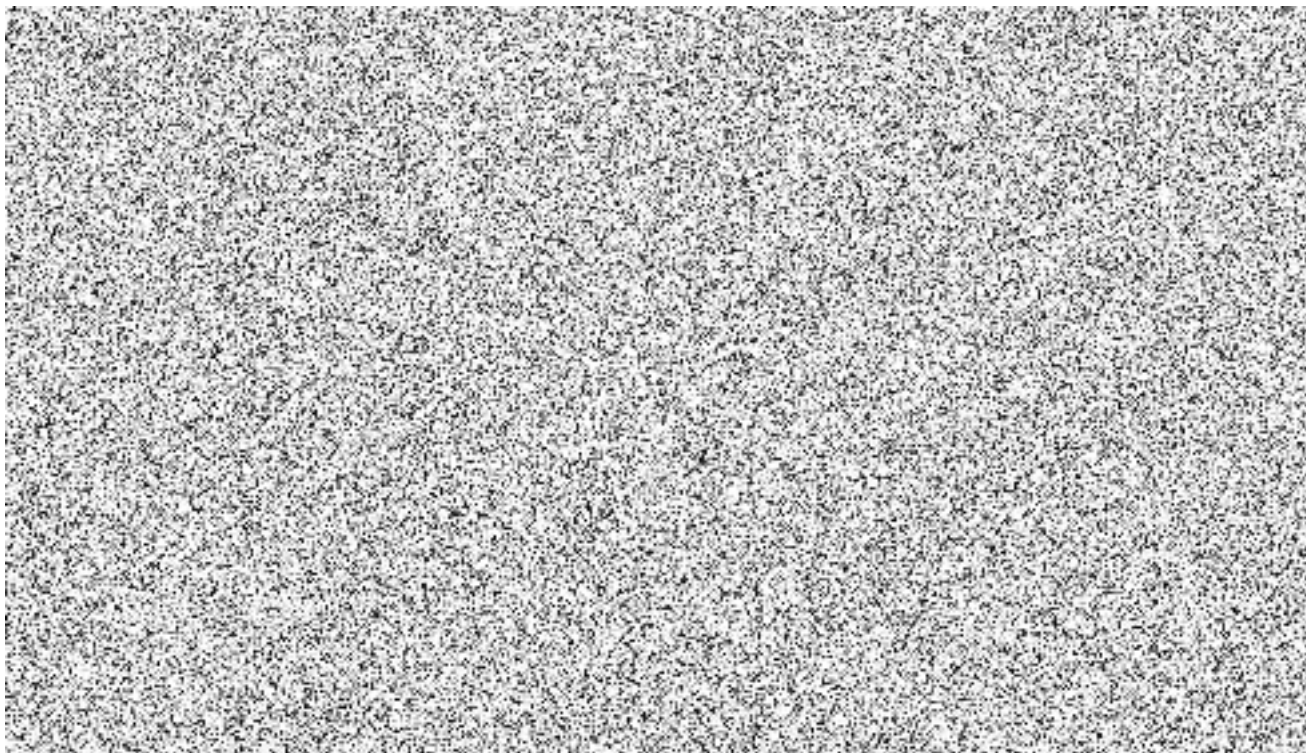

Správně by tato položka neměla být editovatelná a měla by se nastavit automaticky na poslední "Datum souboru" nebo na poslední datum "Realizace do", podle toho, které je větší (poslední).

Tj. potřeba je kromě zablokování editace, opravit funkčnost tlačítka

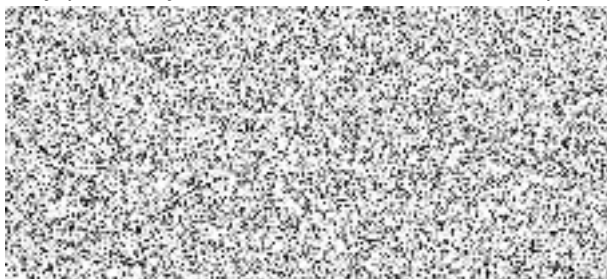


kde se zadá číslo KL, datum (buď ručně nebo z data souboru), příloha a na konci by se mělo uložit datum poslední kalibrace dle tohoto popisu.

V případě smazání takto ručně zadaného KL je potřeba toto datum aktualizovat.



SCMIZ-131 Příjem/výdej měřidel

Do Zakázky pro laboratorní výkon (kromě činnosti V - Výroba RM/SE) doplňte novou položku "Stejně osoby na výdej" s možností Ano / Ne:

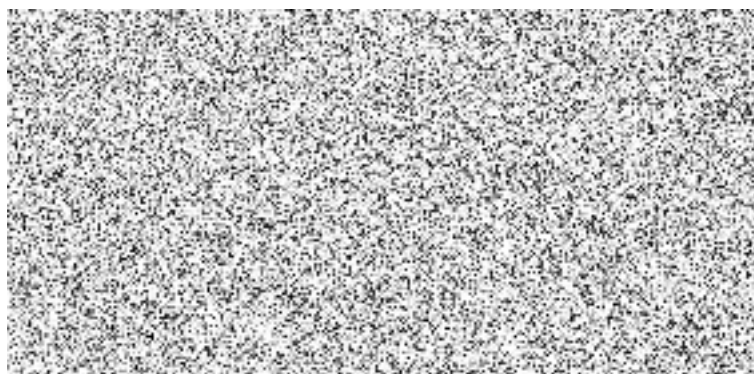

Předvoleno bude Ne. Dále vzniknou dvě nové záložky ZAKAZKA_VYDAL a ZAKAZKA_VYZVEDL. Při Ne budou prázdné a při Ano:


ZAKAZKA_VYDAL = (= ZAKAZKA_PRIJAL)

ZAKAZKA_VYZVEDL = (= ZAKAZKA_ZASILKA)

Nové záložky ZAKAZKA_VYDAL a ZAKAZKA_VYZVEDL se v aplikaci nikde nebudou zobrazovat, pouze se budou používat při generování/plnění dokumentu.



SCMIZ-132 Kopírovat z v zakázce



Prosím o vylepšení funkce Kopírovat z v zakázce.

Pokud se kopírují data ze zakázky, kde je **Způsob vyplnění PM/OM** **Samostatné parametry - 2 a více měřidel**, neprovádět kopírování z **Specifikace výkonu**, ale kopírovat z **Specifikace výkonu** pro dané měřidlo.

Úplně si nejsem jistý, jaká pravidla jsme zde vytvořili, ale pokud je v zakázce jedno měřidlo, mají se kopírovaná data uložit do modré specifikace výkonu (i kdyby se kopírovala ze zelené). Pokud je v zakázce více měřidel, záleží na předchozí zakázce. U společných parametrů kopírovat opět do společných parametrů modré zakázky a u samostatných parametrů kopírovat do samostatných parametrů zelené specifikace.

Nejlepší ale bude ještě to prokonzultovat před zapracováním, protože si nevzpomínám na pravidla pro nabízení zakázek pro kopírování. Možná by byl nejlepší nějaký rozcestník - buď výběr ze zakázek (jako je to nyní) nebo automaticky předchozí zakázka pro každé měřidlo zvlášť (zde by při různých zakázkách bylo vždy samostatné parametry a naplnění zelené specifikace výkonu).



Dobrý den,

tady je to trochu složitější. Modrá část jsou data uložená u zakázky. Zelená část jsou data uložená u realizace. Výběr předchozí realizace podle měřidla se myslím nabízí při kopírování dat v realizaci.


Vám tedy jde aby se překopírovaly data ze zakázky (modrá vůči modré) a následně ještě data u jejich všech podřízených (vytvořených) realizací (zelené vůči zelené)?

Pokud ano, má se to udělat podle zdrojové zakázky pokud vybraná zdrojová Zakázka měla nějaká stejná měřidla jako Zakázka do které kopírujeme, nebo postupně pro každou realizaci nabídnou samostatné okno se seznamem předchozích realizací podle které chceme tuto specifickou realizaci kopírovat?



Toto je komplikovanější a sám nevím jaké by bylo nejlepší řešení. Vzniklo to na základě připomínky kolegy, kdy se mu při kopírování data nekopírovala, protože si vybral měřidlo, u kterého byl předchozí příjem samostatných parametrů, tj. bylo to v zelené specifikaci výkonu.

Jedná se zde hlavně o tvorbu záznamu o převzetí v Zakázce, kde ve většině případů vyplňujeme modrou specifikaci, ale u samostatných parametrů je to zelená specifikace, která sice patří do realizace, ale vyplňujeme to v zakázce. Nejedná se tedy vyloženě o to, aby modrá specifikace = modrá + zelená specifikace = zelená, ale záleží hlavně na "Způsobu vyplnění PM/OM", na jehož základě se rozvírá a skrývá modrá resp. zelená specifikace výkonu.

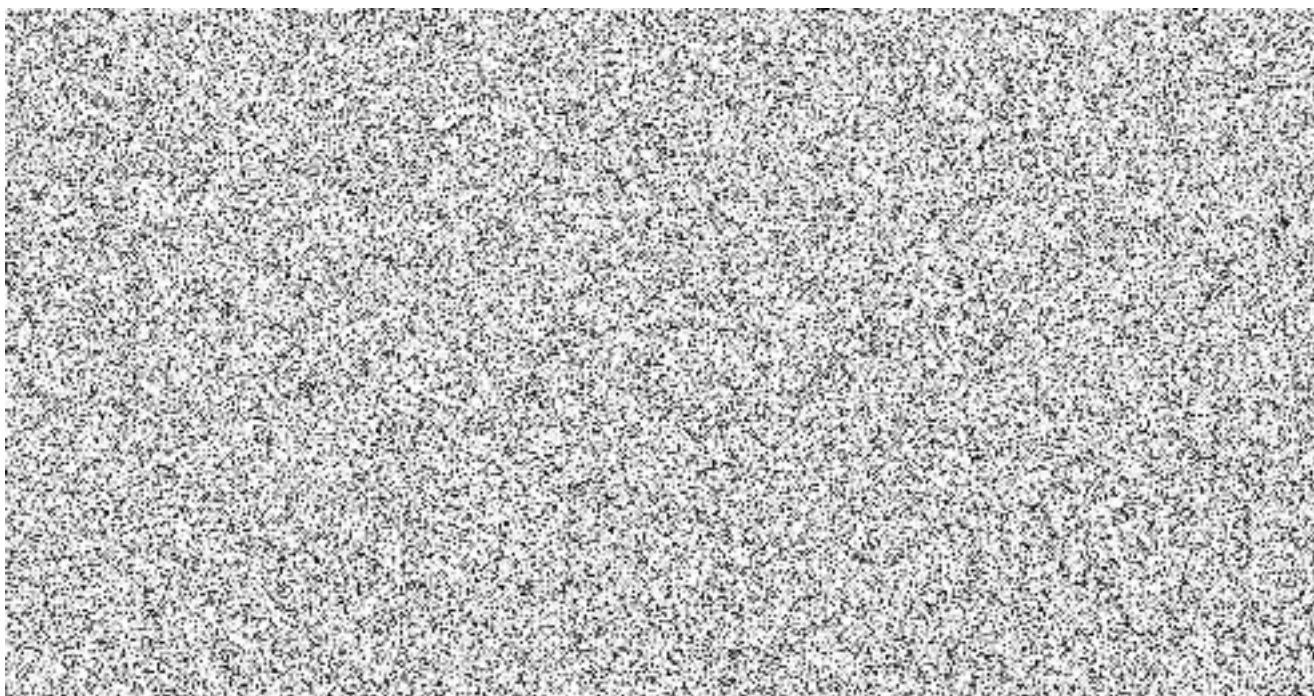

Návrh nové funkčnosti. Nová zakázka:

- Bez měřidel - současný stav, tj. nabídka zakázek shodné firmy a kopie modré specifikace do modré.
- 1 měřidlo - trošku vylepšit současný stav, tj. po výběru zakázky do modré specifikace zkopírovat data s touto podmínkou: starší zakázka je typu "samostatné parametry", tak kopírovat zelenou specifikaci, v ostatních případech modrou.
- Více měřidel (zde může být komplikace v tom, že se může jednat o různé zakázky, tj. že všechna měřidla nebyla naposled v jedné společné zakázce). Zde by bylo nejlepší do okna "Výběr zakázek podle měřidel" přidat tlačítko "Podle měřidel" (s nápovědnou bublinkou "Kopie dat z předchozích zakázek vztahujících se k jednotlivým měřidlům.") s touto funkcí:
 - kopírovat se budou data vždy z přechází zakázky (realizace) daného měřidla nezávisle na výběru ze zakázek
 - pokud bude některé měřidlo nové, vyskočí upozornění, že u tohoto měřidla bude nutné data doplnit ručně
 - pokud budou všechna měřidla ze stejné předchozí zakázky a předchozí zakázka bude typu "samostatné parametry", tak kopírovat zelené specifikace do zelených a novou zakázku přepnout také na "samostatné parametry"
 - pokud budou všechna měřidla ze stejné předchozí zakázky a předchozí zakázka nebude typu "samostatné parametry", tak kopírovat modrou specifikaci do modré a novou zakázku přepnout na "společné parametry" (dle počtu měřidel)
 - pokud budou měřidla z různých předchozích zakázek, tak se nová zakázka přepne na "samostatné parametry", kopírovat se bude do zelené specifikace a zdrojová data budou u "samostatných parametrů" v zelené specifikaci, jinak v modré specifikaci.

Uf, to mi dalo 😊 Snad jsem popsal všechny možnosti, když tak to můžeme ještě prodiskutovat.

PS: ještě jsem si všiml, že po najetí myši na tlačítko "Kopírovat z" jsou prohozené nápovědné texty, tj. v zakázce je text z realizace a naopak.



SCMIZ-133 Číselné řady propojit s typem výst. dok.

Do formátu číselné řady pro realizace (**Oblast**) doplnit výběrovou položku . Pokud bude ve formátu číselné řady vyplněna i činnost, budou se nabízet jen typy pro danou činnost, jinak všechny typy.

Při použití generátoru v realizaci se pak automaticky nastaví i "Typ výstupního dokumentu" z formátu použité číselné řady do výsledku realizace. Pokud daný typ nebude v souladu s nastavenou činností v realizaci, vyskočí nějaká hláška a nastavení se neprovede.



SCMIZ-134 Úprava plnění dat do excelu



Zkouším tahat údaje ze Zakázek (ver. 1 i 2) do sešitů v Excelu přes „Přidat přílohu“. U prázdného sešitu mi to funguje dobře (operace trvá do 7 s); u našich šablon se skutečnými výpočty trvá naplnění \$záložek\$ hodnotami 1,5 až 2 minuty, podle počítače. Zkoušel jsem, co na to může mít vliv. Pomohlo až přepnutí automatických přepočtů vzorců na ruční u šablony před jejím načtením do Zakázek. Pak jsem se dostal na ještě přijatelných 16 až 25 sekund.

Neznáš na to nějakou fintu, případně neuvažovali jste s tvůrci sw Zakázky, že by se před plněním záložek přepnul přepočet vytvářeného sešitu na ruční a po dokončení plnění se přepočet vrátil na původní hodnotu (obvykle automatický přepočet)?




Díval jsem se do rozhraní Excelu a vypadá to, že excel umožňuje přepínat tu kalkulaci programově. Takže by to asi mohlo jít. Pak je ale otázka, jak přesně byste to chtěli. Mohl bych to dělat vždy. Před plněním nastavit výpočty na manuální a po naplnění to vrátit na původní hodnotu a udělat kompletní přepočítání, nebo toto dělat pouze když uživatel chce (přidat tam nějaké nové zaškrtnutí) nebo ještě jinak.



Nejlepší by bylo dělat to pouze když uživatel chce (přidat tam nějaké nové zaškrtnutí).



Dobrý den, doplnění vypínání a zapínání výpočtu a přidání nového tlačítka na výběrové okno při vkládání dokumentu z (Asi bych to přidal sem jako další zaškrtnutí)

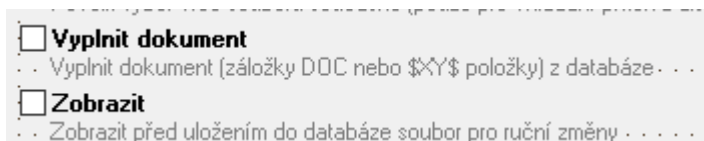

včetně testování mi zabere cca 4-8h. Podle toho jestli to bude stačit pouze to nastavit, nebo se během realizace ukáže že excel možná potřebuje ještě něco dalšího.



SCMIZ-135 Vkládání příloh v realizaci


1. Při vkládání dokumentu nebo přílohy  v realizaci metodou soubor z disku



dejte prosím na konec vkládání dotaz "Přejete si právě vložený soubor označit jako podepsaný dokument viditelný na webu?" s možností ANO / NE. Při ANO se přidá příznak podepsaného KL. Pokud dokážete rozpoznat jeden soubor / více souborů, mohl by být dotaz u více souborů v množném čísle.


To stejné by mohlo být na konci funkce Drag & Drop.

2. Šlo by u funkce Drag & Drop udělat to, že když pustím myš s přetahovaným souborem na těchto tlačítkách  , doplní se automaticky daný příznak? Výše uvedená nová hláška by zde už nevyskakovala a u výstupního listu by se kontrolovalo jestli tam už není - obdoba této hlášky

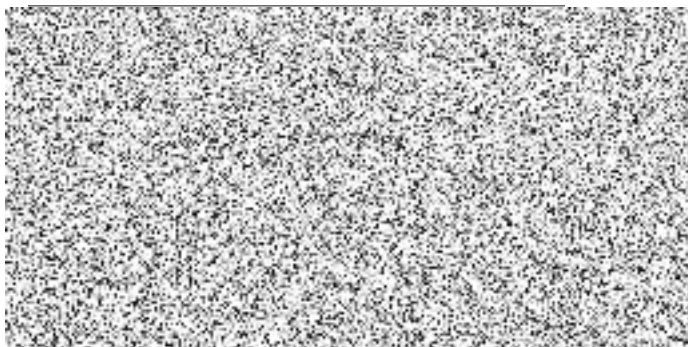

SCMIZ-136 Úprava funkce NAHRADIT

Prosím o úpravu funkce NAHRADIT u atributu měřidla:

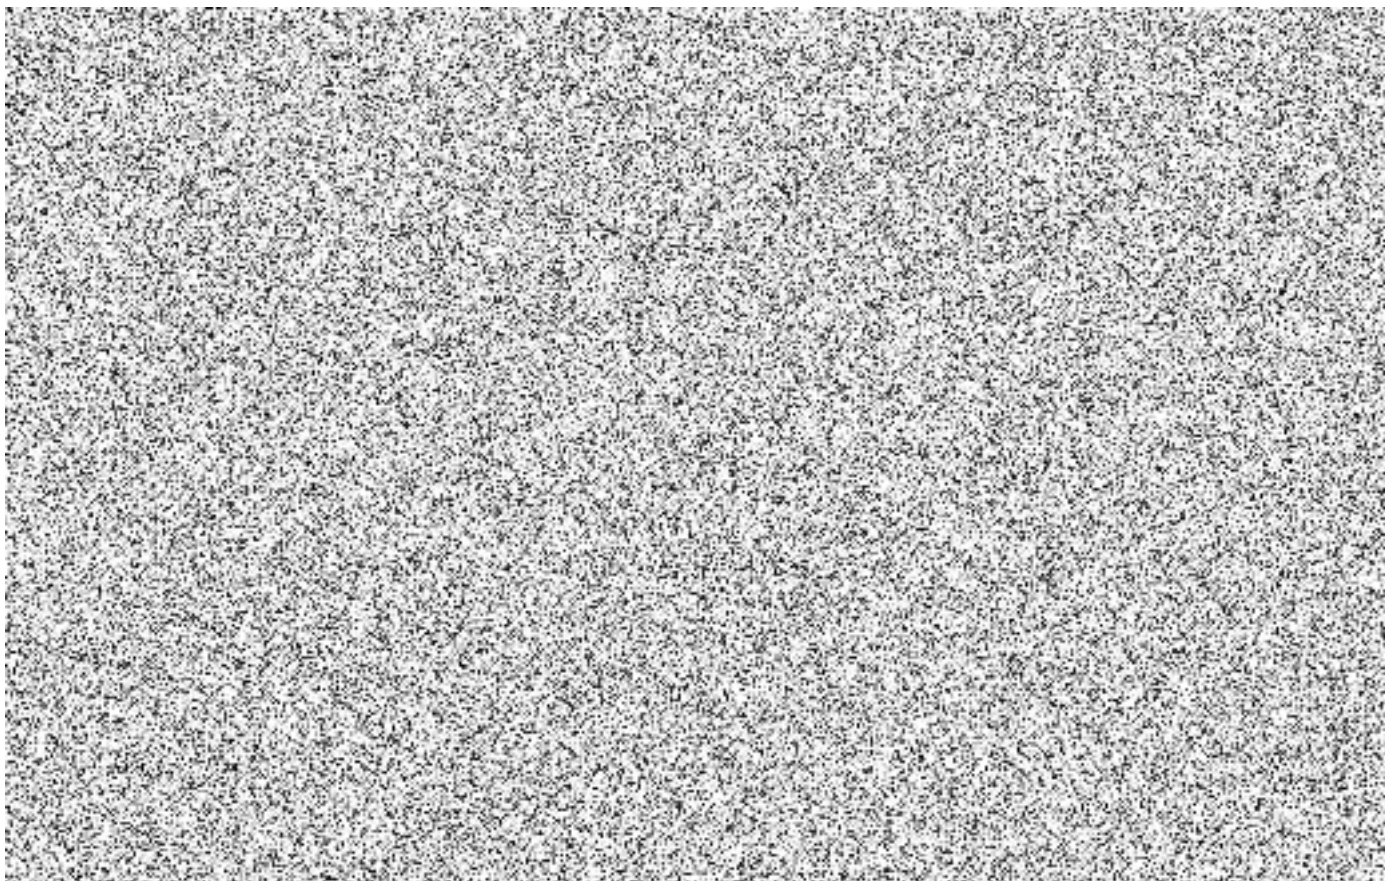

Pokud dojde k duplicitě, bylo by potřeba automaticky sloučit i duplicitní měřidla a u etalonů by se k v.č. měla doplnit na konec tečka, aby bylo možné funkci NAHRADIT dokončit.

