

Evidenční číslo		
PR/ 67	2018	0001
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ K [REDACTED]

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Servisní smlouva

pro pozáruční servis - vč. náhradních dílů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících o smlouvě o dílo zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

CHEIRÓN a.s..

se sídlem: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Jindřichem Petříkem, MBA, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 8964

IČO: 27094987
DIČ: CZ27094987
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 43410/2017 ze dne 13.4.2017 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele k jednání o plnění smlouvy, objednávek jednotlivých plnění a jejich převzetí: Oddělení biomedicínského inženýrství-BMI, nikol.malinova@mnof.cz, +420 59 619 3692, 4490

dále jen **objednatel**

I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání závazků smluvních stran k zajištění servisu (provedení servisních činností) zdravotnického prostředku nebo laboratorního přístroje, (zpravidla přístroje - dále jen prostředku nebo ZP) ve vlastnictví objednatele, v rozsahu dle požadavků objednatele a

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	ov [redacted]

zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon a v souladu s právními předpisy s ním souvisejícími – zákon č. 263/2016 Sb., zákon 505/1990 Sb., norma ČSN 33 1600 ed.2, vyhl.. MZ 306/2012 Sb.

2. Servisními činnostmi se rozumí provádění bezpečnostně technických kontrol, oprav, elektrických revizí pevně připojených ZP, kalibrací, validací, metrologického ověřování, zkoušek předepsaných atomovým zákonem*, údržby jakož i provedení jiných činností sloužících k naplnění sjednaného účelu smlouvy v souladu s pokyny výrobce daného ZP, platnými normami a legislativou ČR.
3. Účelem smlouvy je zajistit provozuschopnost zdravotnických prostředků nebo laboratorní techniky včetně naplnění všech legislativních požadavků na provedení servisních služeb (např. vytvoření a vedení záznamu o provedených servisních zásazích, opravách, protokoly o BTK dle zákona apod.), prostřednictvím servisní činnosti zhotovitele, který je zavázán provádět servisní činnosti v požadovaných lhůtách, řádně a za touto smlouvou sjednaných podmínek v souladu s právními předpisy.
4. Předmětem smlouvy je provádění servisu, prostředku/ZP nebo skupiny uvedené v příloze servisní smlouvy: 1 ks ultrazvukového přístroje pro centrální příjem s emergency
Název/typ: Ultrazvuk TE7 se třemi konektory pro sondy (převodníky) a příslušenství
výrobní model: reg. číslo PU-212B-CTO-S01 TE7
počet kusů: 1 ks
výrobce: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
5. užívaného na pracovišti objednatele: pro centrální příjem s emergency
za podmínek dále smlouvou podrobně určených.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní činnosti na vyžádání objednatele, dle vystavených objednávek na provádění BTK, revizí a oprav, které vystavuje zástupce objednatele.
7. Oprávněným zástupcem objednatele k odeslání objednávek jednotlivých plnění a jejich převzetí, jednotlivých servisních prací a potvrzení dodacího listu je pracovník oddělení BMI nebo jím pověřený zástupce, resp. pověřený zaměstnanec klinického oddělení zodpovědný za daný přístroj.
8. Objednávky budou provedeny písemnou listinnou formou do sídla zhotovitele, nebo písemnou elektronickou cestou s doručením na kontaktní adresu zhotovitele:
Jméno příjmení: CHEIRÓN a.s.
Adresa/e-mail: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň/servis@cheiron.eu
9. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit přijetí objednávky.
10. V havarijních případech lze objednávku provést telefonicky, písemné potvrzení se provede bez zbytečného odkladu následně.
11. Předpokládaná cena provedení servisní činnosti bude uvedena v potvrzení objednávky, při navýšení těchto nákladů musí být objednavatel upozorněn a navýšení nákladů odsouhlasit.
12. Náhradní díly, pomocný materiál a případně kompletní výrobky, které bude nutno vyměnit, budou fakturovány dle skutečné spotřeby po odsouhlasení s objednatelem.
13. Po ukončení servisních činností pověřená osoba objednatele převezme provedené dílo, zkontroluje jeho správnou funkci a zhotoviteli potvrdí servisní výkaz nebo jiný záznam o provedené činnosti, který zhotovitel zašle společně s daňovým dokladem -fakturou objednateli.
14. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení sjednaných servisních činností bez vad a nedodělků, cenu podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen zajistit provádění servisních činností prostřednictvím kvalifikovaných osob splňujících požadavky na odbornou praxi i způsobilost dle zákona.

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ [redacted]

16. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění servisních činností což dokládá ke smlouvě přípojenými dokumenty, které jsou v kopii nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 1.
17. Zhotovitel provádí servisní činnosti na svůj náklad a odpovědnost. Způsob provedení servisních činností stanoví zhotovitel tak, aby byly splněny požadavky stanovené smlouvou popř. individuálním zadáním. Věci potřebné k provedení servisní činnosti je povinen opatřit zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. shodné s cenou zdravotnického prostředku, kterou na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

II. Rozsah servisních činností zhotovitele

BTK:

1. Součástí je provedení bezpečnostně technických kontrol - (BTK) v předepsaných intervalech dle zákona, v souladu s pokyny výrobce včetně všech pravidelně měnících se komponent při této údržbě („servisní kit“).
2. Součástí je provedení dalších činností k zajištění zachování bezpečnosti a plné funkčnosti ZP. Provedení oprav zdravotnického prostředku na základě poruchy nebo závady zjištěné při BTK.
3. BTK je realizace pravidelných úkonů, které provádí zhotovitel tak, aby zajistil požadavky objednatele na zajištění provozu ZP na základě vystavených objednávek pověřenými zaměstnanci objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dodá pro provedení údržby ZP náhradní díly nezbytně nutné a garantuje, že všechny použité náhradní díly, spotřební materiál a další komponenty a náplně použité při servisní činnosti budou nové a nepoužité, budou odpovídat standardům a požadavkům výrobce pro daný zdravotnický přístroj, provedení a kvalita bude odpovídat předpisům a normám platným v ČR.
5. Dodání veškerých servisních protokolů, vedení a předání dokumentace o provedených úkonech pověřenému pracovníkovi oddělení BMI.

Opravy:

1. Zhotovitel zajistí na vyžádání objednatele (objednávky) odstranění všech poruch a provedení oprav ZP, včetně dodání a vmontování k tomu potřebných náhradních dílů (ND) na základě poruchy nebo závady nahlášené objednavatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel dále zajistí:
 - provedení odborných činností a úkonů k odstranění všech poruch, pro zajištění (garanci) předepsaného provozního stavu, zachování technických a výkonových parametrů pro užívání ZP k jeho účelu.
 - vedení předepsané dokumentace o provedených opravách a její předání objednateli, písemné potvrzení rozsahu provedených výkonů.
3. Doba reakce na hlášení opravy v pracovní dny max. 24 hodin. Doba nástupu na opravu max. do 48 hodin od nahlášení.
4. Doba odstranění poruchy bez použití ND, max. do 72 hodin.
5. Doba odstranění poruchy s použitím ND, max. 10 dní od zahájení.
6. Doba pro provedení servisních činností v pracovní dny: 08:00-17:00 hodin. Veškeré práce spojené s odstraněním poruch požaduje objednatel provést v rozsahu základní/standardní pracovní doby. Opravy mimo pracovní dny lze dohodnout na základě písemného požadavku objednatele.

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	o [REDACTED]

7. V případě opravy trvající déle než 4 dny zhotovitel zapůjčí objednateli náhradní přístroj do doby provedení opravy přístroje. Zapůjčený přístroj musí být vybaven minimálně parametry a funkcemi opravovaného přístroje.

Další požadavky na servisní plnění:

1. Součástí předmětu plnění je doprava technika provádějícího servisní činnosti (opravy či odbornou údržbu ZP) do místa plnění včetně času stráveného na cestě. Místem plnění je sídlo objednatele.

III. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli pro plnění servisních úkonů přístup k prostředku pro plnění zhotovitele. V pracovních dnech se sjednává čas v běžné pracovní době: 07:00-17:00 h, v termínech dohodnutých k provedení servisních činností (dle vystavovaných objednávek nejpozději k datu předcházející BTK v periodách určených výrobcem), nebo oprav ZP.
2. Opravy ve dnech pracovního klidu, svátcích budou prováděny dle výslovné dohody smluvních stran.

IV. Doba a místo plnění

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – na dobu, po kterou objednavatel bude požadovat provádět servisní činnosti na ZP.
2. Výkon servisních činností bude započat po skončení záruční doby dle Kupní smlouvy. BTK bude prováděna jako pravidelná činnost v intervalu předepsaném výrobcem s přihlédnutím ke stavu ZP.
3. Termín následné BTK vyznačí servisní technik do záznamu o provedené kontrole (servisní výkaz, protokol o BTK nebo vyúčtování) a na přístroj nalepí štítek s datem následující kontroly, pokud to provedení zdravotnického nebo laboratorního přístroje umožňuje. Po ukončení servisního úkonu technik informuje zdravotnický personál zodpovídající za přístroj o jeho aktuálním stavu.
4. Místem plnění je sídlo objednatele, pracoviště, na kterých jsou ZP umístěny a používány.
5. Smlouvu je možno ukončit dohodou, nebo písemnou výpovědí a to bez uvedení důvodu s tím, že v tomto případě musí být písemná výpověď doručena prokazatelně s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
6. Objednatel může smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jestliže předmět prováděného díla (zařízení v servisu) dle smlouvy je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění.
7. Odstoupit od smlouvy je možno v případě podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany.

V. Cena díla a platební podmínky

1. V ceně servisních činností jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s jejich provedením, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cena za provedení servisních činností je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijetí nabídky zhotovitele. Ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností, jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí Servisní smlouvy.
3. Ceny jsou zhotovitelem garantovány min. po dobu 4 let od konce záruční doby.
4. Ceny činností a jednotlivých úkonů uvedené v Příloze č. 2 jsou pevné a mohou být změněny v důsledku změny úrovně spotřebitelských cen (dále jen „ÚSC“) - Ceny lze změnit v důsledku změny ÚSC zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ [redacted]

- ceny uvedené v Příloze č. 2 jsou závazné/pevné a nebudou měněny po dobu prvních 72 měsíců účinnosti smlouvy;
 - v každém následujícím roce trvání smlouvy může být cena upravena v závislosti na hodnotě ÚSC zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok a to tehdy, pokud se ÚSC zvýší o více jak 2 % výši ÚSC v předchozím kalendářním roce. Úpravy ceny (jednotkových cen) mohou být provedeny tak, že se ceny zvýší nebo sníží maximálně o stejné %, o které se změní ÚSC oproti ÚSC v předchozím kalendářním roce;
 - úpravy ceny (jednotkových cen) mohou být provedeny v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynulo prvních 72 měsíců trvání smlouvy (v 6. roce trvání smlouvy) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání smlouvy);
 - o úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok;
 - neučiní-li tak, cena (jednotkové ceny) zůstane v platnosti po dalších 12 měsíců platnosti smlouvy;
 - k úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě;
 - pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny ceny k datu, kdy uplynulo prvních 72 měsíců trvání smlouvy (v 6. roce trvání smlouvy) a vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání smlouvy). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování nebo vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena (jednotkové ceny);
 - zhotovitel souhlasí s těmito možnostmi a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění případně celého předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý zisk z toho plynoucí.
5. Ceny mohou být změněny rovněž v závislosti na změně daňových předpisů, eventuálně jiných případných poplatků státu. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Změna celkové ceny je možná v případě, že při realizaci servisních činností bude nutno provést dodávku náhradních dílů a součástek či jiného spotřebního materiálu k dosažení bezporuchového provozu zdravotnického přístroje. V takovém případě bude před započítáním opravy provedeno odsouhlasení cen objednatelem.
7. Zvlášť účtovaná plnění jsou definována jako požadavky na náhradu za promeškaný čas zaviněný zákazníkem, při odstranění poruch, které byly zaviněny nevěcnou manipulací, úmyslem, či nedbalostí, zásahy třetích osob, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací a činností především při jejich předání. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného předání a převzetí díla. Platba bude provedena na základě faktury se splatností 30 dní, přílohou faktury vždy bude potvrzený servisní výkaz.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která musí mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obsahovat:
- a) označení faktury a její číslo,
 - b) označení obchodní firmy, místo podnikání-sídlo, přesný údaj zhotovitele o jeho zápisu v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující k podnikání,
 - c) identifikační číslo /IČ/ a DIČ zhotovitele,
 - d) bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, na který má být placeno,
 - e) označení objednatele/nemocnice: název, sídlo, IČ a DIČ,
 - f) přesné označení provedené činnosti, množství, cenu a fakturovanou částku,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ [redacted]

- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) splatnost ve lhůtě 30dnů od doručení faktury.
9. Objednatel vyžaduje, aby zhotovitel uvedl na daňovém dokladu přesné označení smlouvy, na základě které bylo poskytnuto plnění. Přílohou daňového dokladu musí být doklad o provedené činnosti.
10. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit k provedení opravy, a to do data splatnosti:
- obsahuje-li nesprávné cenové údaje
 - obsahuje-li nesprávné náležitosti
 - chybí-li k faktuře některé z náležitostí nebo dohodnuté přílohy
11. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Po odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
13. Strany se dohodly, že platba bude prováděna bezhotovostním platebním stykem na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Odpovědnost za správnost údaje o účtu zhotovitele na daňovém dokladu nese zhotovitel. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
14. V případě prodlení se zaplacením ceny díla podle předchozích odstavců může zhotovitel požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši, která se stanoví výpočtem úroků dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, podle občanského zákoníku.

VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, kvalitu a úplnost provedených prací sjednaných touto smlouvou. Jakost jím prováděného díla bude odpovídat platné právní úpravě. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
2. Zhotovitel je zavázán zajistit řádné plnění smlouvy tak, aby zařízení splňovalo požadavky na bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.
3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla objednateli. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad. Vady zjištěné na provedeném díle, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, ihned po jejich zjištění, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu, nebo v dohodnutém termínu. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce min 6 měsíců po ukončení servisních činností, vyhotovení servisního výkazu nebo jiného záznamu o provedené práci. Záruční doba na dodané náhradní díly je 24 měsíců od provedení servisní opravy nebo dle uvedení výrobce náhradního dílu.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že prostředek bude po tuto dobu plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, předpisů, které má daný prostředek splňovat, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím.

VII. Sankční ujednání

1. Objednatel stanovil ve smlouvě sankce za nedodržení výše uvedených termínů pro provedení odborné údržby, oprav a revizí je sjednána ve výši 1 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ [redacted]

2. V případě, že dojde ke škodě jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy je škodu, která vznikla, povinen zhotovitel nahradit v plné výši.
3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

VIII. Ustanovení společná a závěrečná

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.
2. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Uzavření této Smlouvy o dílo je výsledkem zadávacího řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Platnost nabývá po podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech číslovaných výtiscích s platností originálů, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Sídlo servisního střediska zhotovitele: CHEIRÓN a.s.
kontaktní adresa: servis@cheiron.eu
zástupci zhotovitele se, kterými je možné konzultovat požadavky a problémy: [redacted]
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. bod. 15, této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit.
12. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že žádná ze Smluvních stran se necítí být slabší či znevýhodněnou Smluvní stranou oproti Smluvní straně druhé.

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ [redacted]

13. Změny a doplnění, včetně příloh této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1. Doklady o odborné způsobilosti k provádění servisních činností.

Příloha č. 2. Ceník výkonů

Příloha č. 3. případně Seznam/skupiny prostředků na které se smlouva vztahuje.

Za zhotovitele

V Praze dne19.-01-2018

CHEIRON [redacted]

Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva


Věcná správnost: [redacted]

Za objednatele

26-01-2018
V Ostravě dne

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

MUDr. Petr Uhlig
ředitel MNO

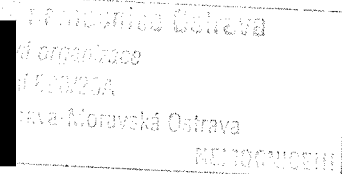

To Whom It May Concern,

Declaration

We, **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**, ("Mindray"), as manufacturer, hereby confirm that company **CHEIRÓN a.s.** with registered office at Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6, Czech Republic, is authorized to perform professional maintenance and repairs of below mentioned products:

- Anesthesia systems A5, A7, WATO series
- Defibrillators BeneHeart series
- Patient monitors BeneView T, BeneVision N, MEC, PM, VS, iPM, iMEC, uMEC series
- Central monitoring systems BeneVision, Hypervisor VI
- Telemetry monitoring systems TM-80, TMS-6016
- Electrocardiograph R3, R12
- Ventilators E3, E5, SV300
- Ultrasound System TE7

The authorized persons of company CHEIRÓN a.s. are as follows:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

MINDRAY CONFIDENTIAL

Very truly yours,

[Redacted Signature]

Date 2017. 4. 21 (Valid for two years)

Alvin XU

Manager of Service Department

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China



Všem, jichž se to týká

Prohlášení

My, společnost **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.** („Mindray“) jako výrobce tímto potvrzujeme, že společnost **CHEIRÓN a.s.**, se sídlem Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6, Česká republika, je oprávněna poskytovat odbornou údržbu a servis níže uvedených výrobků:

- Anestetické systémy A5, A7, řady WATO
- Defibrilátory řady BeneHeart
- Pacientské monitory řady BeneView T, BeneVision N, MEC, PM, VS, iPM, iMEC, uMEC
- Centrální monitorovací systémy BeneVision, Hypervisor VI
- Telemetrické monitorovací systémy TM-80, TMS-6016
- Elektrokardiograf R3, R12
- Ventilátory E3, E5, SV300
- Ultrazvuk TE7

Autorizované osoby společnosti CHEIRÓN a.s. jsou tyto:



S úctou,

Nečitelný podpis a razítko



Datum 21.4.2017 (platnost 2 roky)

manažer servisního oddělení



Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (razítko)

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen 518057, Čínská lidová republika

Jako tlumočnick z jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Plzni ze dne 21.6.1996 Spr 1183/96, č. j.
468 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedla tyto opravy.....
Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 231/4042/97 deníku.
Odměna účtována za 1 stranu/y podle pol. č. 19/97



CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6, Czech Republic

December 22th, 2016

MANUFACTURER'S AUTHORIZATION


We, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., ("Mindray") manufacturer of **Patient Monitors BeneVision N, BeneView T, uMEC, iMEC, iPM, MEC and PM series, Vital Sign Monitors VS series, Central Monitoring Systems BeneVision, Hypervisor VI, Telemetry Monitoring Systems TM-80, TMS-6016, Anaesthesia Systems A5, A7, WATO series, Defibrillators BeneHeart series, Electrocardiograph R3, R12, Pulse Oximeter PM-60, PM-50, Ultrasound System TE7, Ventilator SV300 ("Products")**, hereby declare that we trained and authorized: **CHEIRÓN a.s.**, with business office at Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6, Czech Republic ("**You**") as the distributor for purchase, store, sales and service of the above mentioned Product(s) in **Czech Republic and Slovak Republic ("Territory")**.

As the manufacturer, Mindray guarantees our products against defects in materials and workmanship, and provide services based on the standard terms and conditions of Mindray's warranty policy.

This authorization of distrobution rights is valid from the date of issuance up to **December 31, 2017**. Mindray reserves the right to terminate the authorization upon fifteen (15) days written notice without any further compensation to You.

Neither this Letter of Authorization nor any further extension, will impose any obligation or grant any rights regarding further distribution of Product, nor allow any party to seek compensation for goodwill developed during the term of Letter of Authorization or any further extension.

Very truly yours,

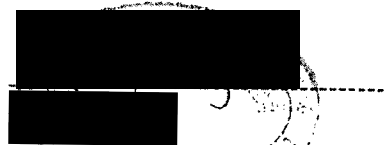

**General Manager of International Sales and Marketing System, East Europe
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.**

EU-AL-PU420-161465

CHEIRÓN, a.s.

Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6, Česká republika

Mindray

22. prosince 2016

POVĚŘENÍ VÝROBCE


My, společnost **Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.** (dále jen „Mindray“), výrobce monitorů pro pacienty série **BeneVision N, BeneView T, uMEC, iMEC, iPM, MEC a PM, monitorů životních funkcí série VS, centrálních monitorovacích systémů BeneVision, Hypervisor VI, telemetrických monitorovacích systémů TM-80, TMS-6016, anestetických přístrojů A5, A7, série WATO, defibrilátorů série BeneHeart, elektrokardiografů R3, R12, pulzních oxymetrů PM-60, PM-50, ultrazvukových systémů TE7, ventilátorů SV300** (dále jen „Produktů“) tímto prohlašujeme, že jsme proškolili a pověřujeme společnost **CHEIRÓN a.s.**, se sídlem Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6, Česká republika („Vy, Vás“) jako distributora pro nákup, skladování, prodej a servis výše uvedených Produktů v **České republice a Slovenské republice** („Území“).


Jako výrobce společnost Mindray poskytuje záruku na naše výrobky ohledně vad na materiálu a řemeslném zpracování a poskytuje servis na základě standardních podmínek záruční politiky společnosti Mindray.

Toto pověření distributora je platné od data vydání do **31. prosince 2017**. Mindray si vyhrazuje právo ukončit toto pověření výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou bez dalšího odškodnění pro vás.




Tento pověřovací dopis ani jeho další prodloužení neukládají žádné povinnosti ani neudělují žádná práva ohledně další distribuce Produktů, rovněž neumožňují žádné ze stran žádat o odškodnění za dobrou pověst získanou během trvání tohoto pověřovacího dopisu či jeho dalšího prodloužení.

S úctou,


Generální ředitel pro prodej a marketing ve východní Evropě
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, Co., Ltd.
Nečitelný otisk razítka

Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South,
Hi-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen 518057, Čínská lidová republika
Tel: +

www.mindray.com

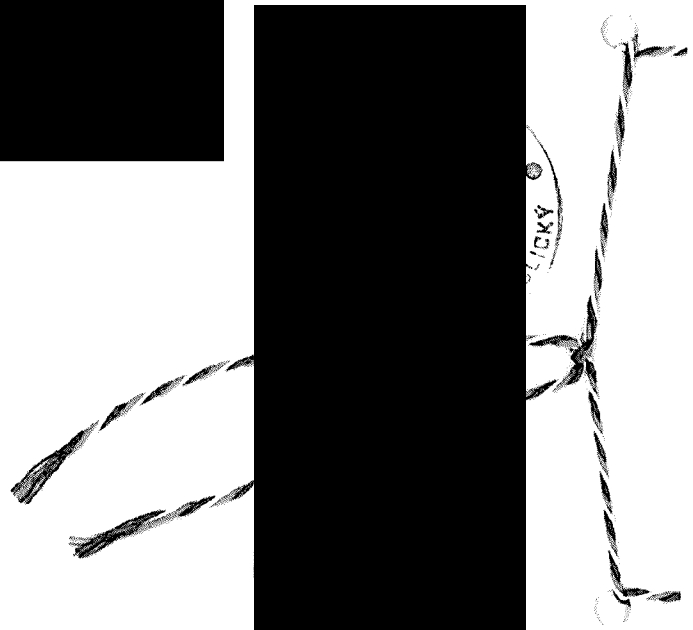Jako tlumočník z jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Plzni ze dne 21.6.1996 Spr 1183/96, č. j.
468 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
V překladu jsem provedla tyto opravy.....
Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 114/4035/77...deníku.
Odměna účtována za.....7...stranu/y podle pol.č. 19/17....



Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/53/2017	2017	OVZ [redacted]

Příloha č. 2 Servisní smlouvy: Ceník výkonů

V příloze bude uvedeno:

- Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: Ultrazvuk TE7 se třemi konektory pro sondy (převodníky)
- Model: PU-212B-CTO-S01 TE7

Ceny za servisní práce v pozáruční době (dále jen jako "servisní služby"):				
Servisní služba	Četnost	Kč bez DPH	Hodnota DPH v %	Celkem Kč vč. DPH
Náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu během 1 roku zahrnující cestovné a výměnu materiálu doporučeného výrobcem pro BTK (mimo záruku)	1x ročně	7.350	1.543,50	8.893,50
Náklady na 1 hodinu práce servisního technika	na vyžádání	850	178,50	1.028,50
Cestovné do sídla zadavatele a zpět včetně ztrátového času na cestě	na vyžádání	5.550	1.165,50	6.715,50

Za zhotovitele

V Praze dne19-01-2018

[redacted]

Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

[redacted]


Za objednatele

V Ostravě dne26-01-2018

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
[redacted]

MUDr. Petr Uhlig
ředitel MNO

[redacted]

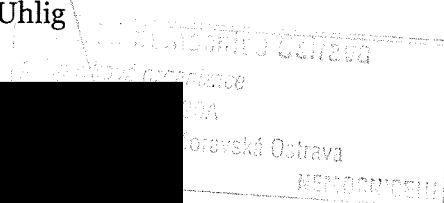

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha
IČ : 27094987
DIČ : CZ27094987

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.



EN ISO 13485

ASOCIACE VÝROBCE A DODAVATELÉ ZOBRAŤOVACÍCH PŘÍSTROJŮ

Telefon : Fax : 

E-mail : obchod@cheiron.eu

Datum pořízení : 31.10.2017**Datum dodání** :**Termín dodání** :**Řada dokladu** : 001**Číslo dokladu** : 800288**Popis dodávky** : Část 3 pro emergency Sono TE7**Místo určení :**

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Odběratel :

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

Vážení,

na základě VZ "Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu" Vám zasíláme tuto cenovou nabídku pro 3. část: 1 ks ultrazvukového přístroje pro centrální příjem s emergency

Obchodní podmínky:

- dopravné nebude doučtováno dle skutečných nákladů
- platnost nabídky 3 měsíce od data vytvoření nabídky
- termín dodání 2 týdnů od uzavření kupní smlouvy
- platební podmínky dle kupní smlouvy
- záruční podmínky 24 měsíců od předání zboží
- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.

Servis:

- PBTk 1x ročně po dobu záruky zdarma
- cena PBTk 1800,- Kč
- cena dopravné 13,-Kč/km
- čas nutný ztrátový 250,-Kč
- hodina servisní práce 850,-Kč
- vzdálenost servisního střediska BRNO -175km (účtováno 350km)

ceny jsou uvedeny bez DPH

Technická specifikace:

- přístroj musí být ergonomický a přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření vyšetřujícími lékaři s nízkou váhou do cca 7 kg (+- 10%) pro převoz po oddělení, - ANO

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s. Ulrychova 2260/13 162 00 Praha	Řada dokladu : 001 Číslo dokladu : 800288 Popis dodávky : Část 3 pro emergency Sono TE7
--	--

- výškově stavitelná poloha přístroje, pojízdný vozík s navinovacím převodním el. kabelem s přihrádkami na příslušenství vč. 4 odnímatelných držáků převodníků - ANO
- sleep mód umožňující vypnutí a naběhnutí přístroje do provozního režimu po převozu (vypnutí max. do 5 sekund, zapnutí ze stand-by módu do 3 sekund) nebo plný provoz na baterie, - ANO
- minimálně 15" monitor s FullHD rozlišením stranově a výškově polohovatelný, - ANO
- frekvenční rozsah přístroje minimálně v rozsahu 1 až 18 MHz, dynamický rozsah více jak 30 – 240 dB, maximální snímkovací frekvence více jak 1000 f/s, - ANO
- ovládání přístroje pomocí dotykového displeje s velikostí min. 15", SW QWERTZ klávesnice - ANO
- minimálně 3 aktivní porty pro připojení zobrazovacích sond - ANO
- vestavěná baterie na provoz min. 2 hodiny - ANO
- funkce uzamknutí obrazovky - ANO
- jednotlačítková optimalizace upravující 2D i dopplerovské módy (automatická úprava nulové linie, zisku a rychlosti u spektrální křivky, automatické umístění a nastavení optimálního úhlu ROI barevného Dopplera i automatické nastavení směru průtoku cévou - ANO
- automatická úprava zisku a TGC, - ANO
- záznam obrazové informace na interní HDD o velikosti minimálně 120 GB SSD - ANO
- archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM - ANO
- archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách, v PC i DICOM formátech - ANO
- přístroj musí být vybaven síťový konektor, 1 x HDMI, 4 x USB3 výstupem pro připojení USB flash disku nebo externího HDD a DVD mechanikou pro export na DVD nosiče - ANO
- Zobrazovací módy
- vysoce kvalitní 2D zobrazení s možností harmonického zobrazení na všech sondách, - ANO
- M-mód, anatomický M-mód, - ANO
- THI s pulsní inverzí, - ANO
- barevný doppler, - ANO
- širokopásmový barevný doppler, - ANO
- simultánní 2D a M-mód, - ANO
- energetický doppler, - ANO
- duplexní a simultánní 2D/PW doppler, - ANO
- duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera, - ANO
- duplexní barevný doppler a CW doppler, - ANO
- High-PRF PW doppler, - ANO
- duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler - ANO,
- duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler, - ANO
- nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler, - ANO
- nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler, - ANO
- duální zobrazování, - ANO
- až 10 násobné zvětšení živého i zamraženého obrazu, - ANO
- odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off), - ANO
- real-time současné zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - ANO

Další požadavky

- přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM obsahujícím min. Worklist, Structured Reporting a Query/Retrieve (včetně možnosti rozšíření o multimodality Q/R - možnosti porovnání UZV obrazu s obrazem pořízeným pomocí CT/MR na monitoru UZV) - ANO
- přístroj musí umožňovat současné zobrazení dříve provedené studie s real-time prováděnou studií na monitoru přístroje, - ANO
- přístroj musí vytvářet vlastní databázi patientských a obrazových dat s možností vyhledávání, - ANO
- přístroj musí umožňovat zasilání patientských studií (obrázků, smyček, reportů) v PC formátech do pracovní stanice pomocí LAN, WiFi, - ANO
- programové vybavení pro obecné zobrazování (zejména pro vyšetření orgánů dutiny břišní a měkkých částí, přednastavení pro cévní aplikace, přednastavení pro vyšetření dětských pacientů), kardiologické vyšetření, TCD... - ANO
- možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze, - ANO
- spotřeba přístroje do 150 VA. - ANO

Sondy:

- konvexní sonda pro diagnostiku orgánů dutiny břišní, hloubka minimálně v rozsahu 4 – 40 cm, frekvenční rozsah min. 2 - 5 MHz - ANO

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel: CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 800288

Popis dodávky : Část 3 pro emergency Sono TE7

- lineární sonda pro cévní diagnostiku, hloubka minimálně v rozsahu 1,5 – 28 cm,
frekvenční rozsah min. 4-12 MHz. - ANO

Obchodní podmínky jsou uvedeny na: www.cheiron.cz.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky a zašlete na adresu: CHEIRÓN a.s., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň.

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším představám a těšíme se na další spolupráci.

Regionální manažer

CHEIRÓN a.s.

Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

Tel:

Mobil:

Fax:

E-mail: [@cheiron.eu](mailto: @cheiron.eu)

www.cheiron.eu

Výrobce a dodavatel zdravotnických prostředků
i služeb v oboru anestezie a intenzivní péče.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	Cena				Celkem bez DPH		Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
			J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	po slevě	DPH %			
1	100 PU-212B-CTO-S01 TE7 1,00	Ultrazvuk TE7 se třemi konektory pro sondy (převodníky) 15-palcový dotykový displej, Antireflexní a s širokým pozorovacím úhlem 120gb Pevný disk & iStation™ Patientský Informační Management B/M/Color/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging Pulse Wave Doppler (zahrnuje vysokou frekvenci opakování pulzů) iBeam™ (vyklonění paprsku pro zobrazení v prostoru např. pod kost) iClear™ (potlačení skvrnitého zobrazení) iTouch™ (automatická optimalizace parametrů zobrazení) Smart Track (optimalizace funkce průtoku, zaměření stanovené části, je určeno jen pro snímač: L 12-4s) PSH™ (fázový posun) iZoom™ (zobrazení plné obrazovky) síťový port, výstup HDMI, 4x USB 3.0 vestavěná Lithium-ion baterie vestavěný bezdrátový adaptér 4 odnímatelné držáky převodníků (snímačů) ks 410 900,00 410 900,00 410 900,00 21 86 289,00 497 189,00								
2	100 PU-120-000172-00 1,00	Konvexní sonda (převodník) C5-2s k ultrazvuku TE7 aplikace: Břicho, Gynekologie, porodnictví, urologie hloubka: 4-40 cm Emergency: FAST/EFAST Anestezie: hluboké nervové blokády Intenzivní péče: FAST/EFAST MSK: skenování kyčelního kloubu ks 0,00 0,00 0,00 21 0,00 0,00								
3	100 PU-120-001111-01 1,00	Lineární sonda (převodník) L14-6Ns k ultrazvuku TE7 aplikace: Cévní, malé části, Nervy, MSK hloubka: 1,5-28 cm Anestezie: povrchní nervové blokády Intenzivní péče: plíce/CVC MSK: povrchní skenování MSK ks 0,00 0,00 0,00 21 0,00 0,00								

