

**RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA****Zimmer Czech, s.r.o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50253

se sídlem: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

IČO: 25107976

DIČ: CZ25107976

bankovní spojení: Citibank Praha

číslo účtu: 2052340102/2600

zastoupená: Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

Vojenská nemocnice Olomouc

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: Sušilovo náměstí 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 608 00 691

DIČ: CZ60800691

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou, ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“ nebo „**pověřující zadavatel**“)

(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“):

Článek I.**Úvodní ustanovení**

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Ortopedické implantáty**“ část 1. – **TEP kyčelního kloubu**“, která byla centrálním zadavatelem uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod č. ev. Z2017-033011 dne 27. 11. 2017 (dále „veřejná zakázka“ nebo i „zadávací řízení“), a která byla zadána v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZVZZ“) pod č.j. 9634/2017-ÚVN, a to v souladu se Smlouvou o centralizovaném zadávání ze dne 28. 5. 2012 ve znění dodatku k této smlouvě ze dne 7. 12. 2012, na jejímž základě kupující jakožto pověřující zadavatel výše uvedené veřejné zakázky sám na svůj účet uzavírá tuto smlouvu s prodávajícím. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací dokumentace a z nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.



Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu zboží – **ortopedické implantáty**, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“), v souladu s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Prodávající bere na vědomí, že objem zboží uvedený v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce je pouze předpokládaný a byl stanoven na základě spotřeby za předcházející období jednoho roku při zohlednění budoucích potřeb kupujícího odpovídajících počtu pacientů. Skutečné množství odebraného zboží se bude odvíjet od aktuálních potřeb kupujícího v daném časovém období.
3. Prodávající prohlašuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy disponovat dostatečným množstvím zboží, aby uspokojil požadavky kupujícího na dodávky dle této smlouvy bez jakýchkoliv prodlev.
4. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně do užívání čtyři sady instrumentárií pro kompletní provedení příslušného operačního výkonu. Instrumentárium bude kupujícímu předáno nejpozději s první dodávkou zboží.
5. Prodávající se zavazuje zajistit pravidelný servis jím zapůjčených instrumentárií.

Článek III. Realizace dodávek

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží na oddělení ortopedie v sídle kupujícího. Kupující pronajme prodávajícímu sklad v prostorách kupujícího za účelem uskladnění zboží, který se nachází v pavilonu chirurgie v sídle kupujícího. Podmínky užívání skladu jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, která je uzavírána současně při podpisu této smlouvy.
2. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek kupujícího učiněných některým z následujících způsobů:
 - a) písemně v listinné podobě,
 - b) elektronickou poštou (e-mailem) na adrese customerservice.cz@zimmerbiomet.com
 - c) telefonicky na čísle 261 394 200, jde-li o objednávku v ceně nepřesahující 50.000,- Kč bez DPH,
3. V pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 hodin platí, že prodávající zašle kupujícímu do dvou hodin po obdržení objednávky, vždy však před splněním dodávky, písemnou akceptaci objednávky, z které vyplývá, v jakém rozsahu a v jaké celkové kupní ceně objednávku přijímá. V případě odeslání objednávky kupujícího mimo uvedenou dobu se lhůta dvou hodin počítá od 7:00 hodin nejbližší následujícího pracovního dne. Akceptaci objednávky zašle prodávající kupujícímu zpravidla stejným prostředkem komunikace na dálku, jakým byla učiněna objednávka. Akceptaci objednávky učiněné písemně v listinné podobě nebo e-mailem zašle prodávající kupujícímu e-mailem na adresu xxx@vnol.cz a v případě objednávky učiněné e-mailem rovněž na adresu, z níž byla objednávka odeslána. Objednávku učiněnou telefonicky lze akceptovat dodáním zboží.
4. Zboží bude objednávat Ortopedické oddělení kupujícího, které se nachází v sídle kupujícího. Místem plnění (dodání zboží) je pavilon chirurgie, který se nachází v místě sídla kupujícího.



5. K objednávání zboží a k převzetí dodaného zboží jsou oprávněni pověřeni pracovníci Ortopedického oddělení kupujícího. Kontaktní osobou za kupujícího, odpovědnou za záležitosti týkající se objednávek a dodávek zboží. Kontaktní osobou za prodávajícího, odpovědnou za záležitosti týkající se objednávek a dodávek zboží, e-mail: customerservice.cz@zimmerbiomet.com
6. Proávající se zavazuje dodat objednané a potvrzené zboží nejpozději do 3 dnů od akceptace objednávky kupujícího. Dny pracovního klidu se do lhůty podle věty první nezapočítávají. V případě urgentní objednávky zajistí prodávající dodání zboží po dohodě s kupujícím v den objednání.
7. Každá dodávka zboží bude vybavena potřebnou dokumentací v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), a dále dodacím listem nebo jiným obdobným dokladem, na kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí dodávky zboží (dále jen „dodací list“). Dodací list (nebo jeho přílohy) musí obsahovat množství zboží s uvedením jednotlivých druhů zboží včetně údajů o šarži a době použitelnosti, ceny za jeden kus zboží a celkové ceny, vždy bez DPH a včetně DPH. Funkci dodacího listu může plnit i faktura, pokud je kupujícímu předána společně s dodávkou zboží a splňuje uvedené náležitosti dodacího listu.
8. Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží, včetně dodacího listu – potvrzuje se počet přepravních jednotek. Podpisem dodacího listu osobou pověřenou kupujícím k převzetí zboží přechází vlastnické právo k dodávanému zboží na kupujícího.
9. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí prodávajícího, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnám, či kontaminaci, a aby zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům. Proávající se zavazuje, že s dodávaným zbožím bude nakládat výlučně v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o zdravotnických prostředcích.
10. Proávající se zavazuje dodávat kupujícímu výlučně takové zboží, které nemá závady v jakosti ani porušený obal, jeho doba použitelnosti (expirace) ode dne dodání činí minimálně 6 měsíců a jeho distribuce nebyla zakázána Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL). V případě, že kupující vysloví slouhlas s dodáním zboží s kratší dobou použitelnosti, lze takové zboží dodat na základě předchozí písemné dohody.
11. Proávající prohlašuje, že na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě, CE certifikát v souladu s příslušnými závaznými předpisy ČR a EU a že toto zboží již bylo uvedeno na trh v některém z členských zemí EU.
12. Proávající se zavazuje dodávat zboží v originálním obalu. Na vnějším obalu musí být platný čárový kód EAN. Zboží musí být označeno šarží a dobou použitelnosti.
13. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky v následujících případech:
 - a) druh a/nebo množství dodaného zboží neodpovídá přijaté objednávce,
 - b) prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu,
 - c) dodací list nebo jeho přílohy neobsahují náležitosti stanovené touto smlouvou,
 - d) množství zboží nebo přepravních jednotek uvedené v dodacím listě nebo jeho přílohách neodpovídá skutečně dodanému množství, nebo
 - e) dodané zboží je zjevně poškozené nebo je dodáno v porušeném obalu nebo s kratší dobou použitelnosti, než stanoví tato smlouva.



14. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky,
 - a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
 - b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou zboží škoda nebo její vznik hrozí.
15. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu zboží ve sjednané ceně a lhůtě z důvodu, že zboží nemá k dispozici, je povinen na tuto skutečnost kupujícího neprodleně upozornit. Jestliže v době objednávky je zboží, případně zdravotnický prostředek se stejnými či podobnými vlastnostmi a parametry, dostupné na trhu v České republice prostřednictvím jiného dodavatele, má kupující právo zajistit si v případě nezbytné potřeby, a v množství nezbytně nutném, dodávku prostřednictvím tohoto jiného dodavatele. Případný rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami jiného dodavatele, jde-li o ceny v daném čase a místě obvyklé, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím, dosahuje-li tento rozdíl v souhrnu alespoň 500,- Kč za kalendářní měsíc. Prodávající se zavazuje tento případný rozdíl v cenách uhradit kupujícímu v plné výši, a to do 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy kupujícího, jejíž přílohou je kopie daňového dokladu (faktury) k dodávce jiného dodavatele. Kupující se v tomto případě zavazuje odebrat zboží, případně zdravotnický prostředek se stejnými či podobnými vlastnostmi a parametry, pokud možno od takového jiného dodavatele, jehož cena se bude co nejvíce blížit ceně prodávajícího.

Článek IV. Kupní cena

1. Kupní cena za předmět plnění dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jako cena maximální a nepřekročitelná, a to v částce ve výši 11.212.680,- Kč bez DPH (slovy: jedenáctmilionůdvěstědvánáctisícšestsetosmdesát korun českých).
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, a v konkrétní objednávce, která bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena odpovídající jednotkovým cenám zboží uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy je rovněž cenou maximální, nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady prodávajícího na dopravu zboží, obal, clo, záruku a ostatní náklady spojené s dodávkami zboží do místa plnění.
4. V případě změny zákonné sazby DPH na zboží může být kupní cena navýšena, ovšem jen ve výši odpovídající dané změně.
5. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změně „Číselníku VZP“, která bude znamenat snížení maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami za některé z dodávaného zboží pod jednotkovou cenu vyčíslenou v aktuálně platném ceníku v Kč včetně DPH, bude provedena aktualizace platného ceníku zboží, a to tak, že cena hrazená kupujícím za příslušné zboží bude snížena na úroveň maximální úhrady stanovené v „Číselníku VZP“.
6. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změně „Číselníku VZP“, která bude znamenat zvýšení maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami za některé z dodávaného zboží oproti jednotkové ceně vyčíslené v aktuálně platném ceníku zboží v Kč včetně DPH, bude provedena aktualizace platného ceníku zboží, a to tak, že cena hrazená kupujícím za příslušné zboží bude navýšena na úroveň maximální úhrady stanovené v „Číselníku VZP“, avšak maximálně do výše původní jednotkové ceny (vyčíslené v Kč včetně DPH) stanovené prodávajícím za příslušné zboží v jeho nabídce.



7. Nastane-li některá ze skutečností rozhodných pro úpravu kupní ceny zboží, specifikovaného shora v odst. 2. tohoto článku, provede kupující aktualizaci ceníku zboží, tj. provede úpravy jednotkových cen zboží dotčených změnou „Číselníku VZP“ a návrh upraveného ceníku zboží zašle k akceptaci/podpisu prodávajícímu, a to nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, kdy vstoupí v platnost nové znění „Číselníku VZP“. Proávající se zavazuje akceptovat/podepsat upravený ceník zboží a vrátit jej zpět kupujícímu v požadovaném počtu vyhotovení, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu upraveného ceníku zboží. Proávající je oprávněn odmítnout akceptaci/podpis upraveného ceníku zboží pouze tehdy, pokud aktualizace ceníku zboží nebude odpovídat pravidlům sjednaným v tomto článku smlouvy.
8. Aktualizované znění ceníku zboží nabývá platnosti vždy dnem následujícím po podpisu oběma smluvními stranami. K tomuto dni bude provedena výměna přílohy č. 2 této smlouvy.

Článek V.

Fakturační a platební podmínky

1. Proávající má povinnost vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 pracovních dnů od uskutečnění dodávky, která je předmětem fakturace, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
2. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Fakturace bude prováděna dle skutečně dodaného zboží. Kupující neposkytuje k úhradě kupní ceny zálohy.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
 - a) číslo každé objednávky,
 - b) identifikátor veřejné zakázky (ev. č. z Věstníku veřejných zakázek),
 - c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
 - d) kopii dodacího listu jako přílohu, ledaže faktura plní současně funkci dodacího listu za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané a řádně dodané zboží v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Proávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na



daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.

10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že

a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

11. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Článek VI.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou a s objednávkou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno. Zboží nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost v délce rovnající se době použitelnosti zboží (dále jen „záruční doba“).
3. Reklamací jakékoliv vady, včetně vady spočívající v chybějícím množství zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně, prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese customerservice.cz@zimmerbiomet.com nebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu, datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamační uplatněna, nebo datum odeslání reklamace prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací.
5. Reklamované zboží je prodávající povinen na své náklady v místě plnění převzít, případně zajistit jeho převzetí jím pověřenou osobou, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace.
6. V případě reklamace vady zboží je prodávající povinen v souladu s dodacími podmínkami stanovenými touto smlouvou nahradit reklamované zboží novým, případně doplnit chybějící množství zboží (dále jen „vyřízení reklamace“), a to nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace; dny pracovního klidu se do této lhůty nezapočítávají. V případě, že reklamační je oprávněná, je vyřízením reklamace uspokojeno právo kupujícího z vadného plnění. Je-li reklamační neoprávněná, má prodávající nárok na zaplacení kupní ceny za zboží dodané podle věty první na základě dodatečně vystavené faktury. Oprávněnost reklamace je prodávající povinen posoudit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, jinak platí, že reklamační je oprávněná.
7. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží z trhu nebo z oběhu, je prodávající povinen takové zboží odebrat na vlastní náklady od kupujícího zpět a vrátit mu kupní cenu tohoto



zboží. Stejnou povinnost má prodávající v případě, že v důsledku rozhodnutí orgánu státního dohledu o dočasném stažení zboží z trhu uplyne doba použitelnosti zboží nebo dojde k uplynutí více než 6 měsíců nebo jedné třetiny z této doby. Právo na náhradu škody způsobené kupujícím tím není dotčeno.

Článek VII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši

- a) 500,- Kč za každý započatý den prodlení, nejdéle však za prvních pět dnů prodlení, a
- b) 0,05 % z kupní ceny zboží, s jehož dodáním se prodávající ocitl v prodlení, za každý započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení, až do řádného splnění dodávky.

Stejnou povinnost má prodávající v případě prodlení s vyřízením reklamace ve lhůtě stanovené touto smlouvou.

2. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Článek VIII.

Trvání smlouvy

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami této smlouvy.
2. Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců ode dne její účinnosti nebo do vyčerpání kupní ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
3. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) výpovědí, nebo
 - c) odstoupením od smlouvy.
4. Kterákoliv smluvní strana má právo ukončit smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) nastanou okolnosti, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy (vyšší moc), nebo
 - b) druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:



- a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,
 - b) prodávající vstoupil do likvidace,
 - c) prodávající je opakovaně během posledních 2 měsíců v prodlení s dodáním zboží nebo s vyřízením reklamace,
 - d) kupující opakovaně během posledních 2 měsíců oprávněně reklamoval tutéž vadu dodaného zboží,
 - e) prodávající požaduje za dodané zboží zaplacení vyšší kupní ceny než sjednané touto smlouvou, nebo
 - f) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího.
7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží delším než 60 dnů.
8. Odstoupení od smlouvy nebo objednávky musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
- a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího
 - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.
- Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.
4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadata, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.



X.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 20.000.000,- Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřeveze, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
4. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o možnosti odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace zboží

Příloha č. 2: Ceník zboží

Příloha č. 3: Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem)

20. 02. 2018

V Olomouci dne.....2018

za kupujícího

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda

ředitel

Vojenské nemocnice Olomouc

V Praze dne 16. 2. 2018

za prodávajícího

Ing. Rostislav Hartman

jednatel

Zimmer Czech, s.r.o.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda
ředitel
Vojenská nemocnice
Olomouc





Příloha č.1 - Specifikace zboží

- **Specifikace jednotlivých položek:**

1. Cementovaná náhrada kyčelního kloubu s rovným dříkem neleštěným
3. Hybridní náhrada kyčelního kloubu
4. Necementovaná náhrada kyčelního kloubu typ pressfit

- **Dokumenty od výrobce prokazující jednotlivé parametry výrobků**



TEP kyčelního kloubu

1.Cementovaná náhrada kyčelního kloubu s rovným dříkem neleštěným

Cementovaná jamka

Požadavek:

min.12 velikostí

pro hlavice 22,28,32 a 36 mm

varianta X-link PE

déle než 10 leté klinické zkušenosti

Vyšetření MR

výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů

Original M.E. Muller Cup

12 velikostí (42-64 mm)

ano

ano

ano

ano

96,6% přežití implantátu po 10 letech
(Švédský registr 2007, str.63)

Kovová hlavička

Požadavek:

28 a 32, 36 mm

délka krčku min S,M,L, XL, XXL

VerSys

ano

ano

Cementovaný dřík

Požadavek:

min.9 velikostí

Standardní a lateralizovaná varianta

déle než 10 leté klinické zkušenosti

CDD úhel

výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů

Original Muller Stem

18 velikostí

STD a LAT

ano

125/135st

96,6% přežití implantátu po 10 letech
STD a LAT

97,5 % přežití po 10 letech

(Orthopedic Surgery 2007)



TEP kyčelního kloubu

3. Hybridní náhrada kyčelního kloubu

Necementovaná jamka

Požadavek:

Press fit jamka, hemisférická
povrch kombinace makro a mikrostruktury
min.17 velikostí
rozsah 42-74 mm
PE insert prům. 28,32 a 36 mm
PE symetrický a offsetový
možnost X-link, Vit E a keramické vložky
Děrované varianty pro fixaci šrouby
Možnost vyšetření MRI
déle než 10 leté klinické zkušenosti
výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů

Allofit

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
97.2 % přežití po 10 letech
(Švédský registr 2011, str.76)
97,5% přežití po 11,9 letech
(Journal of Bone and Joint surgery, 2009)

Kovová hlavička

Požadavek:

28 a 32 mm
délka krčku min S,M,L, XL, XXL

VerSys

ano
ano

Cementovaný dřík

Požadavek:

min.9 velikostí
Standardní a lateralizovaná varianta
déle než 10 leté klinické zkušenosti
CDD úhel
výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů

Original Muller Stem

18 velikostí
STD a LAT
ano
125/135st
96,6% přežití implantátu po 10 letech
STD a LAT
97,5 % přežití po 10 letech
(Orthopedic Surgery 2007)

TEP kyčelního kloubu

4. Necementovaná náhrada kyčelního kloubu typ pressfit

Necementovaná jamka	Allofit
Požadavek:	
Press fit jamka, hemisférická	ano
povrch kombinace makro a mikrostruktury	ano
min.17 velikostí	ano
rozsah 42-74 mm	ano
PE insert prům. 28,32 a 36 mm	ano
PE symetrický a offsetový	ano
možnost X-link, Vit E a keramické vložky	ano
Děrované varianty pro fixaci šrouby	ano
Možnost vyšetření MRI	ano
déle než 10 leté klinické zkušenosti	ano
výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů	97.2 % přežití po 10 letech (Švédský registr 2011, str.76) 97,5% přežití po 11,9 letech (Journal of Bone and Joint surgery, 2009)

Keramická hlavička	Sulox
Požadavek:	
průměr 28 a 32, 36 mm vč.varianty pro revizní případy	ano
délka krčku min S,M,L	ano

Necementovaný dřík	CLS Spotorno
Požadavek:	
Proximálně kotvený dřík	ano
možnost lateralizace -min. 3 varianty CCD úhlu (125 ° - 145°)	ano
velikostní škála celkem min.6 variant ke každému úhlu	ano
možnost miniinvazivní operativy	ano
déle než 10 leté klinické zkušenosti	ano-viz.
výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů	97,9% přežití po 10 letech Swedish National Register 2012 25

nebo

Necementovaný dřík	Alloclassic Zweymuller
Požadavek:	
Distálně kotvený dřík	ano
návaznost revizního systému	ano
možnost lateralizace -min. 2 varianty CCD úhlu (125 ° - 131°)	ano 121 - 131
velikostní škála celkem min. 14 variant	ano
déle než 10 leté klinické zkušenosti	ano
možnost implantace s pomocí pneu. kladiva	ano



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha



výborné výsledky doložené jedním ze zahr.registrů


Australian National Register 20153
Alloclassic – Allofit Follow-up: 10 years
po 10 letech 95,3% (4,7% revi.rating)

Cast 1.1.



**Original
M.E. Müller®
Low Profile Cup**


Surgical Technique

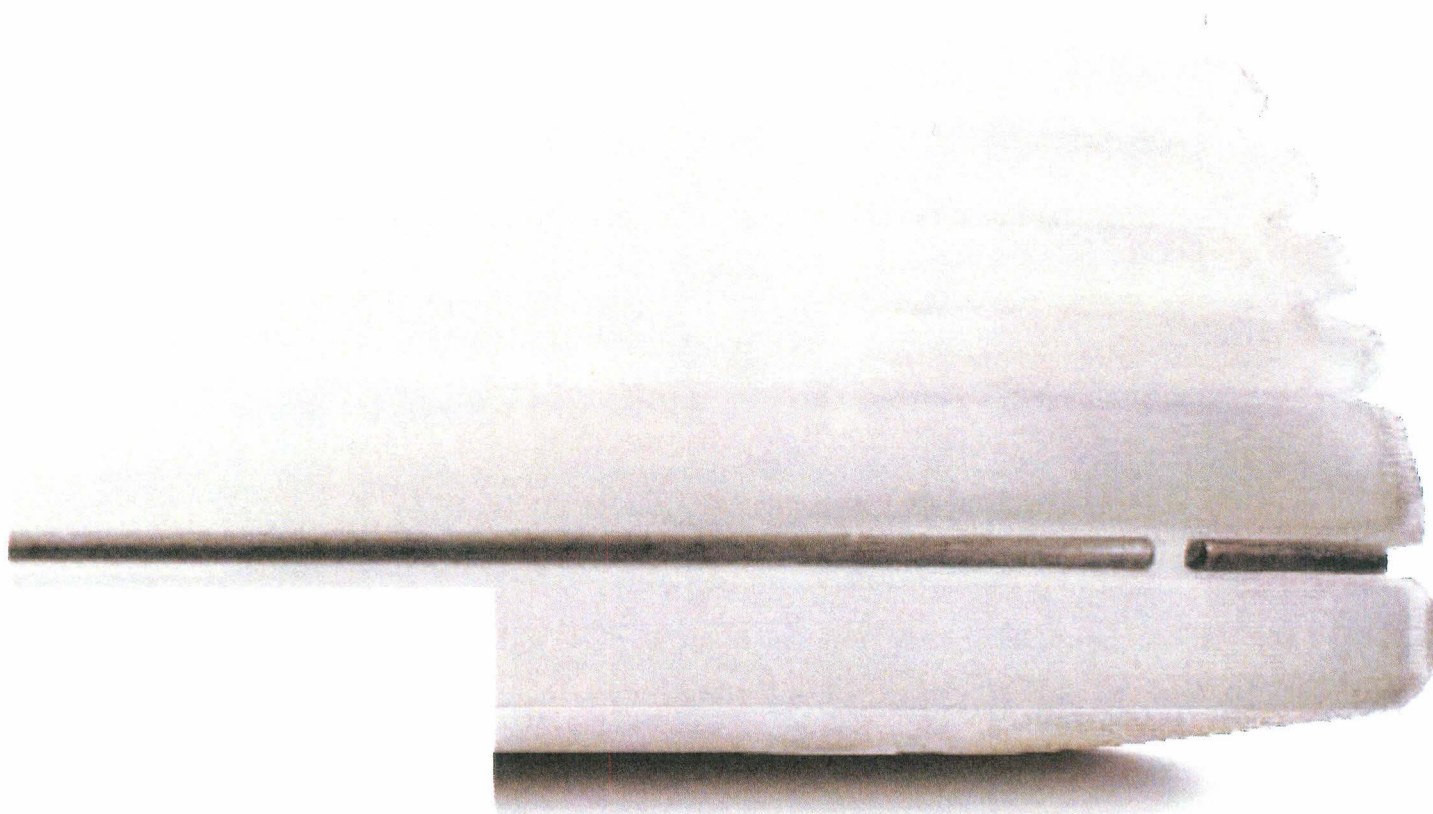

Evolution of a Proven Concept




Implants

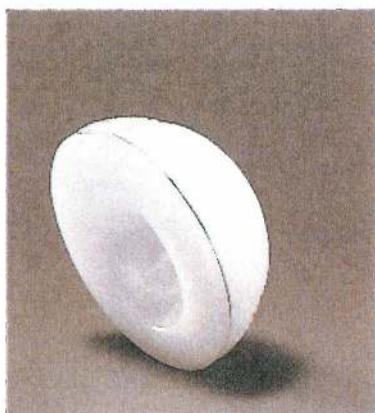

M.E. Müller®
Low Profile Cup, cemented

Details
UHMW Polyethylene
(Sulene® PE)
Radiological mark
CP Titanium
(Protasul® Ti)


STERILE R



Size [mm]	REF
36 ¹	63.22.36
38 ¹	63.22.38
40 ¹	63.22.40
42	63.22.42
44	63.22.44
46	63.22.46
48	63.22.48
50	63.22.50
52	63.22.52
54	63.22.54
56	63.22.56
58	63.22.58
—	—
—	—
—	—

Details
UHMW Polyethylene
(Sulene® PE)
Radiological mark
CP Titanium
(Protasul® Ti)


STERILE R



Size [mm]	REF
—	—
—	—
—	—
42 ¹	63.28.42
44	63.28.44
46	63.28.46
48	63.28.48
50	63.28.50
52	63.28.52
54	63.28.54
56	63.28.56
58	63.28.58
60	63.28.60
62	63.28.62
64	63.28.64


Details
UHMW Polyethylene
(Sulene® PE)
Radiological mark
CP Titanium
(Protasul® Ti)

STERILE R




Size [mm]	REF
—	—
—	—
—	—
—	—
44 ¹	63.32.44
46 ¹	63.32.46
48	63.32.48
50	63.32.50
52	63.32.52
54	63.32.54
56	63.32.56
58	63.32.58
60	63.32.60
62	63.32.62
64	63.32.64

¹ Must be used in combination with cages and rings.

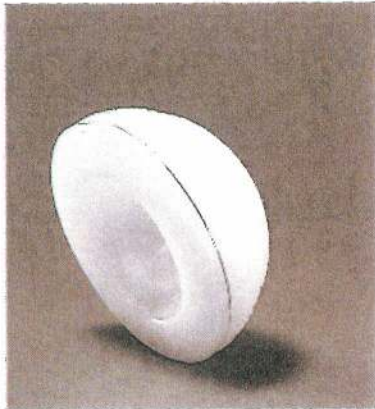


M.E. Müller®
Low Profile Cup, cemented


Details
Durasul®
Radiological mark
CP Titanium
(Protasul® Ti)



Details
Durasul®
Radiological mark
CP Titanium
(Protasul® Ti)



Details
Durasul®
Radiological mark
CP Titanium
(Protasul® Ti)



STERILE EO

Size [mm]	REF
42	01.00284.042
44	01.00284.044
46	01.00284.046
48	01.00284.048
50	01.00284.050
52	01.00284.052
54	01.00284.054
56	01.00284.056
58	01.00284.058
60	01.00284.060
62	01.00284.062
64	01.00284.064

STERILE EO

Size [mm]	REF
—	—
44	01.00324.044
46	01.00324.046
48	01.00324.048
50	01.00324.050
52	01.00324.052
54	01.00324.054
56	01.00324.056
58	01.00324.058
60	01.00324.060
62	01.00324.062
64	01.00324.064

STERILE EO


Size [mm]	REF
—	—
—	—
—	—
48	05.95001.050
50	05.95001.051
52	05.95001.052
54	05.95001.053
56	05.95001.054
58	05.95001.055
60	05.95001.056
62	05.95001.057
64	05.95001.058

Cast 1.1.
1.3.



Original
M.E. Müller™
Straight Stem

Surgical Technique

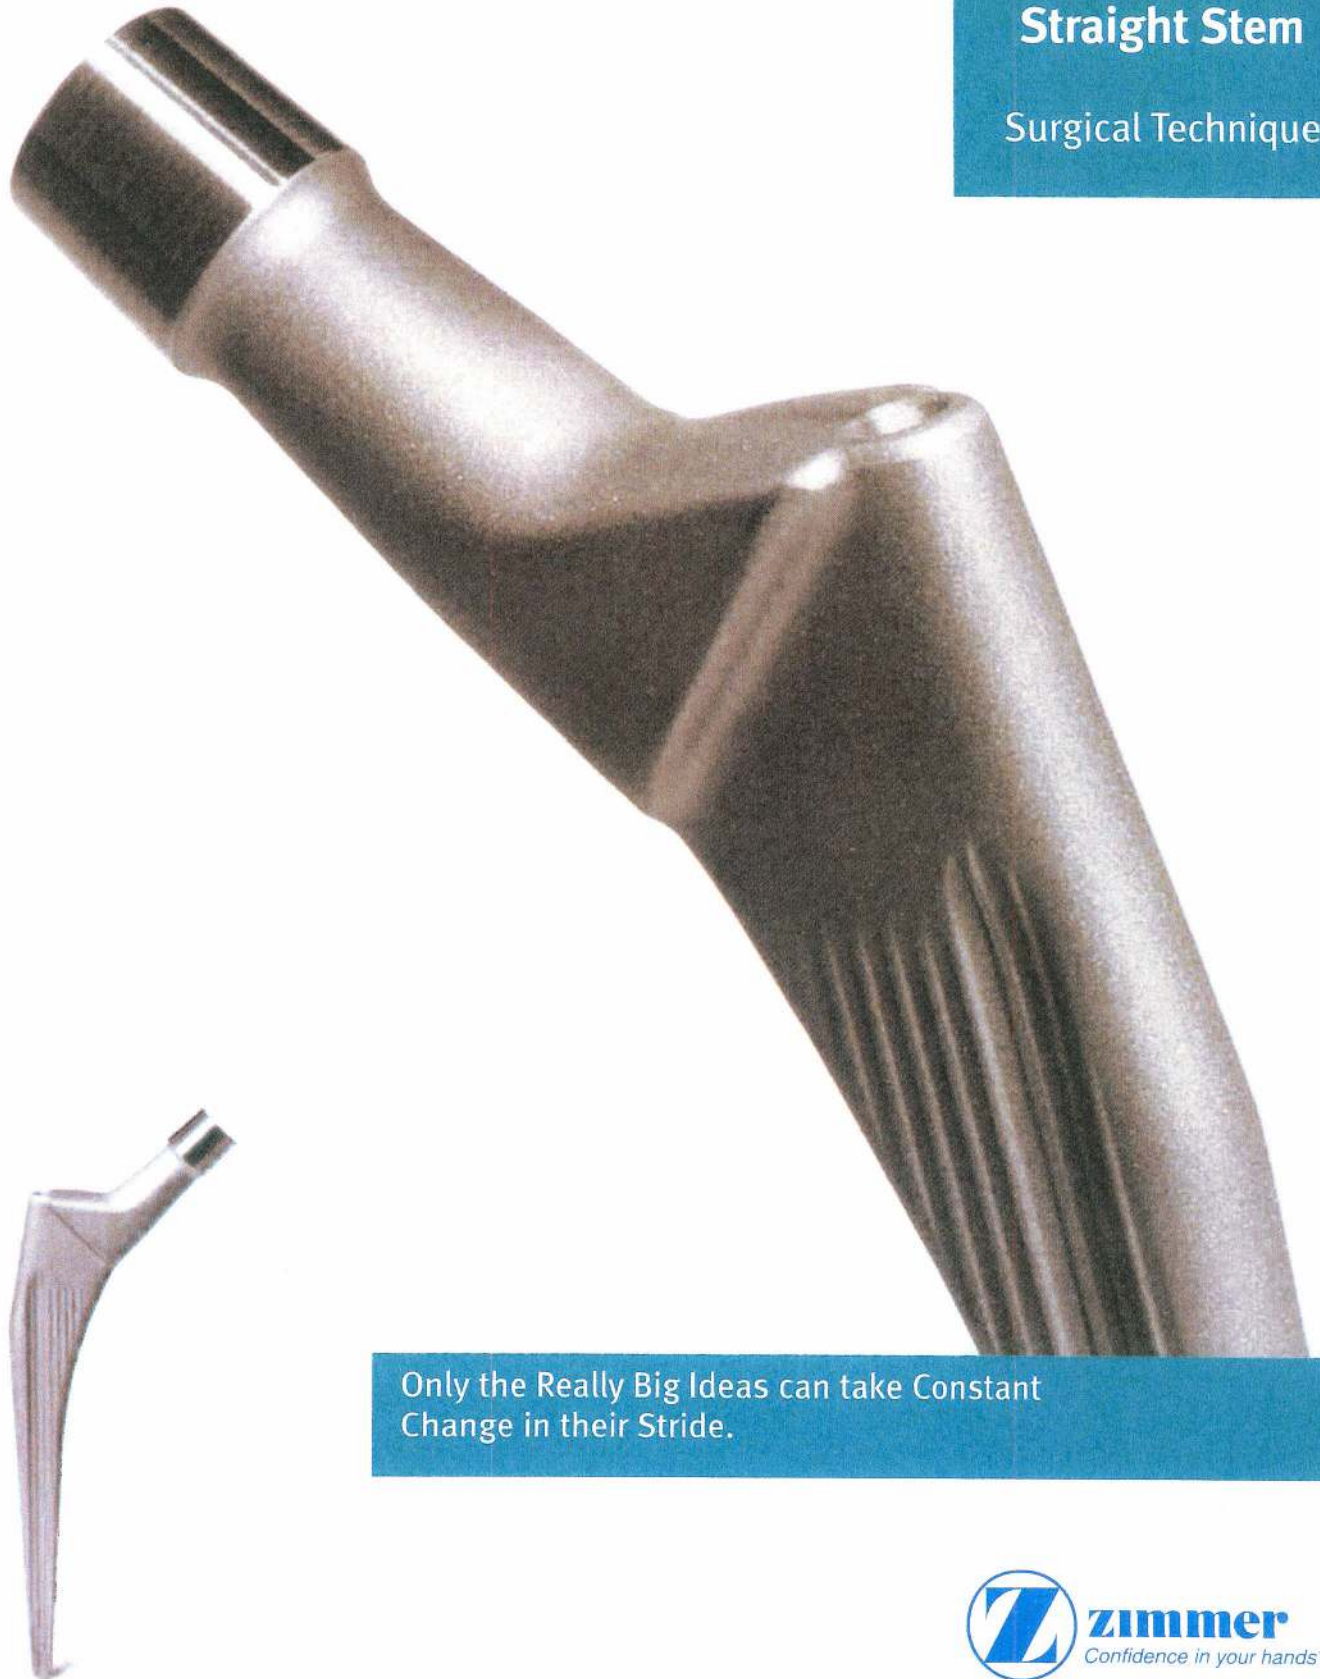

Only the Really Big Ideas can take Constant
Change in their Stride.



zimmer
Confidence in your hands®



Pre-Operative Planning – Purpose and Aids

The graphic planning of the hip replacement implantation forces the orthopedic surgeon to carry out detailed analysis of the X ray image, and to anticipate the operation in detail.

"This (correct planning – author) provides important information about the choice of the correct model and the correct size of the prosthesis, the depth of the acetabulum preparation, the height of the neck resection, and the positioning and alignment of the pelvic and femoral components. It allows fast and systematic execution of the operation and thus minimizes the risk of complications for the patient." (Müller, M.E., Jäberg, H., 1989)

Besides the obvious advantages of anticipating intraoperative difficulties, the pre-operative planning serves to correct and avoid differences in leg length.

As a part of quality assurance, pre-operative planning supports the work of the surgical team, and serves as a method of self-monitoring for the surgeon.

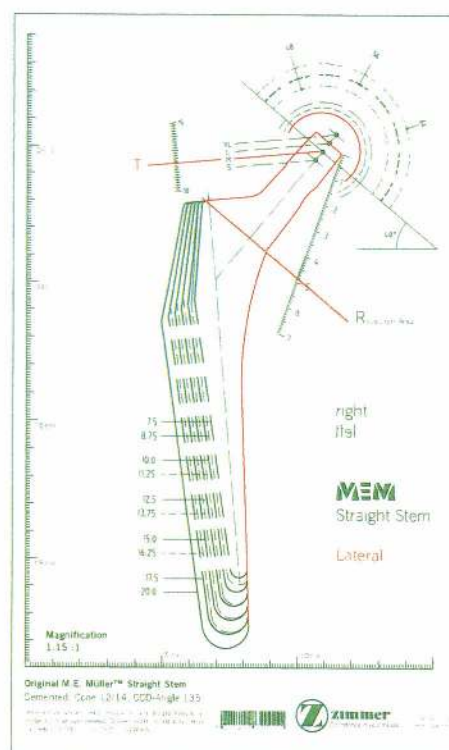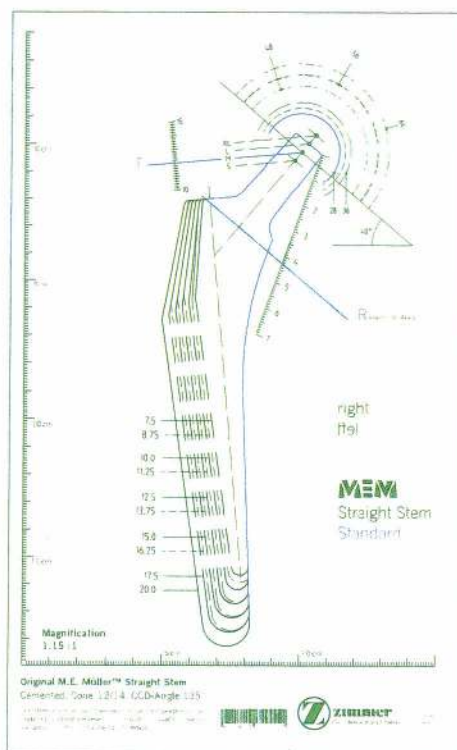

Planning template Original M. E. Müller Straight Stem, standard and lateral, enlargement factor 1.15 : 1, Lit. No. 06.01114.000

Implants – Original M. E. Müller™ Straight Stem

Müller™ Straight Stem,
standardMüller™ Straight Stem,
lateralMüller™ Straight Stem,
standardMüller™ Straight Stem,
lateralProtasul® 10
Cemented
M. E. Müller™

STERILE

Size in mm	REF
7.5	12.00.29-075
8.75	05.95001.064
10.0	12.00.29-100
11.25	12.00.29-112
12.5	12.00.29-125
13.75	12.00.29-137
15.0	12.00.29-150
16.25	12.00.29-162
17.5	12.00.29-175

Protasul® 10
Cemented
M. E. Müller™

STERILE

Size in mm	REF
7.5	12.00.39-075
8.75	05.95001.065
10.0	12.00.39-100
11.25	12.00.39-112
12.5	12.00.39-125
13.75	12.00.39-137
15.0	12.00.39-150
16.25	12.00.39-162
17.5	12.00.39-175

Protasul®-S30
Cemented
M. E. Müller™

STERILE

Size in mm	REF
7.5	35.00.29-075
8.75	05.95001.066
10.0	35.00.29-100
11.25	35.00.29-112
12.5	35.00.29-125
13.75	35.00.29-137
15.0	35.00.29-150
16.25	35.00.29-162
17.5	35.00.29-175

Protasul®-S30
Cemented
M. E. Müller™

STERILE

Size in mm	REF
7.5	35.00.39-075
8.75	05.95001.067
10.0	35.00.39-100
11.25	35.00.39-112
12.5	35.00.39-125
13.75	35.00.39-137
15.0	35.00.39-150
16.25	35.00.39-162
17.5	35.00.39-175



Müller™ Straight Stem,
standard, Ø 28 mm



Müller™ Straight Stem,
lateral, Ø 28 mm



CDH stem,
Ø 22 mm

Protasul®-S30
Cemented
M. E. Müller™



Protasul®-S30
Cemented
M. E. Müller™



Protasul®-S30
Cemented
M. E. Müller™



STERILE

Size in mm	REF
7.5	35.28.29-075
10.0	35.28.29-100
11.25	35.28.29-112
12.5	35.28.29-125
13.75	35.28.29-137
15.0	35.28.29-150
17.5	35.28.29-175

STERILE

Size in mm	REF
7.5	35.28.39-075
10.0	35.28.39-100
11.25	35.28.39-112
12.5	35.28.39-125
13.75	35.28.39-137
15.0	35.28.39-150
17.5	35.28.39-175

STERILE

Size in mm	REF
5.0	30.22.69-050
7.5	30.22.69-075
10.0	30.22.69-100
12.5	30.22.69-125


The special instruments for
implantation of the CDH stem
(monobloc rasps and test
protheses) are available
under REF 99.41.00-00.


Cast 1.3.
1.4.

Allofit®/Allofit®-S Alloclassic® Acetabular System

Ordering Information

Allofit Implants

Product	Description	Shell Size (mm)	Corresponding Alpha Liner Size	Part Number
 	Allofit Shell Protasul®-Ti	46	FF	4242
		48	GG	4243
		50	HH	4244
		52	II	4245
		54	JJ	4246
		56	KK	4247
		58	LL	4248
		60	MM	4249
		62	NN	4250
		64	OO	4251

 	Allofit-S Shell Protasul-Ti	46	FF	4262
		48	GG	4263
		50	HH	4264
		52	II	4265
		54	JJ	4266
		56	KK	4267
		58	LL	4268
		60	MM	4269
		62	NN	4270
		64	OO	4271
		66	PP	4272
		68	QU	4273

Optional Implants

Allofit Shell Protasul-Ti	42	DD	4240
	44	EE	4241
Allofit-S Shell Protasul-Ti	42	DD	4260
	44	EE	4261
	70	RR	4274
	72	SS	4275
	74	TT	4276

Allofit Implants (cont.)

Product	Description	Quantity	Part Number	
	Pole plug M8 Protasul-Ti	1	01.00004.000	
	Screw hole plug Protasul-Ti	7	4279	Non-Sterile
		7	01.00004.001	Sterile



Cancellous Bone Screws

Product	Description	Diameter (mm)	Length (mm)	Part Number
	Countersunk Cancellous Bone Screw (Non-Self-Tapping) Titanium® Ti-6Al-4V Alloy	Ø 6.5	15	4301-07-015
			20	4301-07-020
			25	4301-07-025
			30	4301-07-030
			35	4301-07-035
			40	4301-07-040
			45	4301-07-045
			50	4301-07-050
			55	4301-07-055
			60	4301-07-060
	Non-Sterile			
	Countersunk Cancellous Bone Screw (Self-Tapping) Titanium Ti-6Al-4V Alloy	Ø 6.5	15	00-6250-065-15
			20	00-6250-065-20
			25	00-6250-065-25
			30	00-6250-065-30
			35	00-6250-065-35
			40	00-6250-065-40
			50	00-6250-065-50
			60	00-6250-065-60
	Sterile			


Optional Implants

	Countersunk Cancellous Bone Screw (Non-Self-Tapping) Titanium Ti-6Al-4V Alloy	Ø 6.5	70	4301-07-070
			80	4301-07-080
	Countersunk Cancellous Bone Screw (Self-Tapping)	Ø 6.5	70	00-6250-065-70
			80	00-6250-065-80

Sulene® Alpha Liners

Product	Description	Measurement A (mm)	Size	Part Number
 	Alpha Liner Sulene Polyethylene	Ø 28	FF	01.00010.206
			GG	01.00010.207
			HH	01.00010.208
			II	01.00010.209
			JJ	01.00010.210
			KK	01.00010.211
			LL	01.00010.212
			MM	01.00010.213
			NN	01.00010.214
			OO	01.00010.215
			PP	01.00010.216
			QU	01.00010.217
Measurement B (mm)				
 	Alpha Liner Hooded Sulene Polyethylene	Ø 22	DD	01.00010.104
			EE	01.00010.105
			FF	01.00010.106
			GG	01.00010.107
			HH	01.00010.108
	Ø 28	FF	01.00010.306	
		GG	01.00010.307	
		HH	01.00010.308	
		II	01.00010.309	
		JJ	01.00010.310	
		KK	01.00010.311	
		LL	01.00010.312	
		MM	01.00010.313	
		NN	01.00010.314	
		OO	01.00010.315	
		PP	01.00010.316	
		QU	01.00010.317	
	Ø 32	II	01.00010.809	
		JJ	01.00010.810	
		KK	01.00010.811	
		LL	01.00010.812	
		MM	01.00010.813	
		NN	01.00010.814	
		OO	01.00010.815	
		PP	01.00010.816	
		QU	01.00010.817	


Durasul® Alpha Liners

Product	Description	Measurement A (mm)	Size	Part Number
 	Alpha Liners Durasul Polyethylene	Ø 28	FF	01.00013.206
			GG	01.00013.207
			HH	01.00013.208
			II	01.00013.209
			JJ	01.00013.210
			KK	01.00013.211
			LL	01.00013.212
			MM	01.00013.213
			NN	01.00013.214
			OO	01.00013.215
		Ø 32	PP	01.00013.216
			QU	01.00013.217
			TT	01.00013.220
			GG	01.00013.407
			HH	01.00013.408
			II	01.00013.409
			JJ	01.00013.410
			KK	01.00013.411
			LL	01.00013.412
			MM	01.00013.413
		Ø 36	NN	01.00013.414
			OO	01.00013.415
			PP	01.00013.416
			QU	01.00013.417
			II	01.00013.709
			JJ	01.00013.710
			KK	01.00013.711
			LL	01.00013.712
			MM	01.00013.713
			NN	01.00013.714
			OO	01.00013.715
			PP	01.00013.716
			QU	01.00013.717

Optional Implants

Ø 22	DD	01.00013.004
Ø 28	EE	01.00013.205
	RR	01.00013.218
	SS	01.00013.219
Ø 32	RR	01.00013.418
	SS	01.00013.419
	TT	01.00013.420
Ø 36	RR	01.00013.718
	SS	01.00013.719
	TT	01.00013.720

Durasul® Alpha Liners (cont.)

Product	Description	Measurement A (mm)	Size	Part Number
 	Alpha Liner Hooded Durasul Polyethylene	Ø 28	FF	01.00013.306
			GG	01.00013.307
			HH	01.00013.308
			II	01.00013.309
			JJ	01.00013.310
			KK	01.00013.311
			LL	01.00013.312
			MM	01.00013.313
			NN	01.00013.314
			OO	01.00013.315
			PP	01.00013.316
			QU	01.00013.317
		Ø 32	HH	01.00013.508
			II	01.00013.509
			JJ	01.00013.510
			KK	01.00013.511
			LL	01.00013.512
			MM	01.00013.513
			NN	01.00013.514
			OO	01.00013.515
			PP	01.00013.516
			QU	01.00013.517

Optional Implants

Ø 22	DD	01.00013.104
Ø 28	EE	01.00013.305
	RR	01.00013.318
	SS	01.00013.319
	TT	01.00013.320
Ø 32	RR	01.00013.518
	SS	01.00013.519
	TT	01.00013.520

Cast 1.4.

**CLS® Spotorno®
Hip Stem**

Surgical Technique



CLS Spotorno Stem

The tapered shape of the stem enables excellent primary stability and ensures that this stability is maintained thanks to the self-stabilizing properties of the implant. In addition, the structure of the bone surrounding the prosthesis shows that the tapered shape of the implant favours a largely proximal transfer of load.

As the CCD angle is not a constant value, and shows broad variability in individuals, the *CLS* stem offers three different CCD angles. This provides a wide range of offset options, which allows an adequate restoration of the biomechanical parameters, such as the center of rotation, the CCD angle as well as leg length and soft tissue balancing.

For implantation of the *CLS* 145°, the *CLS* 135° and the *CLS* 125°, the same instruments and the same surgical technique are used. The modular rasps and trial necks serve the intraoperative trial reduction.



Implants



CLS® Spotorno® 145° Stem



CLS® Spotorno® 135° Stem



CLS® Spotorno® 125° Stem




CLS® Spotorno® 145° HAC Stem

Details
Protasul®-100
Uncemented
L. Spotorno




STERILE R

Details
Protasul®-100
Uncemented
L. Spotorno




STERILE R

Details
Protasul®-100
Uncemented
L. Spotorno



STERILE R

Details
Protasul®-100/HAC
Uncemented
L. Spotorno



STERILE R

size in mm	REF	size in mm	REF	size in mm	REF	size in mm	REF
5.00	29.00.09-050	5.00	29.00.39-050	5.00	01.00295.005	5.00	29.00.59-050
6.00	29.00.09-060	6.00	29.00.39-060	6.00	01.00295.006	6.00	29.00.59-060
7.00	29.00.09-070	7.00	29.00.39-070	7.00	01.00295.007	7.00	29.00.59-070
8.00	29.00.09-080	8.00	29.00.39-080	8.00	01.00295.008	8.00	29.00.59-080
9.00	29.00.09-090	9.00	29.00.39-090	9.00	01.00295.009	9.00	29.00.59-090
10.00	29.00.09-100	10.00	29.00.39-100	10.00	01.00295.010	10.00	29.00.59-100
11.25	29.00.09-112	11.25	29.00.39-112	11.25	01.00295.011	11.25	29.00.59-112
12.50	29.00.09-125	12.50	29.00.39-125	12.50	01.00295.012	12.50	29.00.59-125
13.75	29.00.09-137	13.75	29.00.39-137	13.75	01.00295.013	13.75	29.00.59-137
15.00	29.00.09-150	15.00	29.00.39-150	15.00	01.00295.015	15.00	29.00.59-150
16.25	29.00.09-162	16.25	29.00.39-162	16.25	01.00295.016	16.25	29.00.59-162
17.50	29.00.09-175	17.50	29.00.39-175	17.50	01.00295.017	17.50	29.00.59-175
20.00	29.00.09-200	20.00	29.00.39-200	20.00	01.00295.020	20.00	29.00.59-200

Příloha č.2 - Ceník zboží

1. Cementovaná náhrada kyčelního kloubu s rovným dřikem neleštěným - předpokládaný odběr 42 ks/rok, 168 ks/4roky

Sestava celkem v Kč bez DPH	8 030,00	9 234,50
Celkem za 1 rok v Kč bez DPH	337 260,00	387 849,00
Celkem za 4 roky v Kč bez DPH	1 349 040,00	1 551 396,00

3. Hybridní náhrada kyčelního kloubu - předpokládaný odběr 20 ks/rok, 80 ks/4roky

Sestava celkem v Kč bez DPH	15 730,00	18 089,50
Celkem za 1 rok v Kč bez DPH	314 600,00	361 790,00
Celkem za 4 roky v Kč bez DPH	1 258 400,00	1 447 160,00

4. Necementovaná náhrada kyčelního kloubu typ pressfit - předpokládaný odběr 73 ks/rok, 292 ks/4roky

Sestava celkem v Kč bez DPH	29 470,00	33 890,50
Celkem za 1 rok v Kč bez DPH	2 151 310,00	2 474 006,50
Celkem za 4 roky v Kč bez DPH	8 605 240,00	9 896 026,00

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Jednotlivé velikosti	Katalogové číslo	Kód VZP	Obchodní označení	Cena za kus bez DPH	DPH v %	Cena za kus vč. DPH
1. Cementovaná náhrada kyčelního kloubu s rovným dříkem neleštěným - předpokládaný odběr 42 ks/rok, 168 ks/4roky						
42	63.28.42	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
44	63.28.44	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
46	63.28.46	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
48	63.28.48	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
50	63.28.50	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
52	63.28.52	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
54	63.28.54	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
56	63.28.56	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
58	63.28.58	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
60	63.28.60	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
62	63.28.62	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
64	63.28.64	0024666	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 28	1 400,00	15	1 610,00
44	63.32.44	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
46	63.32.46	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
48	63.32.48	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
50	63.32.50	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
52	63.32.52	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
54	63.32.54	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
56	63.32.56	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
58	63.32.58	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
60	63.32.60	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
62	63.32.62	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00
64	63.32.64	0024667	Cementovaná jamka Originál M.E.Müller 32	1 400,00	15	1 610,00



S	00-8018-028-01	0070998	VERSYS hlavice kovová - 3.5 X 28	2 500,00	15	2 875,00
M	00-8018-028-02	0070998	VERSYS hlavice kovová 0 X 28 DIA	2 500,00	15	2 875,00
L	00-8018-028-03	0070998	VERSYS hlavice kovová + 3.5 X 28	2 500,00	15	2 875,00
XXL	00-8018-028-05	0070998	VERSYS hlavice kovová + 10.5 X 28	2 500,00	15	2 875,00
XL	00-8018-028-14	0070998	VERSYS hlavice kovová +7X28MM DIA	2 500,00	15	2 875,00
S	00-8018-032-01	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová -3.5X 32	2 500,00	15	2 875,00
M	00-8018-032-02	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová 0X 32	2 500,00	15	2 875,00
L	00-8018-032-03	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +3.5X 32	2 500,00	15	2 875,00
XXL	00-8018-032-05	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +10.5X 32	2 500,00	15	2 875,00
XL	00-8018-032-14	0070999	VERSYS hlavice kovová +7X 32	2 500,00	15	2 875,00
S	00-8018-036-01	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová -3.5X 36	2 500,00	15	2 875,00
M	00-8018-036-02	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová 0X 36	2 500,00	15	2 875,00
L	00-8018-036-03	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +3.5X 36	2 500,00	15	2 875,00
XXL	00-8018-036-04	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +10.5X 36	2 500,00	15	2 875,00
XL	00-8018-036-05	0070999	VERSYS hlavice kovová +7X 36	2 500,00	15	2 875,00
7,5	35.00.29-075	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 7,5 12/14	4 130,00	15	4 749,50
8,75	05.95001.066	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 8,75 12/14	4 130,00	15	4 749,50
10	35.00.29-100	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 10 12/14	4 130,00	15	4 749,50
11,25	35.00.29-112	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 11,25 12/14	4 130,00	15	4 749,50
12,5	35.00.29-125	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 12,5 12/14	4 130,00	15	4 749,50
13,75	35.00.29-137	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 13,75 12/14	4 130,00	15	4 749,50
15	35.00.29-150	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 15 12/14	4 130,00	15	4 749,50
16,25	35.00.29-162	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 16,25 12/14	4 130,00	15	4 749,50
17,5	35.00.29-175	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 17,5 12/14	4 130,00	15	4 749,50

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

7,5	35.00.39-075	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 7,5 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
8,75	05.95001.067	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 8,75 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
10	35.00.39-100	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 10 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
11,25	35.00.39-112	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 11,25 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
12,5	35.00.39-125	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 12,5 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
13,75	35.00.39-137	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 13,75 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
15	35.00.39-150	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 15 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
16,25	35.00.39-162	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 16,25 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
17,5	35.00.39-175	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 17,5 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
Sestava celkem				8 030,00		9 234,50
Celkem za 1 rok				337 260,00		387 849,00
Celkem za 4 roky				1 349 040,00		1 551 396,00

Jednotlivé velikosti	Katalogové číslo	Kód VZP	Obchodní označení	Cena za kus bez DPH	DPH v %	Cena za kus včetně DPH
3. Hybridní náhrada kyčelního kloubu - předpokládaný odběr 20 ks/rok, 80 ks/4roky						
42	4240	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 42/DD	7 000,00	15	8 050,00
44	4241	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 44/EE	7 000,00	15	8 050,00
46	4242	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 46/FF	7 000,00	15	8 050,00
48	4243	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 48/GG	7 000,00	15	8 050,00
50	4244	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 50/HH	7 000,00	15	8 050,00
52	4245	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 52/II	7 000,00	15	8 050,00
54	4246	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 54/JJ	7 000,00	15	8 050,00



56	4247	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 56/KK	7 000,00	15	8 050,00
58	4248	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 58/LL	7 000,00	15	8 050,00
60	4249	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 60/MM	7 000,00	15	8 050,00
62	4250	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 62/NN	7 000,00	15	8 050,00
64	4251	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 64/OO	7 000,00	15	8 050,00
42	4260	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 42/DD	7 000,00	15	8 050,00
44	4261	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 44/EE	7 000,00	15	8 050,00
46	4262	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 46/FF	7 000,00	15	8 050,00
48	4263	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 48/GG	7 000,00	15	8 050,00
50	4264	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 50/HH	7 000,00	15	8 050,00
52	4265	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 52/II	7 000,00	15	8 050,00
54	4266	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 54/JJ	7 000,00	15	8 050,00
56	4267	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 56/KK	7 000,00	15	8 050,00
58	4268	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 58/LL	7 000,00	15	8 050,00
60	4269	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 60/MM	7 000,00	15	8 050,00
62	4270	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 62/NN	7 000,00	15	8 050,00
64	4271	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 64/OO	7 000,00	15	8 050,00
66	4272	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 66/PP	7 000,00	15	8 050,00
68	4273	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 68/QU	7 000,00	15	8 050,00
70	4274	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 70/RR	7 000,00	15	8 050,00
72	4275	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 72/SS	7 000,00	15	8 050,00
74	4276	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 74/TT	7 000,00	15	8 050,00
42	01.00010.104	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha hooded DD 22	2 100,00	15	2 415,00
44	01.00010.105	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha hooded EE 22	2 100,00	15	2 415,00
46	01.00010.206	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha FF 28	2 100,00	15	2 415,00

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

48	01.00010.207	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha GG 28	2 100,00	15	2 415,00
50	01.00010.208	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha HH 28	2 100,00	15	2 415,00
52	01.00010.209	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha II 28	2 100,00	15	2 415,00
54	01.00010.210	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha JJ 28	2 100,00	15	2 415,00
56	01.00010.211	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha KK 28	2 100,00	15	2 415,00
58	01.00010.212	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha LL 28	2 100,00	15	2 415,00
60	01.00010.213	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha MM 28	2 100,00	15	2 415,00
62	01.00010.214	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha NN 28	2 100,00	15	2 415,00
64	01.00010.215	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha OO 28	2 100,00	15	2 415,00
66	01.00010.216	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha PP 28	2 100,00	15	2 415,00
68	01.00010.217	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha QU 28	2 100,00	15	2 415,00
46	01.00010.306	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded FF 28	2 100,00	15	2 415,00
48	01.00010.307	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded GG 28	2 100,00	15	2 415,00
50	01.00010.308	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded HH 28	2 100,00	15	2 415,00
52	01.00010.309	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded II 28	2 100,00	15	2 415,00
54	01.00010.310	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded JJ 28	2 100,00	15	2 415,00
56	01.00010.311	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded KK 28	2 100,00	15	2 415,00
58	01.00010.312	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded LL 28	2 100,00	15	2 415,00
60	01.00010.313	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded MM 28	2 100,00	15	2 415,00
62	01.00010.314	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded NN 28	2 100,00	15	2 415,00
64	01.00010.315	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded OO 28	2 100,00	15	2 415,00
66	01.00010.316	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded PP 28	2 100,00	15	2 415,00
68	01.00010.317	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded QU 28	2 100,00	15	2 415,00
52	01.00010.809	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded II 32	2 100,00	15	2 415,00
54	01.00010.810	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded JJ 32	2 100,00	15	2 415,00
56	01.00010.811	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded KK 32	2 100,00	15	2 415,00

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

58	01.00010.812	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded LL 32	2 100,00	15	2 415,00
60	01.00010.813	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded MM 32	2 100,00	15	2 415,00
62	01.00010.814	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded NN 32	2 100,00	15	2 415,00
64	01.00010.815	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded OO 32	2 100,00	15	2 415,00
66	01.00010.816	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded PP 32	2 100,00	15	2 415,00
68	01.00010.817	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded QU 32	2 100,00	15	2 415,00
S	00-8018-028-01	0070998	VERSYS hlavice kovová - 3.5 X 28	2 500,00	15	2 875,00
M	00-8018-028-02	0070998	VERSYS hlavice kovová 0 X 28 DIA	2 500,00	15	2 875,00
L	00-8018-028-03	0070998	VERSYS hlavice kovová + 3.5 X 28	2 500,00	15	2 875,00
XXL	00-8018-028-05	0070998	VERSYS hlavice kovová + 10.5 X 28	2 500,00	15	2 875,00
XL	00-8018-028-14	0070998	VERSYS hlavice kovová +7X28MM DIA	2 500,00	15	2 875,00
S	00-8018-032-01	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová -3.5X 32	2 500,00	15	2 875,00
M	00-8018-032-02	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová 0X 32	2 500,00	15	2 875,00
L	00-8018-032-03	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +3.5X 32	2 500,00	15	2 875,00
XXL	00-8018-032-05	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +10.5X 32	2 500,00	15	2 875,00
XL	00-8018-032-14	0070999	VERSYS hlavice kovová +7X 32	2 500,00	15	2 875,00
S	00-8018-036-01	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová -3.5X 36	2 500,00	15	2 875,00
M	00-8018-036-02	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová 0X 36	2 500,00	15	2 875,00
L	00-8018-036-03	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +3.5X 36	2 500,00	15	2 875,00
XXL	00-8018-036-04	0070999	VERSYS 12/14 hlavice kovová +10.5X 36	2 500,00	15	2 875,00
XL	00-8018-036-05	0070999	VERSYS hlavice kovová +7X 36	2 500,00	15	2 875,00
7,5	35.00.29-075	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 7,5 12/14	4 130,00	15	4 749,50
8,75	05.95001.066	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 8,75 12/14	4 130,00	15	4 749,50
10	35.00.29-100	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 10 12/14	4 130,00	15	4 749,50

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

11,25	35.00.29-112	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 11,25 12/14	4 130,00	15	4 749,50
12,5	35.00.29-125	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 12,5 12/14	4 130,00	15	4 749,50
13,75	35.00.29-137	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 13,75 12/14	4 130,00	15	4 749,50
15	35.00.29-150	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 15 12/14	4 130,00	15	4 749,50
16,25	35.00.29-162	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 16,25 12/14	4 130,00	15	4 749,50
17,5	35.00.29-175	0071641	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 17,5 12/14	4 130,00	15	4 749,50
7,5	35.00.39-075	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 7,5 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
8,75	05.95001.067	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 8,75 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
10	35.00.39-100	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 10 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
11,25	35.00.39-112	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 11,25 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
12,5	35.00.39-125	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 12,5 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
13,75	35.00.39-137	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 13,75 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
15	35.00.39-150	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 15 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
16,25	35.00.39-162	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 16,25 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
17,5	35.00.39-175	0075214	Cementovaný dřík Orig. M.E.Müller 17,5 12/14 - lateral	4 130,00	15	4 749,50
Sestava celkem				15 730,00		18 089,50
Celkem za 1 rok				314 600,00		361 790,00
Celkem za 4 roky				1 258 400,00		1 447 160,00

Jednotlivé velikosti	Katalogové číslo	Kód VZP	Obchodní označení	Cena za kus bez DPH	DPH v %	Cena za kus včetně DPH
4. Necementovaná náhrada kyčelního kloubu typ pressfit - předpokládaný odběr 73 ks/rok, 292 ks/4roky						
42	4240*	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 42/DD	7 000,00	15	8 050,00

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

44	4241*	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 44/EE	7 000,00	15	8 050,00
46	4242	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 46/FF	7 000,00	15	8 050,00
48	4243	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 48/GG	7 000,00	15	8 050,00
50	4244	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 50/HH	7 000,00	15	8 050,00
52	4245	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 52/II	7 000,00	15	8 050,00
54	4246	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 54/JJ	7 000,00	15	8 050,00
56	4247	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 56/KK	7 000,00	15	8 050,00
58	4248	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 58/LL	7 000,00	15	8 050,00
60	4249	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 60/MM	7 000,00	15	8 050,00
62	4250	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 62/NN	7 000,00	15	8 050,00
64	4251	0071867	Necementovaná jamka Allofit® Shell 64/OO	7 000,00	15	8 050,00
42	4260*	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 42/DD	7 000,00	15	8 050,00
44	4261*	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 44/EE	7 000,00	15	8 050,00
46	4262	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 46/FF	7 000,00	15	8 050,00
48	4263	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 48/GG	7 000,00	15	8 050,00
50	4264	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 50/HH	7 000,00	15	8 050,00
52	4265	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 52/II	7 000,00	15	8 050,00
54	4266	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 54/JJ	7 000,00	15	8 050,00
56	4267	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 56/KK	7 000,00	15	8 050,00
58	4268	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 58/LL	7 000,00	15	8 050,00
60	4269	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 60/MM	7 000,00	15	8 050,00
62	4270	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 62/NN	7 000,00	15	8 050,00
64	4271	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 64/OO	7 000,00	15	8 050,00
66	4272	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 66/PP	7 000,00	15	8 050,00
68	4273	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 68/QU	7 000,00	15	8 050,00
70	4274*	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 70/RR	7 000,00	15	8 050,00
72	4275*	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 72/SS	7 000,00	15	8 050,00

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

74	4276*	0071868	Necementovaná jamka s otvory Allofit®-S Shell 74/TT	7 000,00	15	8 050,00
42	01.00010.104	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded DD 22	2 100,00	15	2 415,00
44	01.00010.105	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded EE 22	2 100,00	15	2 415,00
46	01.00010.206	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha FF 28	2 100,00	15	2 415,00
48	01.00010.207	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha GG 28	2 100,00	15	2 415,00
50	01.00010.208	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha HH 28	2 100,00	15	2 415,00
52	01.00010.209	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha II 28	2 100,00	15	2 415,00
54	01.00010.210	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha JJ 28	2 100,00	15	2 415,00
56	01.00010.211	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha KK 28	2 100,00	15	2 415,00
58	01.00010.212	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha LL 28	2 100,00	15	2 415,00
60	01.00010.213	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha MM 28	2 100,00	15	2 415,00
62	01.00010.214	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha NN 28	2 100,00	15	2 415,00
64	01.00010.215	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha OO 28	2 100,00	15	2 415,00
66	01.00010.216	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha PP 28	2 100,00	15	2 415,00
68	01.00010.217	0071871	Vložka Sulene® PE Alpha QU 28	2 100,00	15	2 415,00
46	01.00010.306	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded FF 28	2 100,00	15	2 415,00
48	01.00010.307	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded GG 28	2 100,00	15	2 415,00
50	01.00010.308	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded HH 28	2 100,00	15	2 415,00
52	01.00010.309	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded II 28	2 100,00	15	2 415,00
54	01.00010.310	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded JJ 28	2 100,00	15	2 415,00
56	01.00010.311	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded KK 28	2 100,00	15	2 415,00
58	01.00010.312	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded LL 28	2 100,00	15	2 415,00
60	01.00010.313	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded MM 28	2 100,00	15	2 415,00
62	01.00010.314	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded NN 28	2 100,00	15	2 415,00
64	01.00010.315	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded OO 28	2 100,00	15	2 415,00

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

66	01.00010.316	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded PP 28	2 100,00	15	2 415,00
68	01.00010.317	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded QU 28	2 100,00	15	2 415,00
52	01.00010.809	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded II 32	2 100,00	15	2 415,00
54	01.00010.810	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded JJ 32	2 100,00	15	2 415,00
56	01.00010.811	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded KK 32	2 100,00	15	2 415,00
58	01.00010.812	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded LL 32	2 100,00	15	2 415,00
60	01.00010.813	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded MM 32	2 100,00	15	2 415,00
62	01.00010.814	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded NN 32	2 100,00	15	2 415,00
64	01.00010.815	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded OO 32	2 100,00	15	2 415,00
66	01.00010.816	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded PP 32	2 100,00	15	2 415,00
68	01.00010.817	0071872	Vložka Sulene® PE Alpha hooded QU 32	2 100,00	15	2 415,00
S	17.28.05	0071642	Hlavičky 'SULOX' keramická 28 S	3 920,00	15	4 508,00
M	17.28.06	0071642	Hlavičky 'SULOX' keramická 28 M	3 920,00	15	4 508,00
L	17.28.07	0071642	Hlavičky 'SULOX' keramická 28 L	3 920,00	15	4 508,00
S	17.32.05	0071642	Hlavičky 'SULOX' keramická 32 S	3 920,00	15	4 508,00
M	17.32.06	0071642	Hlavičky 'SULOX' keramická 32 M	3 920,00	15	4 508,00
L	17.32.07	0071642	Hlavičky 'SULOX' keramická 32 L	3 920,00	15	4 508,00
5	29.00.39-050	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 5.0	16 450,00	15	18 917,50
6	29.00.39-060	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 6.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
7	29.00.39-070	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 7.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
8	29.00.39-080	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 8.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
9	29.00.39-090	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 9.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
10	29.00.39-100	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 10.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
11,25	29.00.39-112	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 11.25 12/14	16 450,00	15	18 917,50

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

12,5	29.00.39-125	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 12.5 12/14	16 450,00	15	18 917,50
13,75	29.00.39-137	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 13.75 12/14	16 450,00	15	18 917,50
15	29.00.39-150	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 15.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
16,25	29.00.39-162	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 16.25 12/14	16 450,00	15	18 917,50
17,5	29.00.39-175	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 135DEG 17.5 12/14	16 450,00	15	18 917,50
5	29.00.09-050	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 5.0	16 450,00	15	18 917,50
6	29.00.09-060	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 6.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
7	29.00.09-070	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 7.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
8	29.00.09-080	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 8.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
9	29.00.09-090	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 9.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
10	29.00.09-100	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 10.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
11,25	29.00.09-112	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 11.25 12/14	16 450,00	15	18 917,50
12,5	29.00.09-125	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 12.5 12/14	16 450,00	15	18 917,50
13,75	29.00.09-137	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 13.75 12/14	16 450,00	15	18 917,50
15	29.00.09-150	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 15.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
16,25	29.00.09-162	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 16.25 12/14	16 450,00	15	18 917,50
17,5	29.00.09-175	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 145 17.5 12/14	16 450,00	15	18 917,50
5	01.00295.005	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 5.0	16 450,00	15	18 917,50
6	01.00295.006	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 6.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
7	01.00295.007	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 7.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
8	01.00295.008	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 8.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
9	01.00295.009	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 9.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
10	01.00295.010	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 10.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
11,25	01.00295.011	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 11.25 12/14	16 450,00	15	18 917,50
12,5	01.00295.012	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 12.5 12/14	16 450,00	15	18 917,50
13,75	01.00295.013	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 13.75 12/14	16 450,00	15	18 917,50

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

15	01.00295.015	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 15.0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
16,25	01.00295.016	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 16.25 12/14	16 450,00	15	18 917,50
17,5	01.00295.017	0003857	Necementovaný dřík CLS Spotorno 125DEG 17.5 12/14	16 450,00	15	18 917,50
0	01.00121.000	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 0	16 450,00	15	18 917,50
01	01.00121.001	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 01	16 450,00	15	18 917,50
1	01.00121.010	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 1	16 450,00	15	18 917,50
2	01.00121.020	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 2	16 450,00	15	18 917,50
3	01.00121.030	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 3	16 450,00	15	18 917,50
4	01.00121.040	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 4	16 450,00	15	18 917,50
5	01.00121.050	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 5	16 450,00	15	18 917,50
6	01.00121.060	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 6	16 450,00	15	18 917,50
7	01.00121.070	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 7	16 450,00	15	18 917,50
8	01.00121.080	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 8	16 450,00	15	18 917,50
9	01.00121.090	0098842	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SLO 9	16 450,00	15	18 917,50
0	2839	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 01 12/14	16 450,00	15	18 917,50
01	2840	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 0 12/14	16 450,00	15	18 917,50
1	2841	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 1 12/14	16 450,00	15	18 917,50
2	2841	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 1 12/14	16 450,00	15	18 917,50
3	2842	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 2 12/14	16 450,00	15	18 917,50
4	2843	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 3 12/14	16 450,00	15	18 917,50
5	2844	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 4 12/14	16 450,00	15	18 917,50
6	2846	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 6 12/14	16 450,00	15	18 917,50
7	2847	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 7 12/14	16 450,00	15	18 917,50
8	2848	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 8 12/14	16 450,00	15	18 917,50
9	2849	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 9 12/14	16 450,00	15	18 917,50
10	2850	0010851	Necementovaný dřík Alloclassic Zweymuller SL 10 12/14	16 450,00	15	18 917,50

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Sestava celkem	29 470,00	33 890,50
Celkem za 1 rok	2 151 310,00	2 474 006,50
Celkem za 4 roky	8 605 240,00	9 896 026,00

Pojistná smlouva

Číslo: CZCANA16680 - 117

Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku

CHUBB

Pojistitel:

Chubb European Group Limited,

se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, Spojené království, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby **Chubb European Group Limited, organizační složka**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27893723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233

zastoupen Erikem Macalíkem, vedoucím odštěpného závodu

dále jen „pojistitel“ na straně jedné

Pojistník:

Zimmer Czech, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 25107976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50253

zastoupen

dále jen „pojistník“ na straně druhé

tímto uzavírají pojistnou smlouvu. Pojistitel se zavazuje v případě vzniku pojistné události vymezené touto pojistnou smlouvou poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistník akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu, tzn. přijetí tohoto návrhu s odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je podle pojistných podmínek vyloučeno a za akceptaci této pojistné smlouvy se tedy nepovažuje. Za akceptaci této pojistné smlouvy se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí jejího návrhu anebo chování ve shodě s nabídkou bez její písemné akceptace s následující výjimkou. Za přijetí návrhu této pojistné smlouvy pojistníkem se však považuje včasné zaplacení pojistného podle § 2759 odst. 1 občanského zákoníku.

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Pojištění je sjednáno prostřednictvím a na základě informací poskytnutých pojišťovacím zprostředkovatelem **MARSH, s.r.o.**, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ 45306541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7847.

Pojištěný (firma/název, sídlo, IČ)	Zimmer Czech, s.r.o. , se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 25107976
Podnikatelská činnost pojištěného	dle Výpisu z Obchodního rejstříku, který je uveden v příloze
Územní rozsah pojištění	Evropa
Volba "Claims Made"	Nesjednává se
Datum a čas vzniku pojištění	01.10.2017 0:00
Pojistná doba	01.10.2017 - 30.09.2018
Limit pojistného plnění	US\$ 1.000.000 za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu
Sub-limit: Křížová odpovědnost	Do výše limitu
Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku	Do výše limitu
Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného	Do výše limitu
Sub-limit: Ochrana osobních údajů	Nesjednává se
Sub-limit: Náklady na obranu v trestním řízení	Nesjednává se
Sub-limit: Osobní odpovědnost při zahraniční cestě	Nesjednává se
Sub-limit: Povinnost k náhradě újmy prodejců	Nesjednává se
Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům	Do výše limitu
Sub-limit: Stažení výrobku z trhu	Nesjednává se
Sub-limit: Škody v důsledku znečištění životního prostředí	Nesjednává se
Sub-limit: Čistá finanční škoda	Nesjednává se
Sub-limit: Montáž a demontáž	Nesjednává se
Sub-limit: Převzaté věci	Nesjednává se
Spoluúčast	US\$ 0
Pojistné	US\$ 2.931 splatné centrálně
Druh pojistného	Jednorázové pojistné

Součástí této pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti verze 6/2015. Tyto podmínky mají přednost před zákonnými ustanoveními, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi touto pojistnou smlouvou a uvedenými pojistnými podmínkami mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy.

Závěrečná ujednání

Pojmy použité v této pojistné smlouvě mají stejný význam jako pojmy definované v pojistných podmínkách.

Pojistník stvrzuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami a měl je i text této pojistné smlouvy možnost prostudovat, rozumí jim a souhlasí s nimi.



Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1. Dodatky k pojistným podmínkám
2. Podmínky Pojištění odpovědnosti
3. Výpis pojistníka z obchodního rejstříku

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, odštěpný závod zahraniční právnické osoby Chubb European Group Limited, se sídlem Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká Británie, registrační číslo 01112892, oprávněné k podnikání a regulované Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie.