

Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje

Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Závazné obchodní a smluvní podmínky
Část 6 – Infuzní technika pro oddělení ARO, JIP interních a chirurgických oborů

KUPNÍ SMLOUVA OVZ 1121/2017

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Kupující:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Sídlo:	Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
Zapsána:	v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466
Zastoupená:	Ing. Janem Mlčákem, MBA, ředitelem
IČO:	00511951
DIČ:	CZ00511951
Kontaktní osoba:	Petr Adam, náměstek HTS
Telefon:	731 619 138
E-mail:	padam@nempe.cz

dále jen „Kupující“

a

Prodávající:	B. Braun Medical s.r.o.
Sídlo:	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
Zastoupená:	PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel společnosti
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudem v Praze, oddíl C, vložka 17893
IČO:	48586285
DIČ:	CZ48586285
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
Číslo účtu:	515293-009/2700
Zmocnění:	
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Hořák
Telefon:	+420-602 447 229
E-mail:	petr.horak@bbraun.com

dále jen „Prodávající“

II.

PREAMBULE

- 2.1 Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zdravotnické přístroje“ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla pro část 6 veřejné zakázky – Infuzní technika pro oddělení ARO, JIP interních a chirurgických oborů jako nejvýhodnější vybrána nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka“).

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat nové přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky Prodávajícího (dále jen „přístroje“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístrojům, a dále závazek Prodávajícího:

- provést instalaci nových přístrojů a uvést je do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení a komunikací systému s ostatními modalitami,
- zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení dle § 45 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a provést zaškolení obsluhy u všech Kupujícím určených pracovníků (cca 40 osob),
- realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,
- zajistit přejímací zkoušky přístrojů dle právních předpisů platných a účinných v době instalace,
- provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku Prodávajícího.

- 3.2 Spolu s přístroji je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré doklady, které jsou potřebné k používání přístrojů, jejich součástí a příslušenství a které osvědčují splnění právních a technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné, tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroje, tak pro jejich příslušenství, pokud je Prodávající Kupujícímu nepředložil již před uzavřením této smlouvy.

IV.

KUPNÍ CENA

- 4.1 Kupující zaplatí Prodávajícímu za splnění předmětu smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.
- 4.2 Kupní cena za splnění předmětu smlouvy činí 7 323 314,75,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za splnění předmětu smlouvy včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy 8 861 210,85, Kč.
- 4.3 Kupní cena za splnění předmětu smlouvy je cena konečná, je v ní zahrnuta cena za veškeré dodávky, práce, služby, licence, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění, k jeho uvedení do řádného provozu a veškeré další náklady Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky, aj.).
- 4.4 Kupní cena je maximální a nepřekročitelná a její změna je možná jen v případech uvedených v čl. V. této smlouvy.
- 4.5 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

V.**ÚPRAVA CENY**

- 5.1 Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy jen v případě, pokud dojde v Době plnění předmětu smlouvy ke změnám v ČR platných předpisů pro účtování cla a DPH, které se prokazatelně týkají předmětu smlouvy.
- 5.2 V případě nerealizace některé části plnění Prodávajícího dle této smlouvy bude kupní cena poměrně snížena.

VI.**PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

- 6.1 Cena za plnění dle této smlouvy bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura předložená Kupujícím bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícím.
- 6.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu – faktury podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.3 Součástí faktury bude údaj o zařazení zboží do třídy zdravotnických prostředků. Každá faktura musí být Prodávajícím označena číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404 – Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky.
- 6.4 Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Kupující oprávněn vrátit Prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Kupující v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.
- 6.5 Cena za plnění této smlouvy bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícím.

VII.**MÍSTO PLNĚNÍ**

- 7.1 Předmět smlouvy bude dodán a instalován na ARO, interní JIP, chirurgické JIP a operačních sálech v sídle kupujícího na adrese Nemocnice Pelhřimov příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, a předán pracovníkům Kupujícího.
- 7.2 Kontaktní osoba Kupujícího: Petr Adam, náměstek HTS, tel: 731 619 138, e-mail: padam@nempe.cz.
- 7.3 Kontaktní osoba Prodávajícího: Ing. Petr Hořák, Mobil +420-602 447 229, e-mail: petr.horak@bbraun.com

VIII.**DOBA PLNĚNÍ**

- 8.1 Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroje nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této kupní smlouvy.
- 8.2 Přístroje budou dodány včas, pokud budou řádně předány Kupujícím v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávanému zařízení vztahují. Předání bude potvrzeno podpisem předávajícího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3 Pokud přístroje nebudou dodány včas prokazatelným účinkem vyšší moci, bude doba plnění odpovídajícím způsobem prodloužena.

IX.**DODÁNÍ A INSTALACE**

- 9.1 Přístroje budou dodány a instalovány Prodávajícím do místa plnění dle čl. VII. této smlouvy. Prodávající bude Kupujícím avizovat dodání přístrojů na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny

ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.

- 9.2 Prodávající bude provádět instalaci přístrojů v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostor jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.
- 9.3 Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

X.

SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 10.1 Po skončení instalace Prodávající označí přístroje za provozuschopné. Poté Prodávající provede zaškolení personálu Kupujícího v jejich používání v předepsaném rozsahu, oznámí Kupujícímu připravenost k předání přístrojů a navrhne termín předání.
- 10.2 Dojde-li před předáním či v průběhu předání přístrojů Kupujícímu ke zjištění, že kterýkoliv z přístrojů není dodán v souladu s touto smlouvou, odstraní Prodávající případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady do 2 dnů, bude-li to možné, ode dne, kdy se o nich dozvěděl, a zopakuje funkční zkoušku. Pokud se ukáže, že původně zjištěná závada trvá, vymění Prodávající defektní díl a provede funkční zkoušku znovu.
- 10.3 Po úspěšném provedení funkční zkoušky se uskuteční předání a převzetí přístrojů formou předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Podepsáním předávacího protokolu se má za to, že povinnosti Prodávajícího z této smlouvy byly splněny. Nepodepíše-li Kupující předávací protokol, ačkoliv na přístrojích a jejich funkčnosti nejsou zjištěny žádné závady, respektive jsou zjištěny závady, které nebrání jejich řádnému užívání (ty je Prodávající povinen následně odstranit, nese-li za ně odpovědnost), a jsou doloženy všechny požadované doklady, má se za to, že předávací protokol byl oboustranně podepsán dnem provedení funkční zkoušky. Totéž také platí, pokud Kupující není přítomen při provedení funkční zkoušky a na následek své nepřítomnosti byl písemně upozorněn.
- 10.4 Prodávající bere na vědomí, že v případě, že po uzavření této smlouvy Kupující zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Prodávající před jejím uzavřením předložil Kupujícímu údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele v zadávacím řízení, Kupující může v souladu s ust. § 223 odst. 2 písm. b) zákona o ZVZ svůj závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit. Náhrada škody, kterou takovým jednáním Prodávající Kupujícímu způsobil, bude řešena samostatně.
- 10.5 Přístroje nesmí být používány před jejich předáním bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího ani Kupujícím ani třetí osobou. Kupující ručí Prodávajícímu za škody, které případným neoprávněným používáním vzniknou.

XI.

PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE

- 11.1 V případě, že Prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím Prodávající prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je Prodávající povinen Kupujícímu před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
- 11.2 Kupující doklady předložené dle čl. 11.1 bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Prodávající oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
- 11.3 Prodávající není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

XII.

KONZULTACE

- 12.1 Smluvní strany si budou vzájemně předávat informace nezbytné k realizaci této smlouvy.

XIII.

ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA

- 13.1 Prodávající se zavazuje po dobu 24 měsíců od převzetí přístrojů podle čl. X. Kupujícího informovat o dalším vývoji zařízení tohoto druhu a na jeho žádost za úhradu na přístrojích uskutečnit změny, které by sloužily k rozšíření anebo zlepšení jejich výkonu.

XIV.

ZÁRUKA A SERVIS

- 14.1 Prodávající poskytuje na nové přístroje záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne převzetí dodávky Kupujícím, dle čl. 10.3. Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu dodávky Kupujícím nebo třetí stranou, škodní události nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícím, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, místem jeho používání, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak), na vady způsobené nesprávným připojením do elektrické, počítačové, internetové či jiné sítě a na vady, které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku. Vady zjištěné v průběhu záruční lhůty musí být neprodleně reklamovány a to telefonicky, e-mailem nebo faxem a Prodávající musí mít možnost oprávněnost reklamacie ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Na opravený či vyměněný komponent běží nová záruka v délce min. 6 měsíců, jež však neskončí dříve, nežli záruka na celý přístroj. Je na volbě Prodávajícího, zda vadu, na kterou se vztahuje záruka, odstraní nebo jeho vadnou část/přístroj vymění za jinou/jiný. Toliko v takovém rozsahu jsou i nároky Kupujícího z vad přístroje, které se vyskytnou v záruční době. Dále může být mezi smluvními stranami sjednána v důsledku vady sleva z kupní ceny. V případě výměny nabývá Prodávající vlastnické právo k vyměňovanému přístroji či jeho části okamžikem poskytnutí náhradního přístroje/jeho části Kupujícím, pokud nebyl jejich vlastníkem i v této době.
- 14.2 Pro náhradní díly a spotřební části je záruční doba 6 měsíců.
- 14.3 Závady musí být Prodávajícímu neprodleně oznámeny dopisem, e-mailem anebo faxem, ihned po jejich zjištění. Převzetí reklamacie potvrdí písemně Prodávající Kupujícím ve lhůtě 24 hodin od jejich obdržení.
- 14.4 V rámci záruční doby dle čl. 14.1 smlouvy Prodávající poskytne Kupujícím v Kupní ceně plný (full) záruční servis přístrojů, včetně dodání případných náhradních dílů. Záruční servis zahrnuje provádění veškerých pro daný přístroj a jeho příslušenství relevantních kalibračních prohlídek, předepsaných prohlídek vyplývajících z požadavků výrobce, bezpečnostně technických kontrol, elektro revizí, validací, preventivních údržbových prací, a to včetně dodání a výměny opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí přístrojů (náhradní díly).
- 14.5 Prodávající je povinen zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady. Pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 – 17.00 hod.
- Maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:
- bez náhradních dílů – 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,
 - s dodávkou náhradních dílů – 5 pracovních dní od nástupu servisního technika.
- 14.6 Pokud přístroj nemůže být v důsledku závady na straně Prodávajícího v záruční době užíván více než 3 pracovní dny, prodlužuje se záruční lhůta uvedená v čl. 14.1 automaticky o počet dní, po které přístroj nemohl být užíván z důvodu neodstraněné závady.
- 14.7 Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině závady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením závady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalecova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je odpovědná za závadu podle posudku znalce.

XV.

PATENTOVÁ PRÁVA

- 15.1 Prodávající tímto prohlašuje, že předmět dle této smlouvy nemá žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Prohlašuje, že uhradí Kupujícím náklady v případě, že třetí osoba uplatní vůči Kupujícím oprávněné nároky, které vyplývají z patentových anebo jiných právních nároků na předmět této smlouvy. To platí za předpokladu, že Kupující o uplatnění nároku neprodleně Prodávajícího vyrozumí.

XVI.

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICTVÍ

- 16.1 Prodávající nese nebezpečí škody na přístrojích do okamžiku dodání přístrojů do místa plnění a jejich předání Kupujícímu. Od tohoto okamžiku nese nebezpečí škody Kupující.
- 16.2 Kupující nabývá vlastnická práva k přístrojům oboustranným podpisem předávacího protokolu a úplným uhrazením kupní ceny.
- 16.3 Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

XVII.

SANKCE

- 17.1 Ocítne-li se Prodávající v prodlení s plněním dodávky, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z Kupní ceny za každý započatý den prodlení, s výjimkou zdržení způsobených příčinami uvedenými v čl. 8.3.
- 17.2 Při prodlení Kupujícího s placením dle čl. 6.1 je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 17.3 V případě nedodržení termínu odstranění řádně reklamované vady ze strany Prodávajícího má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V jednom kalendářním roce je tolerováno maximálně 15 pracovních dní odstávky, za něž nebude požadováno penále (viz. čl. 14.6).
- 17.4 Kupující je povinen při nedodržení podmínek specifikovaných v čl. 9.2 této smlouvy uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s plněním daných podmínek.
- 17.5 Oprávnění jedné strany je spojeno s povinností druhé strany. Na náhradu škody dle této smlouvy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že smluvní strany se výslovně dohodly, že výše náhrady škody ze strany Prodávajícího se omezuje maximální částkou rovnající se 5% celkové kupní ceny bez DPH.

XVIII.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 18.2 Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů platných v ČR.
- 18.3 V případě, že se v dokladech nebo v technické dokumentaci předané Kupujícím Prodávajícímu vyskytnou vady, musí Prodávající na tuto skutečnost písemně upozornit Kupujícího.
- 18.4 Prodávající je povinen přecházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Kupujícího. Pokud Prodávající poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Kupujícího, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
- 18.5 V rámci plnění předmětu veřejné zakázky musí Prodávající přebrat veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu veřejné zakázky je Prodávající současně povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti musí být obsaženy v nabídkové ceně za předmět plnění.
- 18.6 Prodávající je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.
- 18.7 Prodávající je povinen garantovat na celý předmět plnění autorizovaný servis v ČR, Prodávající doloží doklad prokazující schopnost zajistit a provádět autorizovaný servis, včetně určení konkrétního subjektu, který bude servis provádět.
- 18.8 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatňovány prostřednictvím korespondence doručené do datové schránky nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé smluvní strany.

- 18.9 Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 18.10 Vzhledem k tomu, že Kupující hodlá předmět této smlouvy financovat částečně dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404 – Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky, je Prodávající povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.11 Vzhledem k charakteru organizace Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této kupní smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 18.12 Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 18.13 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 18.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace a rozpočet pro část 6 veřejné zakázky, obsahující podrobné informace o předmětu plnění a cenový rozpočet,
 - technické a katalogové listy jednotlivých přístrojů,
 - Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazoval část kvalifikace.
- 18.15 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Za Prodávajícího:

V Praze, dne

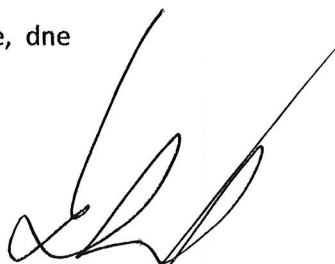

PharmDr. Jiří Lukeš

jednatel společnosti

39

IČ: 405 86 235
DIČ: CZ40586235

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-149 00 Praha 4
Tel: +420-271 031 111
Fax: +420-271 031 112

Za Kupujícího:

V Pelhřimově, dne 15.4.2018

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČ: 001511951

Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel

B BRAUN		JMÉNO	DATUM	PODPIS
SCHVÁLIL	VĚCNĚ	Vojík	20.2.18	
	PRÁVNĚ	ŠÍPSKA	20.2.2018	

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Nabídková cena v Kč bez DPH
6	Infuzní technika pro oddělení ARO, JIP interních a chirurgických oborů	7 323 314,75,-

Předmět plnění	počet ks	cena v Kč bez DPH
A. Modulární infuzní systém (infuzní pumpy a dokovací stanice)	1	3 489 408,75,-
B. Modulární infuzní systém (lineární dávkovače, dokovací stanice a SW pro vzdálenou správu)	1	3 833 906,00,-

Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X".

Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.

oddíl	cena v Kč bez DPH
A. Modulární infuzní systém (infuzní pumpy a dokovací stanice)	3 489 408,75,-

Stručný popis systému

Modulární infuzní systém, který se skládá z dodávky infuzních pump (67 ks) a dokovacích stanic (25 ks)

Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)	B. Braun Melsungen AG, Infusomat Space (infuzní pumpa), Space Station (modul dokovací stanice), Space Station Com (modul dok. stanice s komunikačním rozhraním), Space cover comfort (víko dokovací stanice se signalizací)
--	---

podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena v Kč bez DPH
Infuzní pumpa (67 ks)			2 673 320,00,-
Přesnost dávkování max. $\pm 5\%$	ANO	$\pm 5\%$	
Rozsah dávkování minimálně od 0,1 – 1200 ml/hod.	ANO	0,1 – 1200 ml/hod.	
Standardní provoz bez kapkového senzoru (s možností jeho doplnění a používání)	ANO	X	
Použití setů různých výrobců:	ANO	X	
sety pro běžnou infuzi	ANO	X	
bezpečnostní sety pro běžnou infuzi	ANO	X	
sety s UV ochranou pro podávání fotosenzitivních léků	ANO	X	
Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti dávkování 100 ml/hod.	ANO	8,5 h při 100 ml/h	
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, μ g, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/povrchu těla pacienta	ANO	X	
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času	ANO	X	
Interní paměť přístroje na seznam léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku	ANO	X	
Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení	ANO	X	
Možnost vzdálené aktualizace seznamu léků v pumpě přes připojení do datové sítě nemocnice	ANO	X	
U 4 kusů přístrojů je režim TCI zahrnut v dodávce, u ostatních možnost rozšíření ošetřovacích režimů (PCA, TCI, ...) pomocí upgrade SW	ANO	X	
Možnost použití různých terapeutických režimů:	ANO	X	
s rozběhem a doběhem	ANO	X	
programovatelný intervalový bolus	ANO	X	
programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...)	ANO	X	
Možnost použití při MRI vyšetření	ANO	X	
Systém KVO s více nastavitelnými rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování	ANO	X	
Regulace osvětlení displeje	ANO	X	
Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek	ANO	X	
Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu	ANO	X	
Napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě	ANO	X	
Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití náradí	ANO	X	
Software v češtině, možnost upload nového SW	ANO	X	
Možnost vzdáleného sledování stavu dávkovače pomocí připojení do datové sítě nemocnice	ANO	X	
Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 268/2014 Sb.	ANO	X	
8 ks infuzních pump, které lze použít pro podání enterální výživy	ANO	X	

U 10 ks přístrojů je součástí dodávky samostatný držák pro uchycení na infuzní stojan nebo euro lištu včetně napájecího zdroje	ANO	X
Dokovací stanice (25 ks)		
Stanice pro uchycení min. 8 přístrojů (shora uvedených infuzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel	ANO	umístění 8 přístrojů
Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici	ANO	X
Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů	ANO	možnost až pro 16 přístrojů
Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti	ANO	X
Připojení do nemocniční datové sítě (ethernet nebo Wi-Fi se zajištěným zabezpečením komunikace, např. formou SSL)	ANO	ethernet, rozšířením pro WiFi

816 088,75,

oddíl	cena v Kč bez DPH
B. Modulární infuzní systém (lineární dávkovače, dokovací stanice a SW pro vzdálenou správu)	3 833 906,00,-

Stručný popis systému
Modulární infuzní systém, který se skládá z dodávky lineárních dávkovačů (76 ks), dokovacích stanic (25 ks) a doplňkového SW pro vzdálenou správu infuzní techniky pro oddělení ARO (1ks)

Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)	B. Braun Melsungen AG, Perfusor Space (lineární dávkovač), Space Station (modul dokovací stanice), Space Station Com (modul dok. stanice s komunikačním rozhraním), Space cover comfort (víko dokovací stanice se signalizací), SpaceOnline Suite (SW řešení pro vzdálenou správu)
---	--

podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena v Kč bez DPH
Lineární dávkovač (76 ks)			2 150 800,00,-
Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců	ANO	X	
Přesnost dávkování max. ± 2 %	ANO	± 2 %	
Rozsah dávkování min. od 0,1 – 1200 ml/hod.	ANO	0,01 – 1800 ml/hod.	
Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 16 hodin provozu při rychlosti min. 2 ml/hod.	ANO	16 h při rychlosti 5 ml/h	
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/povrchu těla pacienta	ANO	X	
Bolusy - manuální i s přednastavením objemu/času	ANO	X	
Interní paměť přístroje na seznam léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku	ANO	X	
Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení	ANO	X	
Možnost vzdálené aktualizace seznamu léků v dávkovači přes připojení do datové sítě nemocnice	ANO	X	
Možnost rozšíření ošetřovacích režimů (PCA, TCI, ...) pomocí upgrade SW	ANO	X	
Funkce předání nastavení a kontinuálního dávkování druhým dávkovačem po vyprázdnění stříkačky dávkovače prvního (pro nepřerušené dávkování katecholaminů u kritických pacientů)	ANO	X	
Možnost použití různých terapeutických režimů:	ANO	X	
s rozběhem a doběhem	ANO	X	
programovatelný intervalový bolus	ANO	X	
programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...)	ANO	X	
Možnost použití při MRI vyšetření	ANO	X	
Systém KVO s více nastavitelnými rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování	ANO	X	
Regulace osvětlení displeje	ANO	X	
Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek	ANO	X	
Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu	ANO	X	
Možnost fyzického zajištění injekční stříkačky proti neautorizovanému vyjmutí	ANO	X	
Napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě	ANO	X	
Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití nářadí	ANO	X	
Software v češtině, možnost uploadu nového SW	ANO	X	
Možnost vzdáleného sledování stavu dávkovače pomocí připojení do datové sítě nemocnice	ANO	X	
Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 268/2014 Sb.	ANO	X	
U 5 kusů přístrojů provedení aktivace TCI	ANO	X	

podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena v Kč bez DPH
Dokovací stanice (25 ks)			816 088,75,-
Stanice pro uchycení min. 8 přístrojů (shora uvedených lineárních dávkovačů), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel	ANO	umístění 8 přístrojů	
Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici	ANO	X	
Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů	ANO	možnost až pro 16 přístrojů	
Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti	ANO	X	
Připojení do nemocniční datové sítě (ethernet nebo Wi-Fi se zajištěním zabezpečením komunikace, např. formou SSL)	ANO	ethernet, rozšířením pro WiFi	
SW pro vzdálenou správu infuzní techniky (lineární dávkovače, infuzní pumpy)			867 017,25,-
Systém bude používán pro oddělení ARO (10 lůžek)	ANO	X	
Systém pro vzdálené monitorování infuzní techniky na celém oddělení (s možností náhledu na další připojená oddělení) se zobrazením aktivních zařízení, blížícího se konce dávkování daných zařízení, alarmových stavů a celkového přehledu stavu infuzní techniky u konkrétního pacienta	ANO	X	
Systém pro záznam a reportování spotřeby léků nebo způsobu dávkování u vybraných pacientů (příp. všech pacientů na oddělení) za zvolené časové období	ANO	X	
Systém pro vzdálenou aktualizaci nastavení a seznamu léků	ANO	X	
SW pro vzdálenou správu infuzní techniky je možno užívat po období min. 5 let (cena za licenční práva a veškeré případné další poplatky za užívání SW jsou zahrnuty v nabídkové ceně)	ANO	X	
Veškeré náklady (zejména na zajištění sítě mezi infuzní technikou a SW) zahrnuty do nabídkové ceny; dodavatel zodpovídá za funkčnost celku bez nutnosti dalších nákladů)	ANO	X	

V Praze dne

B. Braun Medical s.r.o.

PharmDr. Jiří Lukáš
jednatel společnosti

B | BRAUN

39

IČ: 405 86 285
DIČ: CZ40586285

B. Braun Medical s.r.o.


V Parku 2335/20
67-149 00 Praha 4
tel. +420 2 241 11 111
fax +420 2 241 11 112

Technická data

Všechny uvedené přístroje mají záruku 2 roky.
Interval BTK je 2 roky.


Infusomat® Space, Volumetrická infuzní pumpa

Typ přístroje	Volumetrická infuzní pumpa
Rozměry	214 x 68 x 124 mm (š x v x h)
Hmotnost	Přibližně 1,4 kg
Ochrana proti vlhkosti	IP 22, ochrana proti kapající vodě
Displej	Podsvícený grafický displej, čitelný z úhlu ~40° ze všech směrů
Klávesnice	Podsvícená tlačítka, navigace jako na mobilním telefonu
Rychlosti	0,1-1 200 ml/h
Přesnost rychlosti podávání	< ±0,5% mechanická přesnost ± 5% podle normy IEC/EN 60601-2-24
Provozní teplota	+10° C ... + 40° C +50° F ... +105° F
Napětí	11-16 V stejnosměrné dodané externím napájením Space Power Supply nebo pomocí SpaceStation
Doba provozu na baterii	Minimální spotřeba energie přístrojem a nová technologie baterií zajistí dlouhou dobu provozu např. 9,4 hod. @ 80 ml/h, 8,5 hod. @ 100 ml/h
Životnost	Min. 10 let při zachování stálých provozních podmínek
Katalogové číslo	Infusomat® Space: 8713050 Infusomat® Space P: 8713070

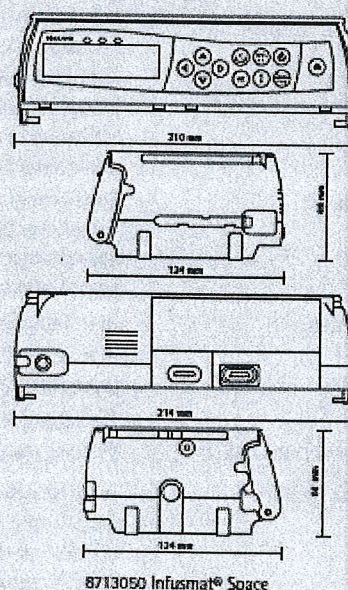

Perfusor® Space


Typ přístroje	Lineární dávkovač
Rozměry	249 x 68 x 152 mm (š x v x h), při zaparkovaném pohonu
Hmotnost	Přibližně 1,4 kg
Ochrana proti vlhkosti	IP 22, ochrana proti kapající vodě
Displej	Podsvícený grafický displej, čitelný z úhlu ~40° ze všech směrů
Klávesnice	Podsvícená tlačítka, navigace jako na mobilním telefonu
Rychlosti	0,01 - 1800 ml/h
Přesnost rychlosti podávání	< ± 0,5 % mechanická přesnost ± 2% ve shodě s normou IEC/EN 60601-2-24
Provozní teplota	+5° C ... + 40° C +41° F ... +105° F
Napětí	11-16 V stejnosměrné dodané externím napájením Space Power Supply nebo pomocí SpaceStation
Doba provozu na baterii	Minimální spotřeba energie přístrojem a nová technologie baterií zajistí dlouhou dobu provozu např. 16,8 hod. @ 1 ml/h, 16 hod. @ 5 ml/h, 14 hod @ 20 ml/h
Životnost	Min. 10 let při zachování stálých provozních podmínek
Katalogové číslo	Perfusor® Space: 8713030

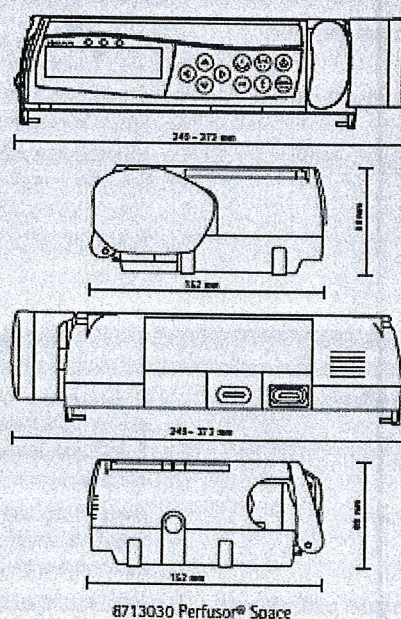

Technická data


SpaceStation, SpaceCover Standard, SpaceCover Comfort

Typ zařízení	Modulární stohovatelný rack (SpaceStation) pro libovolnou kombinaci až 4 pump Infusomat® Space nebo dávkovačů Perfusor® Space SpaceCover Standard je víko na horní SpaceStation SpaceCover Comfort s centrálním optickým a akustickým indikátorem stavu provozu. Centrální nastavení hlasitosti alarmových signálů.
Hmotnosti	SpaceCover Comfort: 0,9 kg SpaceCover Standard: 0,6 kg SpaceStation: 3,6 kg SpaceStation se SpaceCom: 4,1 kg
Rozšiřitelnost	až 6 stanic SpaceStation, montáž bez nářadí (6 x 4 pozice) v jednom, dvou nebo třech pilířích
Fixace	Univerzální svorka může být uchycena k infuzním stojanům (průměr 16-40 mm), a k horizontálním systémům splňujícím normu EN1789
Ochrana proti vlhkosti	IP 22, ochrana proti kapající vodě
Systém napájení	Vestavěný adaptér střídavého proudu. Standardní napájecí kabel pro přístroje, které nejsou určeny k vytápění, gumový konektor Primár: 100-120 V AC ~ 50/60 Hz, 200-240 V AC ~ 50/60 Hz, 110V 0,6 A / 220 V 0,3 A; Sekundár: 12V DC / 35 W
Provozní doba baterie	SpaceCoverComfort: ~ 26 hodin SpaceCom bez WLAN: ~ 3 hodiny @ jeden akumulátor SpaceCom bez WLAN: ~ 5 hodin @ dva akumulátory SpaceCom s WLAN: ~ 2 hodiny @ jeden akumulátor SpaceCom s WLAN: ~ 3,5 hod @ dva akumulátory
Provozní teplota	+10° C ... + 40° C +50° F ... +105° F
Katalogové číslo	SpaceCover Standard: 8713147 SpaceCover Comfort: 8713145 SpaceStation: 8713140 SpaceStation vč. SpaceCom: 8713142 SpaceCom dodatečný kit: 8713160 PoleClamp SPS: 34521151

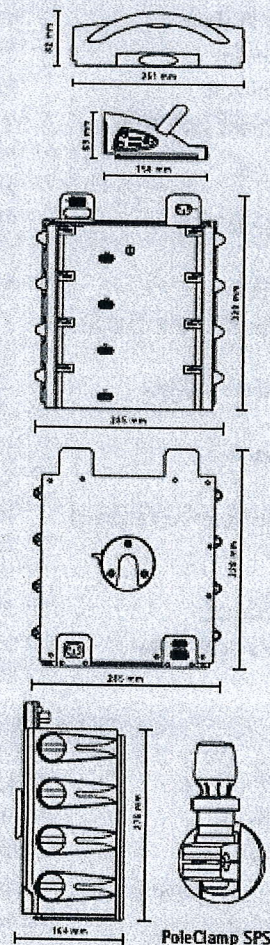


Space Power Supply and Space PoleClamp


Typ přístroje	Velkokapacitní Napájecí zdroj pro napájení přístrojů Space: napětí pro až 3 přístroje Space PoleClamp Space: Technika zaklapnutí pro rychlou fixaci až 3 přístrojů Space
Fixace	Svorky PoleClamp mohou být uchyceny k infuzním stojanům a vertikálním tyčím (průměr 16-40 mm) a k horizontálním systémům splňujícím normu EN1789
Ochrana proti vlhkosti	Napájecí zdroj: chráněn před stříkající vodou, IP42
Napětí	100-240 V AC $\pm$ 10 % - 90 - 264 V AC, 50/60 Hz
Adaptéry	Euro, UK, USA, Jihoafrická republika, Indie, Korea, Čína, Austrálie
Délka kabelu	2 m
Příslušenství	8713133 Combi Lead 12 V - pro připojení až 3 přístrojů Space k jednomu napájecímu zdroji; 8713135 krátký stojan infuze pro svorku Space PoleClamp
Katalogové číslo	Space PoleClamp: 8713130 Combi Lead 12 V: 8713133



8713130 Space PoleClamp




Power Supply/Adapter



8713133 Combi Lead 12 V

OneView

- Zvýšená efektivita díky centralizovanému přehledu IV terapie
- Okamžité informace ze všech pokojů
- Podpora správy alarmů pump
- Snižuje stres z alarmů pro sestry i pro pacienty
- Zvýšená bezpečnost medikace

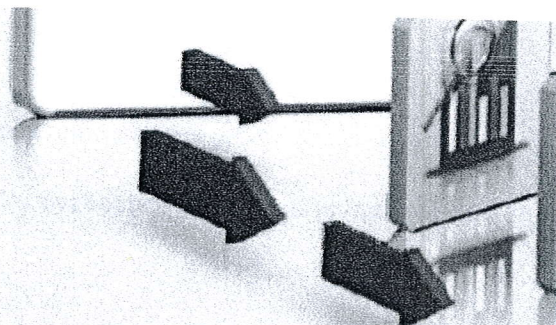


Upload Manager.WEB

- Vždy aktualizované systémy: knihovna léčiv, konfigurace a jednorázové údaje
- Nahrávání dat v rámci intranetu během pár vteřin
- Bez narušení pracovních postupů u lůžka
- Online reportování o průběhu nahrávání



Drug Library Manager

- Centrální správa nastavení terapie
- Jeden soubor Knihovny léčiv pro všechny pumpy
- Snadné nastavení specifických seznamů léčiv pro konkrétní jednotky intenzivní péče
- Kapacita knihovny je 1 200 léčiv, 30 kategorií, 50 profilů oddělení, 15 individuálních profilů pacienta



DoseTrac


Zprávy pro:

- Náhled na možné chyby v medikaci
- Monitorování postupů a procesů zlepšení
- Optimalizovaná správa lékárny
- Dokumentace bez mezer



Device Manager

- Online zobrazení všech pump
- Snadné provádění technických bezpečnostních kontrol
- Online sledování a lokace pump
- Centralizovaná konfigurace pump a jednorázových údajů

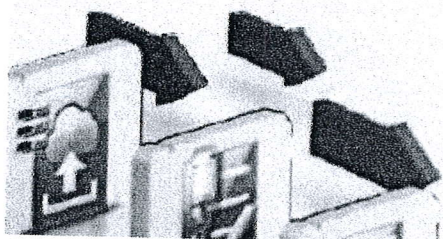

- Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazoval část kvalifikace.

Zakázka se bude realizovat bez využití poddodavatelů.