

Smlouva o dílo

č. 2008-09

Smluvní strany:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

sídlem: Strážovská 976, 697 33 Kyjov
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
zastoupená: Ing. Igorem Kalxem, ředitelem
IČ: 00226912
DIČ: CZ 00226912
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

GETINGE Czech Republic s r.o.

Zápis v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 119056
sídlem: Radlická 42, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Pavel Křivonoska
IČ: 27614883
DIČ: CZ27614883
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 536, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vymezení podmínek, práv a povinností smluvních stran při zajištění bezporuchové funkce zdravotnické techniky GETINGE, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. V rámci zajištění bezporuchovosti bude zhotovitel provádět preventivní prohlídky, stanovenou pravidelnou údržbu a odstraňovat vzniklé závady v rozsahu:

- preventivní prohlídky a průběžnou údržbu specifikované zdravotnické techniky /"dále jen technika"/, dle zákona č.123/2000 Sb, §28 a přílohy č.3 k vyhlášce MZ 195/2005 Sb.a dle ČSN EN 554, prováděné v rozsahu dle požadavků výrobce ke každému zařízení, jak je specifikováno v návodu k použití daného zařízení.
- odstraňování vzniklých závad techniky nad rámec preventivní péče dle bodu II.a, provedené na základě individuální objednávky objednatele, s nástupem do 48 hod. od nahlášení závady.

II.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel se zavazuje provádět stanovené preventivní prohlídky podle přiloženého harmonogramu pro každý přístroj. Preventivní prohlídky dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, budou zaznamenávány do servisní knihy, která bude předložena k zápisu o pravidelné opravě odpovědným zaměstnancem objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s platnými technickými normami i dalšími obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel ručí za náležitou odbornou kvalifikaci pracovníků provádějících dílo.
- Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů z vlastních zdrojů minimálně 10 let od instalace techniky.
- Zhotovitel garantuje zahájení opravy do 48 hodin od nahlášení.
- Objednatel bude mít k dispozici 7 dní v týdnu bezplatné technické poradenství na telefonním čísle 733 536 780 pro řešení akutních situací.

6. Objednatel se zavazuje:

- a. poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, podklady a informace,
- b. umožnit zhotoviteli přístup do určených prostor k provedení prací spojených s dílem
- c. po provedení opravy či údržby a zpětném převzetí techniky od zhotovitele potvrdit pracovníkovi zhotovitele provedení díla.
- d. zabezpečit obsluhu a používání techniky pouze pověřenými pracovníky (protokol o zaškolení) a v souladu s návodem k použití.
- e. zajistit dodržování základní údržby dle specifikace zhotovitele (předávacím protokolu)

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková roční cena za dílo je specifikována rozsahem prací preventivní údržby ke každému zařízení a bude fakturována měsíčně dle přílohy 1.
2. Objednateli budou kromě ceny za práci fakturovány skutečně použité náhradní díly a uskutečněná doprava v sazbě dle přílohy 1. Použité náhradní díly budou specifikovány v zápise o provedené opravě, který bude potvrzen oprávněným pracovníkem objednatele a přiložen k faktuře.
3. Veškeré další práce na opravy a odstraňování závad vzniklých mezi preventivními prohlídkami provádí zhotovitel na své náklady. V těchto případech objednatel hradí pouze skutečně použité náhradní díly a dopravu.
4. Ustanovení bodu III.-3 se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku následku poruchy či nedostatečné kvality vstupních medií (voda, pára, elektřina atd.), chybou obsluhy nebo jinými vnějšími vlivy. V tomto případě budou objednateli fakturovány skutečné náklady dle sazeb v příloze 1., stejně jako za jiné objednané práce na zdravotnické technice mimo odstraňování poruch.
5. Cena za dílo dle přílohy 1 nezahrnuje elektrevize, revize tlakových nádob a validace uvedené zdravotnické techniky.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli splatnost faktur 180 dnů.
7. Pokud cena náhradních dílů nutných k odstranění závady přesáhne 3.000,- Kč bez DPH, zhotovitel předloží písemnou kalkulaci opravy do 24 hodin po nástupu na opravu. Oprava bude zahájena po písemném odsouhlasení odpovědným pracovníkem objednatele, kterým je: Jan Ševela, vedoucí OZT.
8. Součástí nabídky opravy s použitím náhradního dílu nad limit dle bodu III.-7 bude i alternativní nabídka opravy stávajícího vadného dílu, bude-li toto stav dílu umožňovat. Práce na opravách vadných dílů nejsou součástí paušální platby dle přílohy 1 a budou specifikovány u každého případu zvlášť.
9. Vyměněné náhradní díly jsou majetkem objednatele a zhotovitel je ponechá u opraveného přístroje na pracovišti nebo je po dohodě s odpovědným zaměstnancem objednatele převezme k likvidaci.
10. U nejčastěji používaných, resp. vybraných nákladných náhradních dílů, zhotovitel garantuje prodejní ceny dle přílohy č.2 po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy.
11. Výkazy o provedených opravách bude za objednatele schvalovat podpisem p. Ševela nebo ve výjimečných případech jím pověřený pracovník po jeho telefonickém souhlasu. Faktury, které nebudou podloženy takto podepsaným výkazem má objednatel právo odmítnout k úhradě.

IV.

Záruka na dílo

Zhotovitel garantuje, že dílo bude po dobu 6-ti měsíců od data převzetí objednatelem způsobilé ke svému účelu a zachová si po tuto dobu obvyklé vlastnosti.

V.


Doba trvání smlouvy

1. Getinge Czech Republic s.r.o. bude zajišťovat servis zdravotnické techniky GETINGE instalované u objednatele od 1.1.2008

2. Smlouva o dílo se uzavírá na dobu 12 měsíců a automaticky se prodlužuje o 12 měsíců, nepodává-li žádná ze stran písemnou výpověď do 60 dnů před ukončením platnosti smlouvy.
3. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí doručenou druhou smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. V případě, že druhá smluvní strana výpověď nepřevzme, či doručení výpovědi jinak zmaří, má se za to, že doručeno bylo třetí den po odevzdání výpovědi k doručení na poště v podobě doporučeného dopisu, a to na poslední známou adresu druhé strany této smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry v této smlouvě neupravené se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
3. Obě strany se považují tuto smlouvu a všechny její přílohy za důvěrnou a zavazují se zabránit úniku obsahu této smlouvy vůči třetím osobám.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku.
5. Změny a dodatky lze provádět pouze dohodou v písemné formě.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - "Specifikace sterilizační a dezinfekční techniky GETINGE a rozsah prací".



cnice Kyjov
řspěvková organizace
76, 697 33 Kyjov
0226912

za objednatele



za zhotovitele

v PRAZE dne 30/4/08

GETINGE

CZECH REPUBLIC BRNO
KALČOVA 42, 60200 PRAHA 6

TEL: +420 542 211 111

příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2008-09

Specifikace zdravotnické techniky GETINGE a rozsah prací

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Dodavatel Getinge Czech Republic s.r.o.

Rozsah účtovaných prací preventivní údržby dle návodu k obsluze:

	instalace Kyjov	popis	1/4 roku	1/2 roku	roční	hodin celkem
1	Kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd GE2609 LTSE		6	10	16	38
2	Parní sterilizátor GE2612 AR2		6	8	12	32
3	Parní sterilizátor G26612 AR2		6	8	12	32
4	myčka Decomat 4656		4	4	4	16
5	myčka Decomat 4656		4	4	4	16
6	Parní sterilizátor GE336		0	6	6	12
7	Parní sterilizátor GE336		0	6	6	12
8	Parní sterilizátor GE336		0	6	6	12
9	Parní sterilizátor GE336	není předmětem smlouvy				
10	svářečka obalů			3	3	6
11	svářečka obalů			3	3	6
celkový objem ročně:						182

smluvní hodinová sazba: 450,- Kč/hod (sleva ze základní sazby 790,-/hod.)

celkem údržba ročně: 82.900,- Kč

měsíčně k fakturaci za preventivní údržbu+odstaňování závad: 6.825,- Kč +DPH

+ doprava:

servisní středisko: Brno
vzdálenost km: 2 x 60 km
sazba km: 8,50 Kč

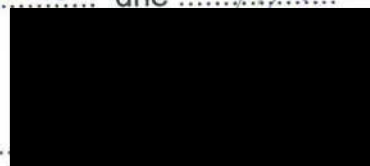
V KYJOVĚ dne 30. 4. 09



za objednatele

Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Komenská 976, 697 33 Kyjov
IČO: 00226912

V PRAZE dne 30. 4. 09






za zhotovitele

GETINGE
CZECH REPUBLIC, s.r.o.
RADLICKÁ 42, 150 00 PRAHA 5

příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2008-09
 Specifikace náhradních dílů s garantovanou cenou

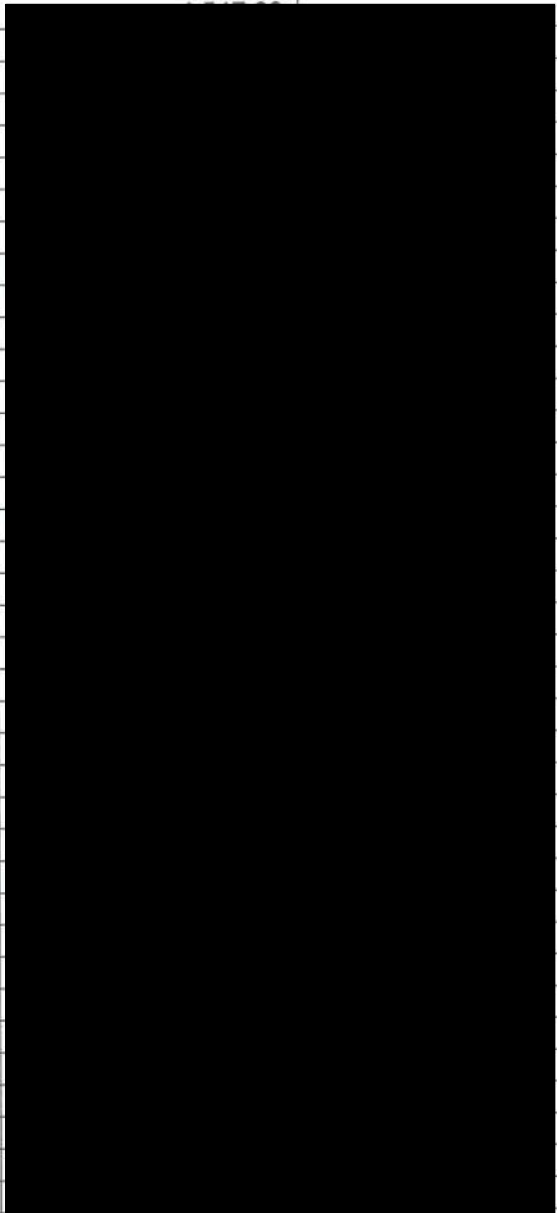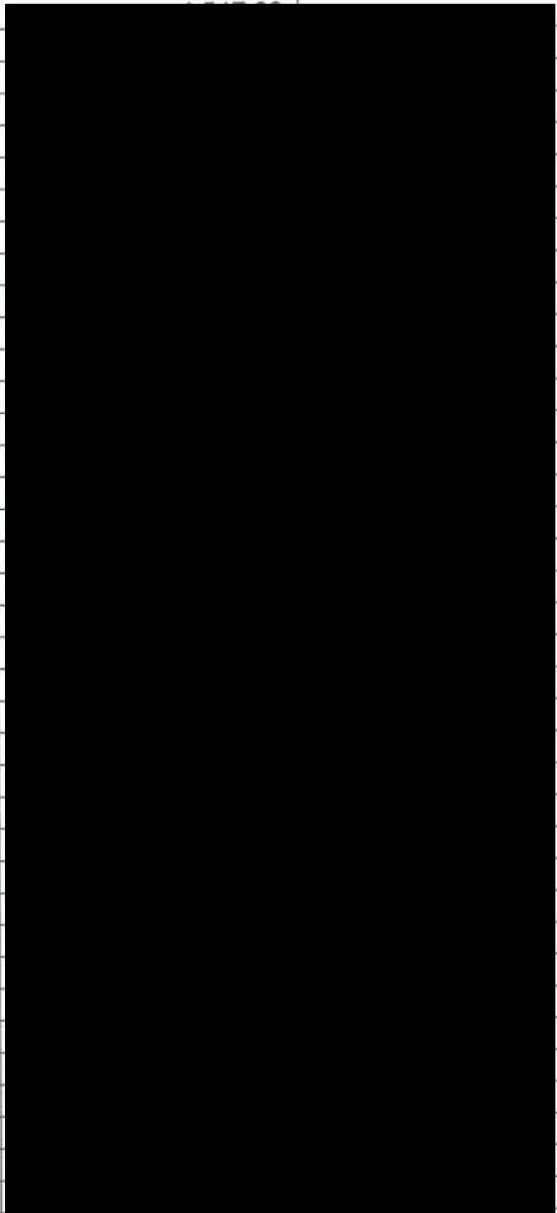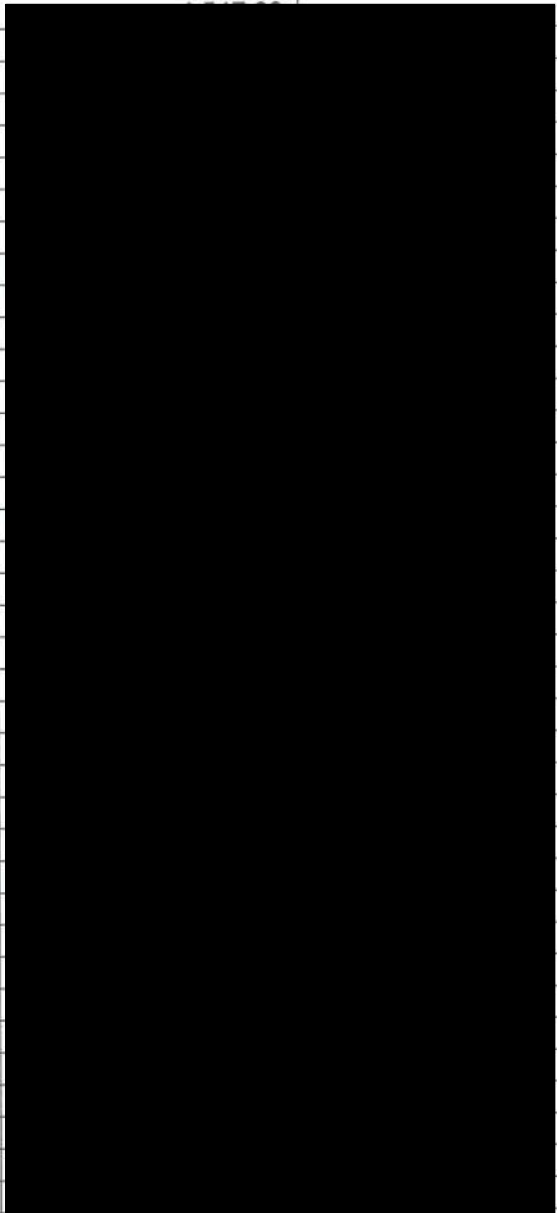Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 Dodavatel: Getinge Czech Republic s.r.o.
 Podle bodu III.-10 dodavatel garantuje ceny níže uvedených náhradních dílů pro objednatele po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy:

Katalogové číslo	Název	Cena Kč/ks bez DPH	Cena nem. Kyjov		
GE 26xx					
460029001	těsnění dveří 66xx				
470788801	sterilní filtr 66xx				
561210701	odvaděč kondenzátu 1/2"				
570038801	pneu ventil DN15 vnější				
570038802	pneu ventil DN20 vnější				
479042001	vývěva LEMA 50				
469517302	tlakový spínač -1/+1 bar				
460028570	pneu válec 74 GE66				
479761101	jehla Formaldehyd				
570038201	solenoidový ventil Fo				
463199912	pojistný ventil 3/4" 3,5bar				
GE 336c					
4837427	těsnění dveří GE 336c				
4835850	sterilní filtr GE 336c				
999922558	regenerace demi patrony				
4835514	elmag. zámku dveří 336c				
4834100	elmag. ventil 6013 336c				
4834687	zpětná klapka AJ 1111-10 336c				
4835247	odpadní ventil GE 336c				
48320113	dávkovací čerpadlo 33				
4837422	control unit 336c – zákl. deska				
4839262	zpětná klapka 63 336c odpad				
4835521	vakuové čerpadlo				
48320170	pojistný ventil 1/2" 2,7bar				
Decomat					
501866600	ventilátor pro Decomat				
498906100	filtr vzduchový Decomat				
499178200	hladinový spínač 110 mm 4656				
150442702	odpadní čerpadlo 4656				
498944500	deska rozšíření 4656				
501087601	deska CPU 4656				
999922564	hadice dávkovacího čerpadla Tygon				
500096500	elmag. zámek s pruž. 4656				
499178000	deska display 4656 nakl.				
499195600	deska display 4656 čistá				
501596802	sání s hlad. senzorem 4656 kompl.				

V KYJOVĚ dne 30.4.2008



Nemocnice Kyjov
 příspěvková organizace
 6, 697 33 Kyjov
 IČO: 00226912

V PRAZE dne 30/4/08



GETINGE
 CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 RADLICKÁ 42, 150 00 PRAHA 5