



Technické parametry - obrazová dokumentace

1) Laparotomické síto


1. Nůžky chirurgické zahnuté TC
Celková délka 140 mm, tupo-tupé špice,
zahnuté viz obrázek




2. Nůžky chirurgické rovné TC
Celková délka 140 mm, tupo-tupé špice,
rovné viz obrázek



3. Nůžky chirurgické zahnuté Metzenbaum, jemné, preparační TC
Celková délka 230 mm, tupo-tupé špice,
zahnuté, jemné, preparační viz obrázek



4. Nůžky chirurgické zahnuté, Metzen. TC
Celková délka 230 mm, tupo-tupé špice,
zahnuté viz obrázek




5. Držák skalpelových čepelí vel.4
Délka 135 mm



6. Držák skalpelových čepelí vel.3
Délka 125 mm




7. Držák skalpelových čepelí vel.3L
Délka 210mm




8. Nůžky pro hysterektomii TC

Délka 230 mm, tupo-tupé špice, mírně zahnuté




9. Lopatka břišní

Lopatka ohebná, vel. 370/450 x 300 mm




10. Hák Middeldorpf

Vel. okénka 30 x 33 mm,
délka nástroje 235 mm



11. Hák Middeldorpf

Vel. okénka 50 x 65 mm,
délka nástroje 280 mm




12. Hák Mikullicz

Vel. lopatky 120 x 30 mm,
délka nástroje 245 mm



13. Hák Mikullicz

Vel. lopatky 140 x 50 mm,
délka nástroje 260 mm

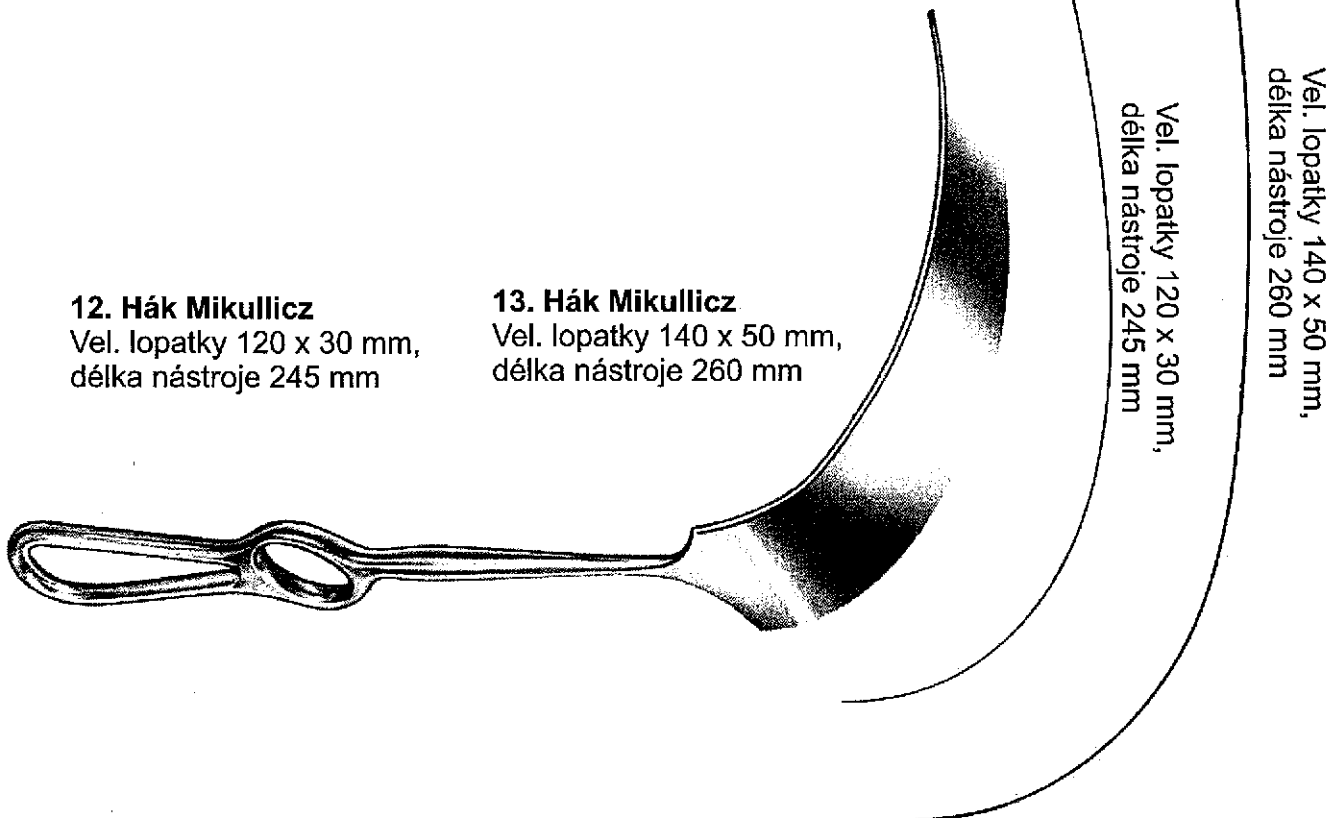


Vel. lopatky 120 x 30 mm,
délka nástroje 245 mm

Vel. lopatky 140 x 50 mm,
délka nástroje 260 mm


14. Rozvěrač břišní

Délka rozvěrače 260 mm,
boční lopatky šíře 80 mm a hloubka 60 mm,
přední lopatka upevněna šroubem k rozvěrači,
šíře 75 mm a hloubka 60 mm




15. Rozvěrač břišní

Délka rozvěrače 220 mm,
boční lopatky šíře 60 mm a hloubka 38 mm,
přední lopatka upevněna šroubem k rozvěrači,
šíře 55 mm a hloubka 38 mm




16. kleště Schroeder (Müsse)

Délka 250 mm, rovné kleště




17. Kleště okénkové Foerster

Délka 250 mm, kleště rovné,
okénka s vroubkováním,
vel. 10 x 20 mm




18. Redon jehla zahnutá

Redon jehla zahnutá, zakončení kužel
pro nasazení drénu, pr. 3,33 mm 10 Charr



19. Pinzeta anatomická standard

Délka 250 mm, pracovní část zakon. tupě,
3 mm široká




20. Pinzeta anatomická standard

Délka 200 mm, pracovní část zakon. tupě,
3 mm široká



21. Pinzeta chirurgická standard

Délka 160 mm 1 x 2 zuby




22. Pinzeta chirurgická standard

Délka 200 mm 1 x 2 zuby




23. Pinzeta chirurgická standard

Délka 250 mm 1 x 2 zuby



24. Jehlec Bozemann TC

Délka 200 mm s 0,5 mm hustotou zoubkování pro umístění stehu, prohnutí odpovídá obrázku



25. Jehlec Bozemann TC

Délka 250 mm s 0,5 mm hustotou zoubkování pro umístění stehu, prohnutí odpovídá obrázku




26. Jehlec Bozemann TC

Délka 300 mm s 0,5 mm hustotou zoubkování pro umístění stehu, prohnutí odpovídá obrázku




27. Jehelec peánový De Bakey TC

Délka 180 mm s 0,5 mm, hustotou zoubkování pro umístění stehu, rovné provedení jehelce odpovídá obrázku




28. Disektor Overholt

Délka 185 mm, mírně prohnuté tělo zahnutí koncové části odpovídá obrázku




29. Kocher rovný

Délka 160 mm 1 x 2 zuby




30. Kocher rovný

Délka 200 mm 1 x 2 zuby




31. Kocher rovný

Délka 260 mm 1 x 2 zuby




32. Kleště tamponové

Délka 260 mm „S” prohnuté viz obrázek




33. Peán rovný

Délka 160 mm




34. Peán zahnutý Rochester

Délka 200 mm, zahnutí odpovídá obrázku




37. Peán zah. Rochester

Délka 260 mm, zahnutí odpovídá obrázku




35. Peán zahnutý jemn. Bengola

Délka 200 mm, zahnutí odpovídá obrázku




36. Peán zahnutý jemn. Bengola


Délka 260 mm, zahnutí odpovídá obrázku




38. Kleště pro hysterektomii, také na parametria TC
Délka 265 mm mírně zahnuté. viz obrázek




39. Svorka sterilizační
Délka 140 mm




40. Svorka na prádlo
Délka 130 mm, tupé zakončení pracovní části viz obrázek




41. Kleště „Američan“ Schroeder
Délka 250 mm, rovné




42. Miska nerezová
Objem 1 litr vody pr. 175 mm,
hloubka 70 mm




43. Jehelník
Velikost 150 x 95 x 13 mm



44. Síto sterilizační drátěné
krátkými úchopy, zajiďující podél stěny síta
Velikost 520 x 250 x 70




45. Miska nerezová
Objem 0,35 litrů, pr. 116 mm
hloubka 50 mm




2) Vaginální síto

46. Nůžky chirurgické zahnuté TC
Celková délka 140 mm, tupo-tupé špice,
zahnuté viz obrázek



47. Nůžky chirurgické zahnuté, Metzen. TC
Celková délka 230 mm, tupo-tupé špice,
zahnuté viz obrázek




48. Držák skalpelových čepelí vel.4
Délka 135 mm



49. Držák skalpelových čepelí vel.3
Délka 125 mm




50. Nůžky pro hysterektomii TC
Délka 230 mm, tupo-tupé špičky, mírně zahnuté



51. Kleště potratové


Délka 280 mm, mírně zahnuté,
šíře úchopové části max. 100 mm



52 a - 52 e. Kyreta děložní ostrá

Délka 320 mm

- a) pr. oka kyrety 5 mm c) pr. oka kyrety 7 mm
b) pr. oka kyrety 6 mm d) pr. oka kyrety 8 mm
e) pr. oka kyrety 9 mm



53. Pátradlo (sonda) děložní

Délka 320 mm, ohebná, pr. 3,5 mm
s centimetrovým měřítkem (stupnicí)



54. Dilatátor děložní sada 15ti dilatátorů


Sada dilatátorů od pr. 3,0 mm do 10,0 mm
s číselným údajem na držadle nástroje



55 a - 55 b. Zrcadlo poševní zadní

Délka a šíře pracovní části zrcadla (a x b)
viz obrázek


- a) vel. č. 1 - 110 x 27 mm
- b) vel. č. 2 - 110 x 30 mm



56 a - 56 b. Zrcadlo poševní přední


Délka a šíře pracovní části zrcadla (a x b)
viz předešlý obrázek u zadního poševního zrcadla

- a) vel. č. 1 - 115 x 23 mm
- b) vel. č. 2 - 115 x 26 mm




57. Držadlo Schreback (držadlo + závaží)

Závaží o hmotnosti 400 g




58 a - 58 c. Vyměnitelná lžice k Schreback držadlu

- a) Vel. č. 1 - délka 80 mm x šíře 30 mm
- b) Vel. č. 2 - délka 85 mm x šíře 35 mm
- c) Vel. č. 3 - délka 90 mm x šíře 40 mm



59. Pinzeta anatomická standard
 Délka 200 mm, pracovní část zakon.
 tupě 3 mm široká




60. Pinzeta chir. standard
 Délka 160 mm 1 x 2 zuby




61. Pinzeta chir. standard
 Délka 200 mm 2 x 3 zuby




62. Jehelec Bozemann TC
 Délka 200 mm s 0,5 mm
 hustotou zoubkování
 pro umístění stehu,
 prohnutí odpovídá obrázku



63. Jehelec Bozemann TC
 Délka 240 mm s 0,5 mm
 hustotou zoubkování
 pro umístění stehu,
 prohnutí odpovídá obrázku




64. Jehelec peánový De Bakey TC
 Délka 180 mm s 0,5 mm,
 hustotou zoubkování,
 pro umístění stehu,
 rovné provedení jehelce
 odpovídá obrázku




65. Disektor Overholt

Délka 185 mm, mírně prohnuté tělo
zahnutí koncové části odpovídá obrázku




66. Kocher rovný

Délka 140 mm 1 x 2 zuby




67. Kocher rovný

Délka 200 mm 1 x 2 zuby




68. Kleště tamponové

Délka 260 mm „S” prohnuté viz obrázek




69. Peán rovný

Délka 160 mm




70. Peán zahn. Rochester


Délka 180 mm, zahnutí
odpovídá obrázku




71. Kleště pro hysterektomii, také na parametria TC
Délka 265 mm mírně zahnuté. viz obrázek




72. Svorka sterilizační
Délka 140 mm




73. Svorka na prádlo
Délka 130 mm, tupé zakončení pracovní části viz obrázek



75. Kleště „Američan“ Schroeder
Délka 250 mm, rovné



74. Jehelnín
80 x 80 x 10 mm,
rozdělení vnitřní na 3 části



44. Síto sterilizační drátěné
krátkými úchopy, zajiďující podél stěny síta
Velikost 520 x 250 x 50

