


SIAL

architekti a inženýři
spol. s.r.o. Liberec

U Besedy 8/414
CZ 460 02 Liberec 3
tel + 420 485 104 880
sial@sial.cz
www.sial.cz




Centrum odborného vzdělávání v oboru služeb při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě

dokumentace pro výběr dodavatele

Architektonické a stavebně technické řešení
Specifikace - katalogové listy

projekt Centrum odborného vzdělávání v oboru služeb při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě
stupeň dokumentace pro provádění stavby
datum 04/ 2017

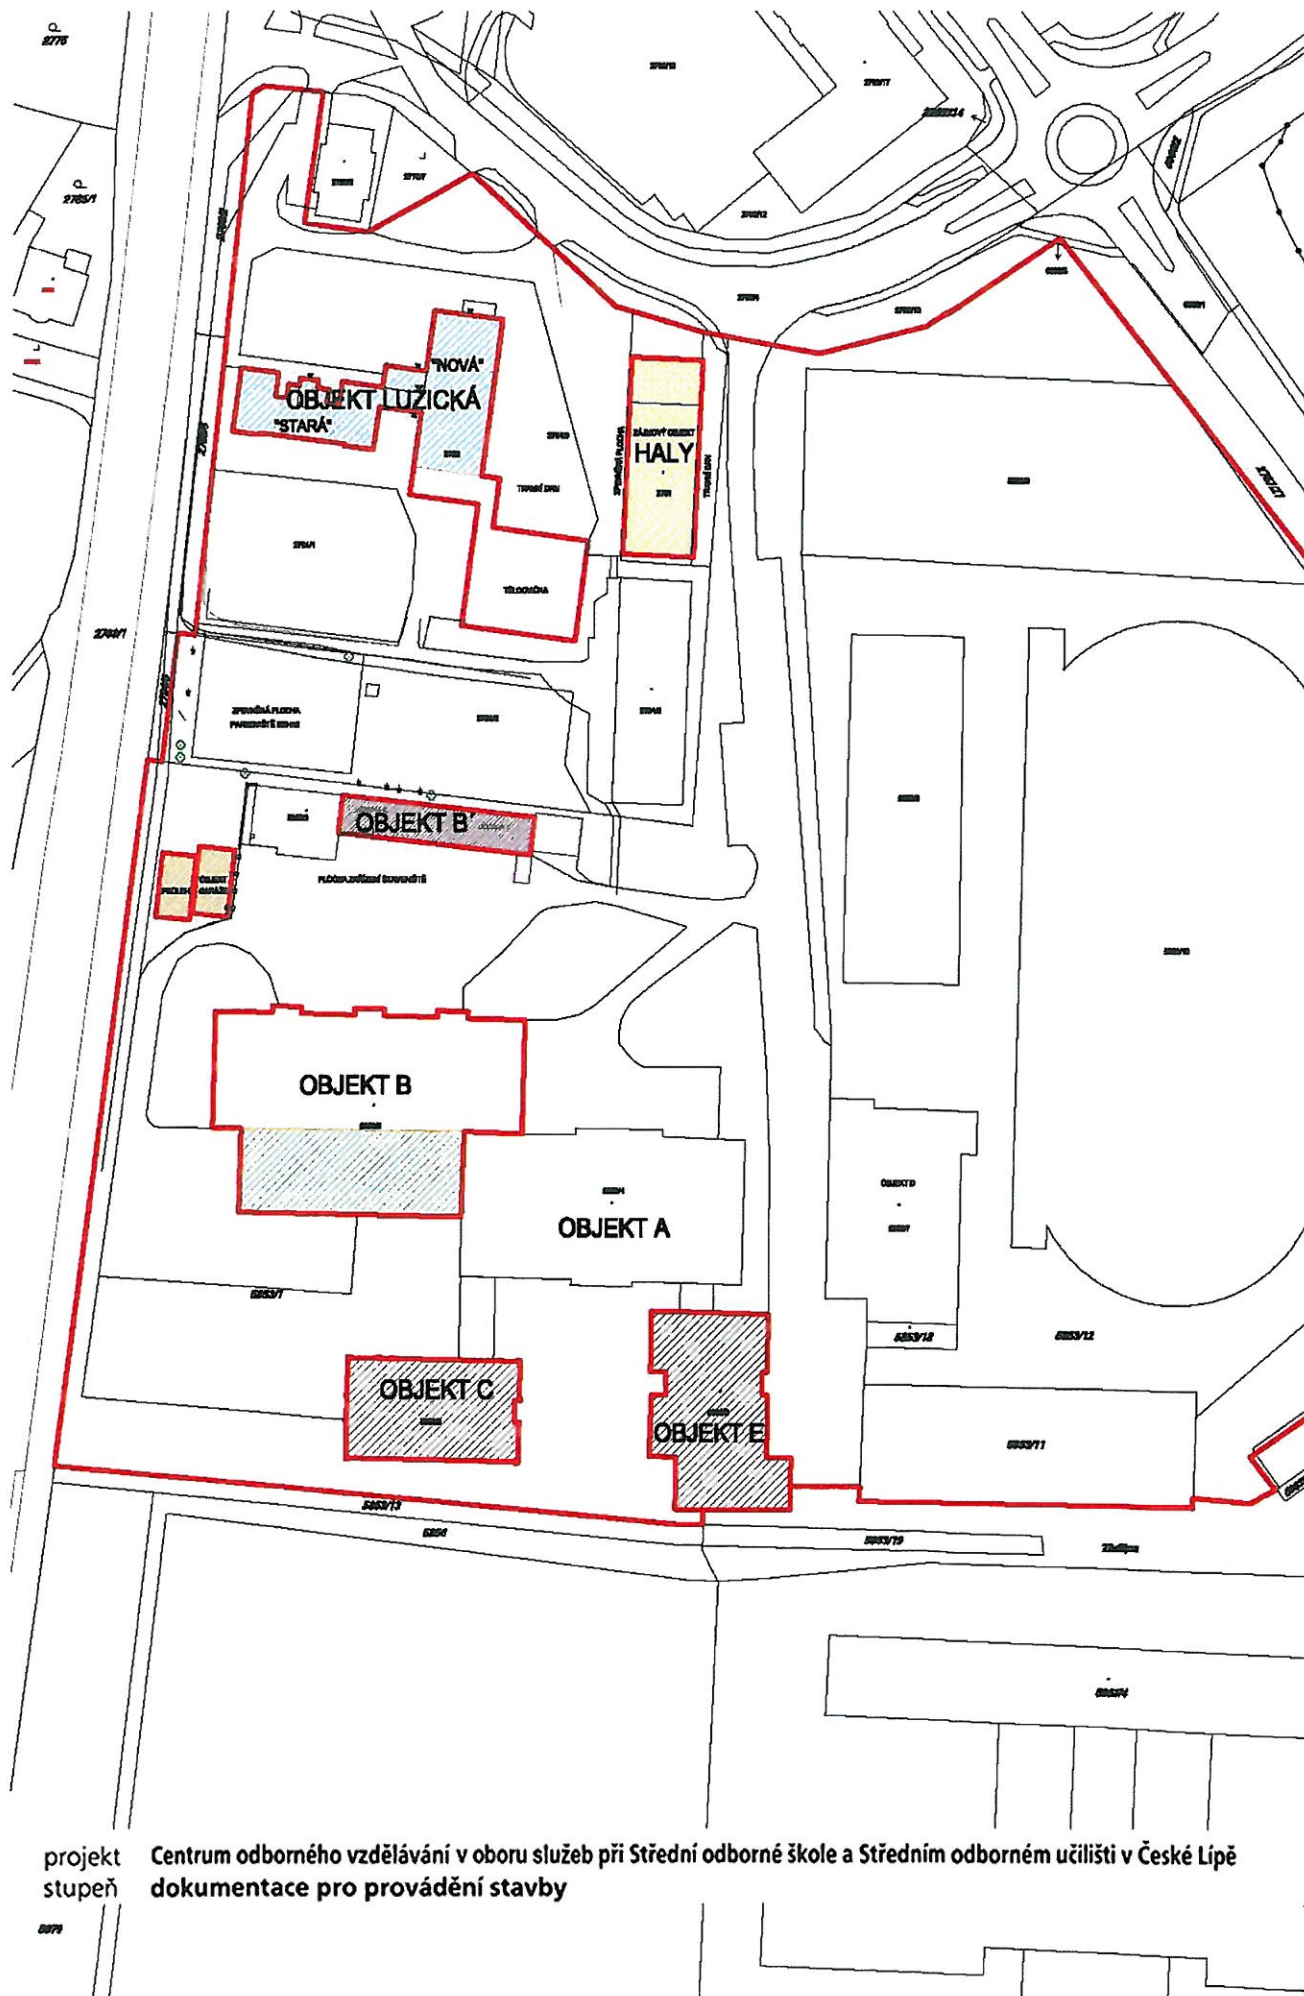

projekt
stupeň

Centrum odborného vzdělávání v oboru služeb při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě
dokumentace pro provádění stavby

názov


Ostřívek masiv – styp

L/ 1.13

specifikace

rozměry(délka)

pracovní část: 1900 x 3200 x v. 750 mm

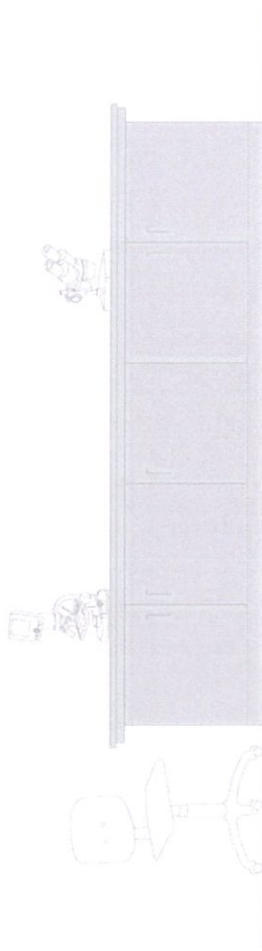

stýpkový výrobek
Zpracováno pracovním stýpkem bez měřít

výška pracovní desky 750 mm
pracovní deska z postřimingu, tloušťka min. 28 mm
laboratorní stýpkový stůl z jehlové korpusky 30 x 30 mm
s naklápěvacími nožičkami a kormatovou úpravou.

Laboratorní stýpkový pod pracovní plochou budou
z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm.

Dvěle budou nabitěné na nílčových samodržících zvlášťech
odnímalých bez šroubování a lepení hranou z materiálu
ABS o tl. 2 mm. hrany korpusu stýpkový

stýpkový budou se stýpkem, uzamykací a budou

výševny jedinou versídní polici.

Dvěle stýpkový budou vybaveny lůžkem drazu.


POZN:

výrobek dokumentován nutno předat před
zpracováním výroby architektovi SIALU

k odsouhlasení

vzorky materiálu a eventuelních alternativ
nutno předat předtím k odsouhlasení

velikost rozměry nutno ověřit na místě




měřítko 1:25

projekt Centrum odborného vzdělávání v oboru služeb při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě
stupeň dokumentace pro provádění stavby

název
Židle laboratorní
L/1.12 a 1.13

specifikace

Povolené tolerance rozměru dle normy.
Nábytek musí splňovat sormu ČSN EN 1729-1
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

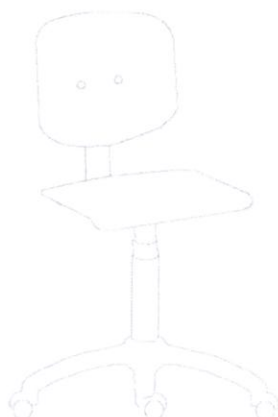

Židle laboratorní:
Sedák a opěrák bude z tlakově zpracované bukové překližky
v přírodním provedení,
lakovaná polyuretanovým lakem
Sedák vpřed kolenním ohybem.
Opěrák s 3D - ohybem pro správnou
ergonomii páteře.
Otočná, výškově nastavitelná a pojízdná.
Kolečka vhodná pro tvrdé podlahy.

název


Pracovní plocha s dřezem, umyvadlem a lednicí

L/1.12 a 1.13



specificity

rozměry(dx&xv)

600 x 5000 x v. 900 mm



excentrické ovládání výpusti

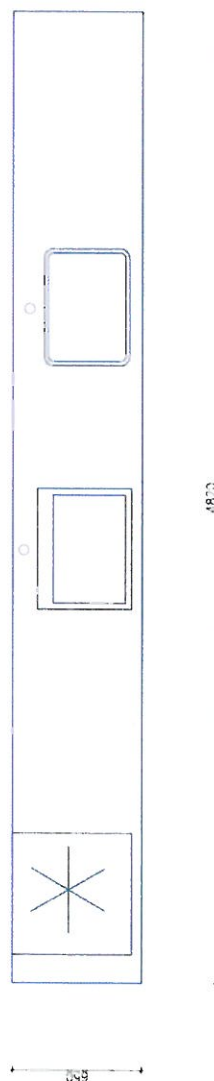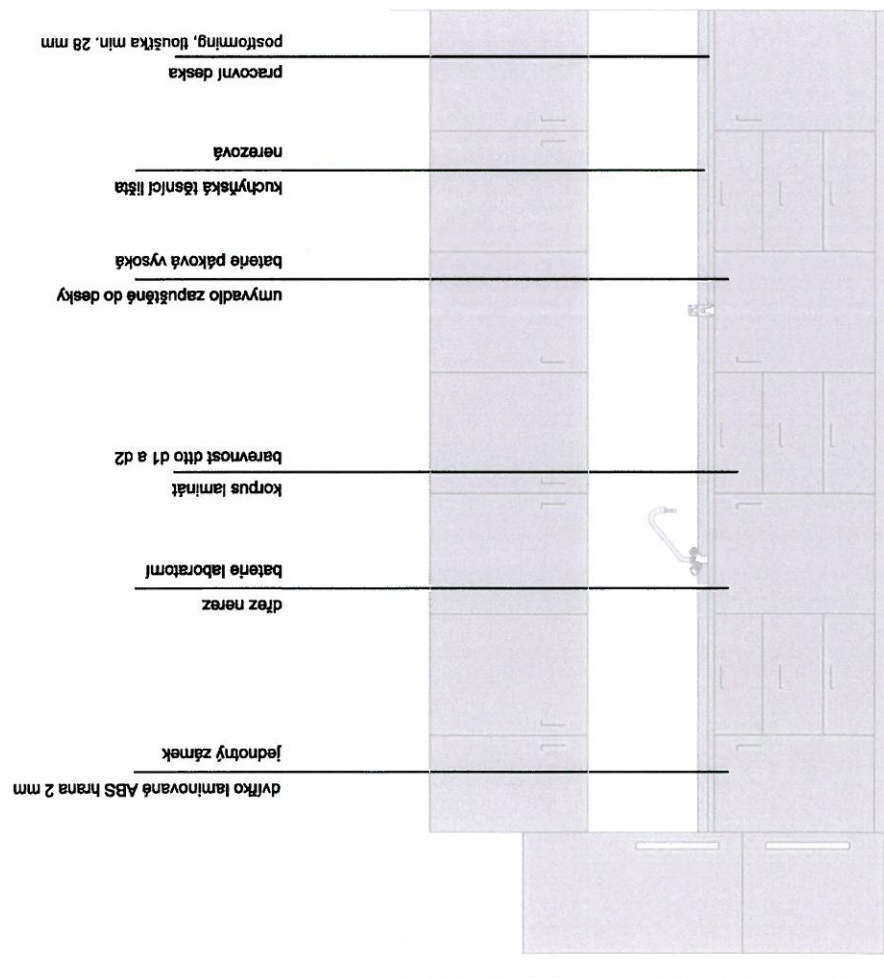

4870


měřítka 1:25

Centrum odborného vzdělávání při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v České Lípě
documentace pro provádění stavby

projekt	stupeň
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

dokumentace pro provádění stavby

**kod
d5**

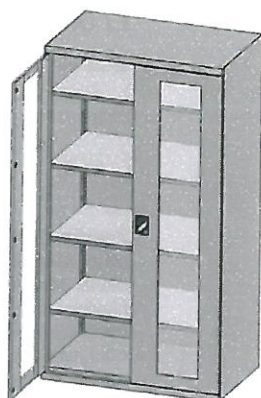

název
skříň plechová

L/ 506

specifikace
800 x 400 x v. 1950 mm

Skříň plechová, uzamykatelná, prosklená dvířka,
výsuvné police.
Skříň bude kotvena ke zdi.
Nohy rektifikovatelné

Výrobek musí být vhodný pro laboratorní provoz.

**kod
d6**



název
mikroskop

L/ 506

specifikace

Zvětšení 40x-1600x
prosvětlovací
achromatické objektivy se zvětšením 4x, 10x a 40x
osvětlení LED
jednostupňové ostření
uchycení preparátu
křížový stolek
snímač CMOS
3,2Mpx
velikost obrazu 2048x1536

Výrobek musí být vhodný pro laboratorní provoz.

názov
stereoskopický mikroskop

L/ 506

specifikace



Zorné pole při zvětšení 20x/ ø 10 mm
při zvětšení 40x/ ø 5 mm
okulár 10x/21 (2 ks)
hlavice binokulární otočná o 360°
úhel vzhledu 45°
oční rozstup 55 - 75 mm
dioptrické doostření jednoho okuláru
dva páry objektivů 2:1, 4:1
změna zvětšení otáčením hlavice s objektivy
očnice (2 ks)

Celkové zvětšení 20x a 40x
zaostřování:
hrubé - posuvem držáku hlavice po stativu
jemné - makroposuv (pastorek-hřebínek)
pracovní vzdálenost 72mm
Osvětlení dopadající 12V/10W, tyčový stativ

Výrobek musí být vhodný pro laboratorní provoz.