

DOHODA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI č. DOS 12-04

Článek I. Smluvní strany

MEDESA s.r.o.

Se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237

IČO: 64254577 DIČ: CZ64254577

Statutární zástupce: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „společnost MEDESA“ nebo „dodavatel“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Se sídlem: Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

IČO: 26001551 DIČ: CZ26001551

Statutární zástupce: Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontakt: [REDAKCE]

(dále jen „ON Jičín“ nebo „odběratel“)

Článek II. Předmět dohody

- 1) Společnost MEDESA je dodavatelem zboží a služeb do ON Jičín. Předmětem této dohody je upravení vzájemných obchodních podmínek spolupráce, a to takto:
 - a) společnost MEDESA poskytne odběrateli [REDAKCE] dodávané na všechna pracoviště odběratele, s výjimkou zboží, jehož cena bude stanovena zvláštní smlouvou;
 - b) sleva bude poskytována snížením katalogové prodejní [REDAKCE] fakturované ceny budou již zahrnovat výše uvedenou slevu;
 - c) splatnost faktur vystavených dodavatelem je stanovena na 14 dní ode dne jejich vystavení a odběratel se zavazuje je řádně a v termínu splatnosti platit, přičemž dodavatel se zavazuje neuplatňovat úrok z prodlení do 120 dnů po splatnosti.

Článek III. Doba trvání dohody


- 1) Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 14. 12. 2012.
- 2) Dohoda zaniká:
 - a) nebyly-li uhrazeny závazky z obchodního styku ani po urgencích do 120 dnů po splatnosti;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;
 - c) výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Článek IV.


Závěrečná ustanovení, podpisy stran

- 1) Dohoda nabývá platnosti podpisem obou stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s obsahem této dohody a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Jakékoliv změny nebo doplňky této dohody mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 4) Součástí této dohody je Příloha č. 1 – Přehled zboží dodávaného do ON Jičín.

V Poličce dne 13. 12. 2012



V Jičíně dne 14 -12- 2012



Příloha č. 1 - Přehled zboží* dodávaného do Oblastní nemocnice Jičín a. s. / Ceník

* seznam zboží vychází z odběrů za rok 2012

pracoviště OKB Jičín

Katalogové číslo	Název	Katalogová cena v Kč bez DPH	Cena po slevě 6 % v Kč bez DPH
018767	Calibrator set 2x5x4ml (G		
019506	Filter element G7 (5ks)		
019544	G7 buffer No.1 (1 x 800ml)		
019545	G7 buffer No.2 (1 x 800ml)		
019546	G7 buffer No.3 (1 x 800ml)		
019551	G7 column		
021974	Hemoglobin A1c Control se		
062276	Blood Gas Capillaries BK		
0083602	Sample Port 1pc		
0083801	pH Electrode Gastat		
0083802	PO2 Electrode Gastat		
0083803	PCO2 Electrode Gastat		
0083806	Na Electrode Gastat		
0083807	K Electrode Gastat		
0083808	Cl Electrode Gastat		
0083810	Reference Electrode Gasta		
0083901	Cal Cassette 60x (2btl/b		
0083902	Flush Solution (3btl/box		
0083912	Na refill solution(2vials		
0083913	K refill solution(2vials)		
0083920	Gastrol ISE Tri-Level		
100020	Plastic capillaries Na-he		
0123050	Pump Tube kit Gastat 604		
0123920	Ox Control TRI-Level (30v		
08-11-8432	HbA1c Hemolysis (1 l)		
0201-0002-026	System solution (5l)		
0209-0100-012	Sample cups 2 ml and capi		
3MA005	Calibration standard 50 mOsm		
3MA029	Clinitrol 290 (10x2ml)		
3MA085	Calibration standard 850 mOsm		
3MA800	Disposable tips and chamb		
5130-6055	Sensor Test solution		
5130-6152	ReadyCon Norm - Lac/Glu		
5130-6162	ReadyCon Path - Lac/Glu		
5211-3015	Multi standard solution 1		
5211-3017	Multi standard solution 1		
7025-6035-0231	Cleaner D 100ml		
7025-6215-0376	Serum standard 100ml		
901.200.002	Holder for capillaries		
B01-4171-58	ISE buffer CZ (5l)		
B01-4173-52	ISE Referenční roztok (1l		
B01-4179-52	Kyvetový blank (1x1000ml)		
ZF000213080	Incubation bath oil CZ(5	1	
DTS / DTZ	Dopravné		

pracoviště OKBH Nový Bydžov

Katalogové číslo	Název	Katalogová cena v Kč bez DPH	Cena po slevě 6 % v Kč bez DPH
020368	FT4 calib.		
020394	TSH3G calib.		
020955	Washing sol.		
020956	Diluent		
020968	Substrate II		
020970	Standardization cups (ST		
025215	Troponin 3rd-Gen ST 100T		
025228	BNP Stat 100T		
025268	FT4 Stat 100 T		
025294	TSH Stat 3G 100 T		
025297	Myoglobin Stat 100T		
025315	TROPONIN 3rd-Gen calib.		
025328	BNP calib.		
025397	Myoglobin calib.		
025428	BNP control set		
33101	Diaton-5D Diluent 20l		
33102	Dialyse HB 5D 0,5l		
33103	Dialyse BA 5D 1l		
33104	Dialyse Diff I. 5D 1l		
33105	Dialyse Diff II. 5D 0,5l		
960474	Multianalyte control (2se		
0201-0002-026	System solution (5l)		
0SY001TA4	CBC-SYS High 4,5ml		
0SY010TA4	CBC-SYS Normal 4,5ml		
105-000404-00	M-58 Cleanser 1l		
105-000405-00	M-58 Probe Cleanser 50ml		
209.900.011	Zkumavka se syst.roztokem		
3MA800	Disposable tips and chamb		
5130-6152	ReadyCon Norm - Lac/Glu		
5130-6162	ReadyCon Path - Lac/Glu		
5206-3011	Chip-Sensor Glucose Type		
5211-3017	Multi standard solution 1		
7111-011-20H	Capillaries 20ul (1x100)		
901.200.002	Holder for capillaries		
DTS / DTZ	Dopravné		

Katalogové ceny bez DPH jsou platné ke dni 14. 12. 2012, změny vyhrazeny.
Sazba DPH dle platných právních předpisů.

Dodatek č. 1

k Dohodě o obchodní spolupráci č. DOS 12-04

uzavřené dne 14. 12. 2012.

Článek I.

Smluvní strany

MEDESA s.r.o.

Se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
IČO: 64254577 DIČ: CZ64254577
Statutární zástupce: [REDAKCE]

(dále jen „společnost MEDESA“ nebo „dodavatel“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Se sídlem: Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
IČO: 26001551 DIČ: CZ26001551
Statutární zástupce: Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice
Kontakt: [REDAKCE]

(dále jen „ON Jičín“ nebo „odběratel“)

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Dohody o obchodní spolupráci. Tímto dodatkem se s účinností ke dni **1. 2. 2014** zvyšuje odběrateli systémová sleva a nové znění písm. a) a písm. b) článku II. zní takto:

- a) společnost MEDESA poskytne odběrateli **slevu ve výši 8% na veškeré zboží a služby**, dodávané na všechna pracoviště odběratele, s výjimkou zboží, jehož cena bude stanovena zvláštní smlouvou;
- b) sleva bude poskytována **snížením katalogové prodejní ceny bez DPH o 8%**, tzn. že fakturované ceny již zahrnují výše uvedenou slevu;

Ostatní ustanovení této Dohody zůstávají v platnosti beze změny. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopísech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Poličce dne 31. 1. 2014

[REDAKCE]

V Jičíně dne

26 -02- 2014

[REDAKCE]

Příloha č. 1 - Přehled zboží* dodávaného do Oblastní nemocnice Jičín a. s. / Ceník

* seznam zboží vychází z odběru za rok 2013

CENÍK

Oblastní nemocnice Jičín a. s., IČ 26001551

koeficient
slevy:

0,92

Registrační číslo	Název	Prodejní cena 2014 bez DPH	Systémová sleva	Prodejní cena 2014 bez DPH po slevě
0083602	Sample port G 601,602i,603ie,604ox			
0083801	pH Electrode Gastat			
0083803	PCO2 Electrode Gastat			
0083808	Cl Electrode Gastat			
0083809	Ca Electrode Gastat			
0083810	Reference Electrode Gastat			
0083901	Cal cassette G 601,602i,604ox			
0083902	Flush solution G 601,602i,603ie,604ox			
0083920	Gastrol ISE Tri-Level (all parametrs)			
0123050	Pump tube set G 604ox			
0123920	Ox Control Tri-Level (frakce Hb)			
018767	HbA1c Calibrator set			
01920	Gastrol Tri-Level (pH,pO2,pCO2)			
019506	G7 Filter Element			
019544	G7 BUFFER NO.1			
019545	G7 BUFFER NO.2			
019546	G7 BUFFER NO.3			
019551	G7 Kolona			
0201-0002-026	System solution			
020368	Calibrator FT4			
020394	Calibrator TSH 3G			
0209-0100-012	Sample cups with solution and 20ul capillaries			
0209-0102-391	Linearity test kit - Glu/Lac (2-7-18 mmol/l)			
020955	Washing Solution			
020956	Diluent			
020968	Substrate II			
020970	STD Cups			
021974	Hemoglobin A1c Control set			
025215	AIA Pack Troponin I 3G STAT			
025228	AIA Pack BNP			
025268	AIA Pack FT4 STAT			
025294	AIA Pack TSH 3G STAT			
025297	AIA Pack Myoglobin STAT			
025315	Calibrator Troponin I 3G			
025328	Calibrator BNP			
025397	Calibrator Myoglobin			
025428	BNP control			
062276	Blood Gas Capillaries BK130 (Li-heparin,plast,130µl)			
08-11-8432	HbA1c Hemolysis			
0SY001TA4	CBC-SYS High			
0SY010TA4	CBC-SYS Normal			

105-000404-00	M-58 Cleanser
105-000405-00	Probe Cleanser
330700	Sample Probe
33101	Diaton 5D Diluent
33102	Dialyse HB 5D
33103	Dialyse BA 5D
33104	Dialyse Diff I 5D
33105	Dialyse Diff II 5D
3MA005	Calibration standard 50 mOsm
3MA029	Clinitrol 290 mOsm
3MA800	Disposable tips and chamber cleaners (Adv 3300/3320)
407	Syringe 2 ml (Webers)
466	Uzávěr na kapiláry (Webers)
5130-6055	Sensor Test solution
5130-6152	ReadyCon Norm - Lac/Glu
5130-6162	ReadyCon Path - Lac/Glu
5206-3011	Glucose Chip -sensor type II for BIOSEN C/S line
5208-1094	Pump tube for BIOSEN C/S line
5211-1719	Sample cannula for BIOSEN C line
5211-1735	Exchanger for BIOSEN C/S line
5211-3015	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac
5211-3017	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac
5221-1714-0521	Sample cannula for BIOSEN S line
7025-6035-0231	Cleaner D
7025-6215-0376	Serum standard
7025-6237-0461	Blank System Solution
7025-6248-0486	Lithium Stock Solution
901.200.002	Holder for capillaries
960474	Multi-analyt Control (3 levels)
801-4171-58	ISE pufr CZ
801-4173-52	ISE Ref Solution CZ
801-4179-52	Kyvetový blank
DTZ	Dopravné a balné
H10	Dirui URISTIK H10 (leu,nit,uro,prot,pH,krev,SG,keto,bil,glu)
0117091	Sensor card pH, pCO2, pO2, Hct
0117092	Sensor card pH, pCO2, pO2, Na, K, Hct
0117093	Sensor card pH, pCO2, Na, K, Ca, Hct

Ceny uvedené ve sloupci "Prodejní cena 2014 bez DPH" jsou platné ke dni 1. 2. 2014. Změny vyhrazeny.

Na veškeré zboží a služby je s účinností od 1. 2. 2014 (dle Dodatku č. 1, Dohody o obchodní spolupráci č. DOS 12-04), poskytována systémová sleva 8% z aktuální katalogové ceny. Tato sleva je promítnuta na fakturu jako sleva ze základní ceny. Na zboží či služby může být jednorázově poskytnuta sleva vyšší (např. v případě kratší expirace zboží, množstevní slevy apod.).

SC* = "Speciální cena"

Tyto produkty **nepodléhají systémové slevě, ale mají stanovenou speciální jednotkovou cenu** - jedná se o zboží či služby. *"jejichž cena je stanovena zvláštní smlouvou"* (viz DOS 12-04, článek II, odst. 1, písm. a). Cena těchto produktů je stanovena buď zvláštní smlouvou, anebo se jedná o dohodu mezi obchodním reprezentantem společnosti MEDESA a klientem.

Dodatek č. 2

k Dohodě o obchodní spolupráci č. DOS 12-04

uzavřené dne 14. 12. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014

Článek I.

Smluvní strany

MEDESA s.r.o.

Se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
IČO: 64254577 DIČ: CZ64254577
Statutární zástupce: Otakar Klepárník, jednatel
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „společnost MEDESA“ nebo „dodavatel“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Se sídlem: Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
IČO: 26001551 DIČ: CZ26001551
Statutární zástupce: Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva;
Ing. Josef Kubíček, místopředseda představenstva

Kontakt: [REDAKCE]

(dále jen „ON Jičín“ nebo „odběratel“)

Článek II.

Smluvní strany se v souvislosti s výměnou typu zapůjčeného přístroje na pracovišti odběratele dohodly na změně výše uvedené Dohody o obchodní spolupráci (dále jen „Dohody“), z důvodu aktualizace Přílohy č. 1 následujícím způsobem:


1. Následující položky byly z **Ceníku odstraněny**:

OSY001TA4	CBC-SYS High	33102	Dialyse HB 5D
OSY010TA4	CBC-SYS Normal	33103	Dialyse BA 5D
105-000404-00	M-58 Cleanser	33104	Dialyse Diff I 5D
33101	Diaton 5D Diluent	33105	Dialyse Diff II 5D

2. Položky, které mají ve sloupci „Registrační číslo“ žluté podbarvení byly **nově přidány**, a to z toho důvodu, že jsou buď náhradou za zrušené položky, anebo byly odběratelem nakoupeny od poslední aktualizace Ceníku.
3. U položky *Dirui URISTIK H10 (leu,nit,uro,prot,pH,krev,SG,keto,bil,glu)* s katalogovým číslem H10 byla speciální [REDAKCE]

Článek III.

1. Nové znění Přílohy č. 1 je součástí tohoto dodatku.




2. Smluvní strany sjednávají, že ceny zboží, uvedené v Příloze č. 1, podléhají úpravě pouze v případě, že dojde ke změně katalogové prodejní ceny, a to navýšením nebo snížením o více než 2% oproti cenám v Příloze č. 1, platným ke dni podpisu tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny v platnosti.

Článek IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 2.7.2014.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Poličce dne: 1. 7. 2014




Otakar Klepárník,
ředitel - jednatel MEDESA s.r.o.




V Jičíně dne: - 2 - 07 - 2014

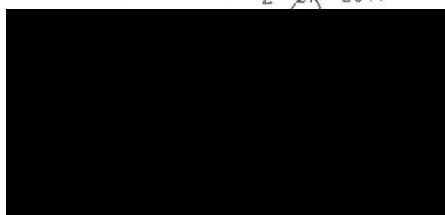

za vypůjčitele:
Ing. Dana Kracíková,
předsedkyně představenstva
ON Jičín a.s.



za vypůjčitele
Ing. Josef Kubíček,
místopředseda představenstva
ON Jičín a.s.



Příloha č. 1 - Přehled zboží* dodávaného do Oblastní nemocnice Jičín a. s. / Ceník

* seznam zboží vychází z odběrů ON Jičín

CENÍK		<i>Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČ 26001551</i>		<i>koeficient slevy:</i>	0,92
Registrační číslo	Název	Prodejní cena 2014 bez DPH	Systémová sleva	Prodejní cena 2014 bez DPH po slevě	
0083602	Sample port G 601,602i,603ie,604ox				
0083801	pH Electrode Gastat				
0083802	PO2 Electrode Gastat				
0083803	PCO2 Electrode Gastat				
0083808	Cl Electrode Gastat				
0083809	Ca Electrode Gastat				
0083810	Reference Electrode Gastat				
0083901	Cal cassette G 601,602i,604ox				
0083902	Flush solution G 601,602i,603ie,604ox				
0083912	Na refill solution				
0083920	Gastrol ISE Tri-Level (all parametrs)				
0123050	Pump tube set G 604ox				
0123920	Ox Control Tri-Level (frakce Hb)				
018767	HbA1c Calibrator set				
01920	Gastrol Tri-Level (pH,pO2,pCO2)				
019506	G7 Filter Element				
019544	G7 BUFFER NO.1				
019545	G7 BUFFER NO.2				
019546	G7 BUFFER NO.3				
019551	G7 Kolona				
0201-0002-026	System solution				
020368	Calibrator FT4				
020394	Calibrator TSH 3G				
0209-0100-012	Sample cups with solution and 20ul capillaries				
0209-0102-391	Linearity test kit - Glu/Lac (2-7-18 mmol/l)				
020955	Washing Solution				
020956	Diluent				
020968	Substrate II				
020970	STD Cups				
021974	Hemoglobin A1c Control set				
025215	AIA Pack Troponin I 3G STAT				
025228	AIA Pack BNP				
025268	AIA Pack FT4 STAT				
025294	AIA Pack TSH 3G STAT				
025297	AIA Pack Myoglobin STAT				
025315	Calibrator Troponin I 3G				
025328	Calibrator BNP				
025397	Calibrator Myoglobin				
025428	BNP control				
062276	Blood Gas Capillaries BK130 (Li-heparin,plast,130µl)				
08-11-8432	HbA1c Hemolysis				
105-000403-00	M-58 D Diluent				

105-000405-00	Probe Cleanser		
105-000407-00	M-58 LEO I Lyse		
105-000409-00	M-58 LEO II Lyse		
105-000413-00	M-58 LBA Lyse		
330700	Sample Probe		
3MA005	Calibration standard 50 mOsm		
3MA029	Clinitrol 290 mOsm		
3MA800	Disposable tips and chamber cleaners (Adv 3300/3320)		
407	Syringe 2 ml (Webers)		
466	Uzávěr na kapiláry (Webers)		
5130-6055	Sensor Test solution		
5130-6152	ReadyCon Norm - Lac/Glu		
5130-6162	ReadyCon Path - Lac/Glu		
5206-3011	Glucose Chip -sensor type II for BIOSEN C/S line		
5208-1094	Pump tube for BIOSEN C/S line		
5211-1719	Sample cannula for BIOSEN C line		
5211-1735	Exchanger for BIOSEN C/S line		
5211-3015	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac		
5211-3017	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac		
5221-1714-0521	Sample cannula for BIOSEN S line		
7025-6035-0231	Cleaner D		
7025-6215-0376	Serum standard		
7025-6237-0461	Blank System Solution		
7025-6248-0486	Lithium Stock Solution		
901.200.002	Holder for capillaries		
960474	Multi-analyt Control (3 levels)		
B01-4171-58	ISE pufr CZ		
B01-4173-52	ISE Ref Solution CZ		
B01-4179-52	Kyvetový blank		
DTZ	Dopravné a balné		
H10	Dirui URISTIK H10 (leu,nit,uro,prot,pH,krev,SG,keto,bil,glu)		
0117091	Sensor card pH, pCO2, pO2, Hct		
0117092	Sensor card pH, pCO2, pO2, Na, K, Hct		
0117093	Sensor card pH, pCO2, Na, K, Ca, Hct		
105-000411-00	M-58 LH Lyse		
040-000021-01	BC-5D Low		
040-000019-01	BC-5D Normal		
040-000020-01	BC-5D High		

Ceny uvedené ve sloupci "Prodejní cena 2014 bez DPH" jsou platné ke dni 1. 7. 2014. Změny vyhrazeny.

Na veškeré zboží a služby je s účinností od 1. 2. 2014 (dle Dodatku č. 1, Dohody o obchodní spolupráci č. DOS 12-04), poskytována systémová sleva 8% z aktuální katalogové ceny. Tato sleva je promítnuta na faktuře jako sleva ze základní ceny. Na zboží či služby může být jednorázově poskytnuta sleva vyšší (např. v případě kratší expirace zboží, množstevní slevy apod.).

SC* = "Speciální cena"

Tyto produkty nepodléhají systémové slevě, ale mají stanovenou speciální jednotkovou cenu - jedná se o zboží či služby, "jejichž cena je stanovena zvláštní smlouvou" (viz DOS 12-04, článek II, odst. 1, písm. a).

Cena těchto produktů je stanovena buď zvláštní smlouvou, anebo se jedná o ústní dohodu mezi obchodním reprezentantem společnosti MEDESA a klientem.

Dodatek č. 3

k Dohodě o obchodní spolupráci č. DOS 12-04

uzavřené dne 14. 12. 2012

Článek I. Smluvní strany

MEDESA s.r.o.

Se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
IČO: 64254577 DIČ: CZ64254577
Statutární zástupce: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „společnost MEDESA“ nebo „dodavatel“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Se sídlem: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 JIČÍN
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
IČO: 26001551 DIČ: CZ26001551
Statutární zástupce: Ing. Josef Kubíček, místopředseda představenstva
Kontakt: [REDACTED]

(dále jen „ON Jičín“ nebo „odberatel“)

Článek II.

Smluvní strany se v souvislosti s deinstalací přístrojů nebo výměnou typu zapůjčeného přístroje na pracovištích odběratele dohodly na změně výše uvedené Dohody o obchodní spolupráci (dále jen „Dohody“), z důvodu aktualizace Přílohy č. 1 následujícím způsobem:

1. Následující položky byly z Ceníku odstraněny:

466	Uzávěr na kapiláry (Webers)
020368	Calibrator FT4
020394	Calibrator TSH 3G
020955	Washing Solution
020956	Diluent
020968	Substrate II
020970	STD Cups
025215	AIA Pack Troponin I 3G STAT
025228	AIA Pack BNP
025268	AIA Pack FT4 STAT
025294	AIA Pack TSH 3G STAT
025297	AIA Pack Myoglobin STAT
025315	Calibrator Troponin I 3G
025328	Calibrator BNP
025397	Calibrator Myoglobin
025428	BNP control

407	Syringe 2 ml (Webers)
7025-6035-0231	Cleaner D
7025-6215-0376	Serum standard
7025-6237-0461	Blank System Solution
7025-6248-0486	Lithium Stock Solution
960474	Multi-analyt Control (3 levels)
0117091	Sensor card pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct
0117092	Sensor card pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na, K, Hct
0117093	Sensor card pH, pCO ₂ , Na, K, Ca, Hct

2. Položky, které mají ve sloupci „Registrační číslo“ žluté podbarvení byly **nově přidány**, a to z toho důvodu, že jsou buď náhradou za zrušené položky, anebo byly odběratelem nakoupeny od poslední aktualizace Ceníku.

Článek III.

1. Nová podoba Přílohy č. 1 je součástí tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny v platnosti.

Článek IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 3. 2016.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Poličce dne: 20. 2. 2016

V Jičíně dne: 20. 02. 2016

za půjčitele:

Otakar Klepárník,
ředitel - jednatel MEDESA s.r.o.

za vypůjčitele:

Ing. Josef Kubíček,
místopředseda představenstva ON Jičín a.s.

Příloha č. 1 - Přehled zboží* dodávaného do Oblastní nemocnice Jičín a. s. / Ceník

* seznam zboží vychází z odběrů ON Jičín a.s.

CENÍK		Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČ 26001551		koeficient slevy:	0,93
Registrační číslo	Název	Prodejní cena 2016 bez DPH	Systémová sleva	Prodejní cena 2016 bez DPH po systémové slevě	
0083602	Sample port G 601,602i,603ie,604ox		7 %		
0083801	pH Electrode Gastat		7 %		
0083802	PO2 Electrode Gastat		7 %		
0083803	PCO2 Electrode Gastat		7 %		
0083806	Na Electrode Gastat		7 %		
0083808	Cl Electrode Gastat		7 %		
0083809	Ca Electrode Gastat		7 %		
0083810	Reference Electrode Gastat		7 %		
0083811	TH Electrode		7 %		
0083901	Cal cassette G 601,602i,604ox		7 %		
0083902	Flush solution G 601,602i,603ie,604ox		7 %		
0083912	Na refill solution		7 %		
0083913	K refill solution		7 %		
0083914	Cl refill solution		7 %		
0083920	Gastrol ISE Tri-Level (all parametrs)		7 %		
0123050	Pump tube set G 604ox		7 %		
0123051	Tubing kit G 604ox		7 %		
0123052	Sample Tube G604		7 %		
0123920	Ox Control Tri-Level (frakce Hb)		7 %		
018767	HbA1c Calibrator set		7 %		
01920	Gastrol Tri-Level (pH,pO2,pCO2)		7 %		
019506	G7 Filter Element		7 %		
019544	G7 BUFFER NO.1		7 %		
019545	G7 BUFFER NO.2		7 %		
019546	G7 BUFFER NO.3		7 %		
019551	G7 Kolona		7 %		
0201-0002-026	System solution		7 %		
0209-0100-012	Sample cups with solution and 20ul capillaries		7 %		
0209-0102 391	Linearity test kit - Glu/Lac (2-7-18 mmol/l)		7 %		
021974	Hemoglobin A1c Control set		7 %		
062276	Blood Gas Capillaries BK130 (Li-heparin,plast,130µl)		7 %		
08-11-8432	HbA1c Hemolysis		7 %		
100020	Capillaries 20 µl		7 %		
105-000403-00	M-58 D Diluent		7 %		
105-000405-00	Probe Cleanser		7 %		
105-000407-00	M-58 LEO I Lyse		7 %		
105-000409-00	M-58 LEO II Lyse		7 %		
105-000413-00	M-58 LBA Lyse		7 %		
3MA005	Calibration standard 50 mOsm		7 %		
3MA029	Clinitrol 290 mOsm		7 %		
3MA800	Disposable tips and chamber cleaners (Adv 3300/3320)		7 %		

5130-6055	Sensor Test solution		7 %	
5130-6152	ReadyCon Norm - Lac/Glu		7 %	
5130-6162	ReadyCon Path - Lac/Glu		7 %	
5206-3011	Glucose Chip -sensor type II for BIOSEN C/S line		7 %	
5208-1094	Pump tube for BIOSEN C/S line		7 %	
5211-1719	Sample cannula for BIOSEN C line		7 %	
5211-1735	Exchanger for BIOSEN C/S line		7 %	
5211-3015	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac		7 %	
5211-3017	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac		7 %	
5221-1714-0521	Sample cannula for BIOSEN S line		7 %	
901.200.002	Holder for capillaries		7 %	
B01-4171-58	ISE pufr CZ		7 %	
B01-4173-52	ISE Ref Solution CZ		7 %	
B01-4178-01	Solution Wash Cuvette CZ		7 %	
DTZ	Dopravné a balné		7 %	
H10	Dirui URISTIK H10 (leu,nit,uro,prot,pH,krev,SG,keto,bil,glu)		SC*	
B01-4179-52	Kyvetový blank		SC*	
105-000411-00	M-58 LH Lyse		SC*	
040-000021-01	BC-5D Low		SC*	
040-000019-01	BC-5D Normal		SC*	
040-000020-01	BC-5D High		SC*	
05M100TA3	CBC-5D Low 3ml		SC*	
05M010TA3	CBC-5DMR Normal		SC*	
05M001TA3	CBC-5DMR High 3ml		SC*	

Ceny uvedené ve sloupci "Prodejní cena 2016 bez DPH" jsou platné ke dni 1. 3. 2016. Změny vyhrazeny.

Na veškeré zboží a služby je s účinností od 1. 3. 2016 (dle Dodatku č. 3, Dohody o obchodní spolupráci č. DOS 12-04), poskytována systémová sleva 7% z aktuální katalogové ceny. Tato sleva je promítnuta na faktuře jako sleva ze základní ceny. Na zboží či služby může být jednorázově poskytnuta sleva vyšší (např. v případě kratší expirace zboží, množstevní slevy apod.).

SC* = "Speciální cena"

Tyto produkty nepodléhají systémové slevě, ale mají stanovenou speciální jednotkovou cenu - jedná se o zboží či služby, "jejichž cena je stanovena zvláštní smlouvou" (viz DOS 12-04, článek II, odst. 1, písm. a).

Cena těchto produktů je stanovena buď zvláštní smlouvou, anebo se jedná o ústní dohodu mezi obchodním reprezentantem společnosti MEDESA s.r.o. a klientem.

Dodatek č. 4

k Dohodě o obchodní spolupráci č. DOS 12-04

uzavřené dne 14. 12. 2012

Článek I.

Smluvní strany

MEDESA s.r.o.

Se sídlem: **Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA**
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
IČO: **64254577** DIČ: **CZ64254577**
Statutární zástupce: **Otakar Klepárník, jednatel**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontakt: [REDACTED]

(dále jen „společnost MEDESA“ nebo „dodavatel“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Se sídlem: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 JIČÍN**
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
IČO: **26001551** DIČ: **CZ699004900**
Statutární zástupce: **Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva**
Kontakt: [REDACTED]

(dále jen „ON Jičín“ nebo „odběratel“)

Článek II.

Smluvní strany se v souvislosti s deinstalací přístrojů nebo výměnou typu zapůjčeného přístroje na pracovištích odběratele dohodly na změně výše uvedené Dohody o obchodní spolupráci (dále jen „Dohody“), z důvodu aktualizace Přílohy č. 1 následujícím způsobem:

1. Následující položky byly z Ceníku odstraněny:

0083602	Sample port G 601,602i,603ie,604ox
0083801	pH Electrode Gastat
0083802	PO2 Electrode Gastat
0083803	PCO2 Electrode Gastat
0083806	Na Electrode Gastat
0083808	Cl Electrode Gastat
0083809	Ca Electrode Gastat
0083810	Reference Electrode Gastat
0083811	TH Electrode
0083901	Cal cassette G 601,602i,604ox
0083902	Flush solution G 601,602i,603ie,604ox
0083912	Na refill solution
0083913	K refill solution
0083914	Cl refill solution
0083920	Gastrol ISE Tri-Level (all parametrs)
0123050	Pump tube set G 604ox

0123051	Tubing kit G 604ox
0123052	Sample Tube G604
0123920	Ox Control Tri-Level (frakce Hb)
01920	Gastrol Tri-Level (pH,pO2,pCO2)
062276	Blood Gas Capillaries BK130 (Li-heparin,plast,130µl)
105-000403-00	M-58 D Diluent
105-000405-00	Probe Cleanser
105-000407-00	M-58 LEO I Lyse
105-000409-00	M-58 LEO II Lyse
105-000413-00	M-58 LBA Lyse
105-000411-00	M-58 LH Lyse
040-000021-01	BC-5D Low
040-000019-01	BC-5D Normal
040-000020-01	BC-5D High
05M100TA3	CBC-5D Low 3ml
05M010TA3	CBC-5DMR Normal
05M001TA3	CBC-5DMR High 3ml

2. Položky, které mají ve sloupci „Registrační číslo“ žluté podbarvení, byly **nově přidány**, a to z toho důvodu, že jsou buď náhradou za zrušené položky, anebo byly odběratelem nakoupeny od poslední aktualizace Ceníku.
3. U položek, které jsou ve sloupci „Prodejní cena 2018 bez DPH“ označeny červeným písmem, došlo ke změně ceny oproti předchozímu dodatku.

Článek III.

1. Nová podoba Přílohy č. 1 je součástí tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny v platnosti.
3. Společnost MEDESA bere na vědomí, že ON Jičín je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.

Článek IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Poličce dne: - 9 -07- 2018

V Jičíně dne: 17 -07- 2018

za půjčitele:
Otakar Klepárník
ředitel – jednatel MEDESA s.r.o.

za vypůjčitele:
Ing. Tomáš Sláma, MSc.
předseda představenstva ON Jičín a.s.

Medesa

MEDESA s.r.o.
Mlýnský náhon 1390, 512 01 Polička
Tel: 402 525 517, fax: 402 525 577



Příloha č. 1 - Přehled zboží* dodávaného do Oblastní nemocnice Jičín a. s. / Ceník

* seznam zboží vychází z odběrů ON Jičín a.s.

CENÍK		Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČ 26001551		koeficient slevy:	0,93
Registrační číslo	Název	Prodejní cena 2018 bez DPH	Systémová sleva	Smluvní cena 2018 po syst. slevě, popř. SC bez DPH	
018767	HbA1c Calibrator set		7		
019506	G7 Filter Element		7		
019544	G7 BUFFER NO.1		7		
019545	G7 BUFFER NO.2		7		
019546	G7 BUFFER NO.3		7		
019551	G7 Kolona		7		
0201-0002-026	System solution		7		
0201-0004-001	Cleaning solution		7		
0209-0100-012	Sample cups with solution and 20ul capillaries		7		
0209-0102-391	Linearity test kit - Glu/Lac (2-7-18 mmol/l)		7		
021974	Hemoglobin A1c Control set		7		
08-11-8432	HbA1c Hemolysis		7		
100020	Capillaries 20 µl		7		
3MA005	Calibration standard 50 mOsm		7		
3MA029	Clinitrol 290 mOsm		7		
3MA800	Disposable tips and chamber cleaners (Adv 3300/3320)		7		
5130-6055	Sensor Test solution		7		
5130-6152	ReadyCon Norm - Lac/Glu		7		
5130-6162	ReadyCon Path - Lac/Glu		7		
5206-3011	Glucose Chip -sensor type II for BIOSEN C/S line		7		
5208-1094	Pump tube for BIOSEN C/S line		7		
5211-1719	Sample cannula for BIOSEN C line		7		
5211-1735	Exchanger for BIOSEN C/S line		7		
5211-3015	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac		7		
5211-3017	Multistandard solution 12 mmol/l Glu/Lac		7		
5221-1714-0521	Sample cannula for BIOSEN S line		7		
901.200.002	Holder for capillaries		7		
B01-4171-58	ISE pufr CZ		7		
B01-4173-52	ISE Ref Solution CZ		7		
B01-4178-01	Solution Wash Cuvette CZ		7		
DTZ	Dopravné a balné		7		
B01-4179-52	Kyvetovy blank		SC*		
H10	Dirui URISTIK H10		SC*		

Ceny uvedené ve sloupci "Prodejní cena 2018 bez DPH" jsou platné ke dni 5. 3. 2018. Změny vyhrazeny.

Na veškeré zboží a služby je s účinností od 1. 3. 2016 (dle Dodatku č. 3, Dohody o obchodní spolupráci č. DOS 12-04), poskytována systémová sleva 7 % z aktuální katalogové ceny. Tato sleva je promítnuta na fakturu jako sleva ze základní ceny. Na zboží či služby může být jednorázově poskytnuta sleva vyšší (např. v případě kratší expirace zboží, množstevní slevy apod.).

SC* = "Speciální cena"

Tyto produkty nepodléhají systémové slevě, ale mají stanovenou speciální jednotkovou cenu – jedná se o zboží či služby, "jejichž cena je stanovena zvláštní smlouvou" (viz DOS 12-04, článek II, odst. 1, písm. a).

Cena těchto produktů je stanovena buď zvláštní smlouvou, anebo se jedná o ústní dohodu mezi obchodním reprezentantem společnosti MEDESA s.r.o. a ON Jičín.

